

Proficiency Testing Scheme für die Wasseranalytik - Realproben

P24 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Proficiency Testing Scheme for Water Analysis - natural water samples

P24 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

BERICHT / REPORT

Probenversand / Sample dispatch: 25.04.2023

Ausgabe/Edition 1: 30.05.2023

Dieser Report umfasst 378 Seiten.

This report comprises 378 pages.

Durchführung gemäß Verfahren VA_1006_PT_CA (2021-01-25).

In accordance with the procedure VA_1006_PT_CA (2021-01-25).



Anbieter der Eignungsprüfung / Provider of the proficiency test:

Anschrift / Address: Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Vienna/Austria

E-Mail: ringversuche@umweltbundesamt.at

Tel: +43 (0) 1 31304 4334

Website deutsch: www.umweltbundesamt.at/ringversuche

www.ifatest.at

Website english: <https://www.umweltbundesamt.at/en/proficiency-testing>

www.ifatest.eu

Koordination und technische Leitung Eignungsprüfungen / coordinator and technical management:

Dipl.-Ing. Monika Denner

Verantwortlich für die Durchführung der Eignungsprüfungs runde / Responsible for the implementation of this proficiency test:

Dipl.-Ing. Johannes Urteil, Martha Schmid MSc unter Mitarbeit von Mag. Vito Satrapa

Tel.: +43 (0) 1 31304 4334

Verantwortlich für die Freigabe des Berichts / Responsible for authorizing the report:

Dipl.-Ing. Monika Denner

Leitung Eignungsprüfungen für den Bereich chemische Analytik / Management for proficiency tests for chemical analysis

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

D1. Beschreibung des Ringversuchs.....	5
D1.1. Ausgestaltung und Durchführung	5
D1.2. Beschreibung der Prüfgegenstände	5
D1.3. Anweisungen für die Teilnehmenden.....	5
D1.4. Kontrollanalytik zur Bewertung der Homogenität.....	6
D1.5. Trendtest zur Bewertung der Stabilität.....	6
D1.6. Ermittlung des zugewiesenen Wertes.....	6
D2. Kriterien der Leistungsbewertung	7
D2.1. Leistungskriterium z-Score.....	7
D2.2. Leistungskriterium E_n -Score	8
D2.3. Leistungsbewertung z-Score und E_n -Score.....	9
D3. Darstellung und Interpretation der Messergebnisse.....	9
D4. Anmerkungen zur Auswertung.....	10
D5. Erläuterung zu Tabellen und Grafiken	10
D5.1. Angaben und Abkürzungen in Tabellen	10
D5.2. Graphische Darstellung der Ergebnisse	13
D6. Zusammenfassung	16
D6.1. Tabelle der zugewiesenen Werte	16
D6.2. Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse ..	17
E1. Description of the proficiency test	19
E1.1. Design and implementation	19
E1.2. Description of the proficiency test items	19
E1.3. Instructions for the participants	19
E1.4. Control testing for homogeneity evaluation.....	20
E1.5. Trend test for stability evaluation	20
E1.6. Determination of the assigned values.....	20
E2. Criteria of performance evaluation	21
E2.1. Performance criterion z-Score	21
E2.2. Performance criterion E_n -Score	22
E2.3. Performance evaluation z-Score and E_n -Score	23
E3. Representation and interpretation of measurement results.....	23
E4. Explanatory notes	23

E5. Annotations on tables and charts	24
E5.1. Information and abbreviations in tables	24
E5.2. Graphical presentation of results	26
E6. Summary.....	29
E6.1. Table of assigned values	29
E6.2. Summary of results, after removal of outliers.....	30
E7. Parameterorientierte Auswertung / Parameter oriented report.....	31
E8. Labororientierte Auswertung / Laboratory oriented report.....	192
E9. Methodenübersicht / Overview of methods	363

D1. Beschreibung des Ringversuchs

D1.1. Ausgestaltung und Durchführung

- Anzahl der Anmeldungen: 34
- Anzahl der übermittelten Datensätze: 34
- Probenversand: 25.04.2023
- Einsendeschluss der Daten: 23.05.2023

Die Ergebnisabgabe erfolgte auf elektronischem Weg mittels passwortgeschützter Online-Dateneingabe. Beim Abschluss der Dateneingabe bestätigten die Teilnehmenden die vollständige und korrekte Eingabe aller Daten und die Freigabe der Ergebnisse zur Auswertung.

Zur Anonymisierung der Ergebnisse wurde jedem Labor willkürlich ein Laborcode zugeteilt.

D1.2. Beschreibung der Prüfgegenstände

Die Probenahme von Trinkwasser und Grundwasser erfolgte am 20.04.2023. Das Probenmaterial umfasste:

- 1 Probe Trinkwasser (P24 A)
- 1 Probe Grundwasser (P24 B)

Alle Proben wurden bis zur weiteren Verarbeitung gekühlt gelagert (4 +/-3°C).

Das Abfüllen der Proben erfolgte nach Filtration (40 µm) unter ständigem Rühren (Rührkessel). Anschließend wurden die Proben in den Flaschen mit einzelnen Substanzen dotiert und durch Schütteln homogenisiert. Die Stabilisierung erfolgte durch Kühlung.

Die homogenen Prüfgegenstände wurden am 25.04.2023 verschickt.

Jedes Teilnehmerlabor erhielt:

- 2 Proben zu je ca. 2000 ml, abgefüllt in je 2 x 1000 ml Braunglasflaschen.

D1.3. Anweisungen für die Teilnehmenden

Aus Stabilitätsgründen wurde empfohlen bis spätestens 27.04.2023 mit den Analysen zu beginnen.

Den Teilnehmenden stand die Wahl der Analysenmethode bzw. der verwendeten Norm frei, welche mit ihrem Routineverfahren übereinstimmen sollte. Eine Übersicht der angewendeten Methoden findet sich unter E9.

D1.4. Kontrollanalytik zur Bewertung der Homogenität

Im Zuge der Abfüllung wurden zu willkürlichen Zeitpunkten mehrere Aliquote pro Probe zur Kontrollanalytik entnommen.

Es wurden für die A- bzw. B-Probe jeweils $n=5$ Kontrollproben sowie $n=1$ undotierte Realprobe dem Labor zur Analyse übergeben.

Die Parameter wurden in der Prüfstelle am Umweltbundesamt (Prüfstelle für Umwelt-, GVO- & Treibstoffanalytik) zeitnah zum Probenversand analysiert.

Im Zuge der Auswertung wurde die relative Standardabweichung zwischen den Kontrollprobenabfüllungen bewertet und mit der Vergleichsstandardabweichung beim aktuellen Ringversuch verglichen.

Die Ergebnisse der Kontrollanalytik sind in der parameterorientierten Auswertung (E7) in Form von Mittelwerten \pm Messunsicherheit als Kontrollwert (control test value) \pm U gelistet (jeweils angegeben als erweiterte Messunsicherheit, $k=2$).

D1.5. Trendtest zur Bewertung der Stabilität

Die Bewertung der Stabilität der Prüfgegenstände (Realproben) erfolgte auf Basis der Datenstatistik aus den vergangenen Runden für Realproben im Zeitraum 2013 bis 2021.

Um die ausreichende Stabilität der Prüfgegenstände der aktuellen Eignungsprüfungsrounde bis zum Abgabetermin zu überprüfen, wurde die Darstellung der Ergebnisse der Teilnehmenden nach Analysendatum ausgewertet und auf systematische Trends geprüft (unauffällig). Durch Darstellung der Ergebnisse der Teilnehmenden nach Abfüllreihenfolge wurde auf das Vorliegen möglicher systematischer Trends der Ergebnisse geprüft (unauffällig).

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und aufgrund der Bewertungsgrundlagen der aktuellen Eignungsprüfungsrounde gilt die Stabilität der Prüfgegenstände im empfohlenen Zeitraum für die Analyse bis zum Abgabeschluss als gewährleistet.

D1.6. Ermittlung des zugewiesenen Wertes

Die Ergebnisse der Analysen mussten spätestens bis zum 23.05.2023 beim Veranstalter vorliegen. Später eingehende Werte wurden nicht berücksichtigt.

Im Zuge der Plausibilitätsprüfung der Daten (z.B. Check korrekte Einheiten, Messunsicherheitsangabe, ...) wurden die Teilnehmenden mit auffälligen Ergebnissen zum erneuten Datencheck der Eingabe und um Rückmeldung binnen 24 h aufgefordert.

Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung, wurde der Ausreißertest nach Hampel durchgeführt und die Ausreißer ermittelt. Die von diesem Test auffällig eingestuften Werte wurden in der Auswertung gekennzeichnet („H“). In begründeten Fällen, z.B. wenn der Ausreißertest nach Hampel nicht anwendbar ist (z.B. Ergebnisse liegen sehr eng beieinander oder überwiegend selber Zahlenwert bzw. bei wenig abgegebenen Daten mit sehr hoher Streuung), kann eine Ausreißereliminierung nach weiteren Kriterien erfolgen (z.B. Dean- und Dixon Test bzw. manuelle Ausreißerdefinition aufgrund Expertenbefund). Diese Vorgangsweise wird nach Anwendung unter Punkt D4 des Berichts dokumentiert.

Die weitere Auswertung erfolgte gemäß ISO 5725-2. Eine statistische Auswertung der Ringversuchsdaten erfolgte erst ab zumindest 6 gültigen, nummerischen Ergebnissen pro Parameter. Ergebnisse kleiner Bestimmungs- oder Nachweisgrenze wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Der zugewiesene Wert wird im Normalfall jeweils als der ausreißerbereinigte Mittelwert über alle übermittelten Ergebnisse gebildet.

Bei sehr hohen Streuungen der Ergebnisse der Teilnehmenden von über 50 % oder bei mangelhafter Rückführbarkeit der statistischen Kenndaten aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden auf den Mittelwert des Kontrolllabores bzw. einer zu geringen Anzahl an ausreißerbereinigten Ergebnissen über die Gruppe der akkreditierten Labore, kann die Situation auftreten, dass kein zugewiesener Wert für den aktuellen Ringversuch festgelegt werden kann und daher keine Bewertung der Ergebnisse der Teilnehmenden für diesen Parameter möglich ist. Ein entsprechender Hinweis wird im Bericht unter E7 bei der informativen Auswertung angebracht. Im Rahmen der internen Qualitätssicherung der Teilnehmenden kann ein Vergleich mit den Ergebnissen des Kontrolllabors durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise wird bei Anwendung jeweils parameter- und probenbezogen unter Punkt D4 des Berichts dokumentiert.

D2. Kriterien der Leistungsbewertung

D2.1. Leistungskriterium z-Score

Als Basis zur Berechnung der Wiederfindungsraten sowie der z-Scores wurde der ausreißerbereinigte Mittelwert über alle übermittelten Ergebnisse herangezogen.

Die Ermittlung der z-Scores erfolgte gemäß nachfolgender Formel:

$$z\text{-score} = \frac{x_i - \bar{X}}{\text{Kriterium}}$$

Dabei ist:

x_i	Messergebnis des teilnehmenden Labors
\bar{X}	zugewiesener Wert Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen); im Regelfall: ausreißerbereinigter Mittelwert der Ergebnisse der Teilnehmenden. Eine davon abweichende Vorgehensweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.
Kriterium	Vergleichsstandardabweichung berechnet aus den Statistiken für reale Wasserproben der vorangegangenen Runden im Zeitraum 2013 bis 2021 (RSDpooled) bzw. aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden (sR) des aktuellen Ringversuchs (falls noch weniger als 6 vorangegangene Runden für A und B-Proben vorlagen). In begründeten Fällen (z.B. Ergebnisse Realproben nahe an Mindestbestimmungsgrenze oder regulatorischer Vorgaben) erfolgt die Festlegung nach Expertenbefund und die Vorgangsweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.

D2.2. Leistungskriterium E_n-Score

Für die realen Wasserproben erfolgen seit 2019 zusätzliche Bewertungen unter Einbeziehung der erweiterten Messunsicherheiten der Teilnehmenden und der erweiterten Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes, gemäß E_n-Score. Diese Auswertungen werden für die Teilnehmenden im Bericht unter Punkt E8, jeweils im Anschluss an die z-Score Auswertung dargestellt.

Die Ermittlung der E_n-Scores erfolgte gemäß nachfolgender Formel:

$$E_n\text{-score} = \frac{x_i - \bar{X}}{\sqrt{U(x_i)^2 + U(\bar{X})^2}}$$

Dabei ist:

x_i	Messergebnis des teilnehmenden Labors
\bar{X}	zugewiesener Wert Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen); im Regelfall: ausreißerbereinigter Mittelwert der

	Ergebnisse der Teilnehmenden. Eine davon abweichende Vorgehensweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.
$U(x_i)$	erweiterte Messunsicherheit des Messergebnisses (Ergebnisse der Teilnehmenden), k=2
$U(\bar{X})$	erweiterte Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes, k=2

D2.3. Leistungsbewertung z-Score und E_n -Score

Interpretation der z-Scores:

- $|z\text{-Score}| \leq 2.0$ Ergebnis gut
- $2.0 < |z\text{-Score}| < 3.0$ Ergebnis fragwürdig
- $|z\text{-Score}| \geq 3.0$ Ergebnis nicht zufriedenstellend

Hinweis: Bei der Bewertung mittels z-Score wird die Messunsicherheit der Teilnehmenden nicht berücksichtigt. Der Vergleich der Abweichung zum zugewiesenen Wert erfolgt über das Kriterium.

Interpretation der E_n -Scores:

- $|E_n\text{-Score}| \leq 1.0$ zufriedenstellende Leistung
- $|E_n\text{-Score}| > 1.0$ nicht zufriedenstellende Leistung

Hinweis: Bei der Bewertung mittels E_n -Score erfolgt die Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheiten der Teilnehmenden und des zugewiesenen Wertes. $|E_n\text{-Score}| > 1.0$ können darauf hinweisen, dass die Unsicherheitsschätzungen überprüft oder ein Messproblem korrigiert werden muss.

D3. Darstellung und Interpretation der Messergebnisse

In der parameterorientierten Auswertung ist eine tabellarische Übersicht mit den Messergebnissen inklusive der Unsicherheit ($\pm U$), der Wiederfindung zum zugewiesenen Wert und dem berechneten z-Score dargestellt. Weiterhin werden unter Anmerkungen die Ausreißer gekennzeichnet. Die in der Tabelle angeführten Ergebnisse werden auch grafisch dargestellt.

In der labororientierten Auswertung werden pro Labor in anonymisierter Form die Ergebnisse der einzelnen Labore als Messergebnis $\pm U$ sowie die Wiederfindungen und die ermittelten z-Scores bezugnehmend auf das Kriterium dargestellt. Weiters werden die E_n -Scores unter Berücksichtigung der erweiterten Unsicherheiten in unabhängigen Tabellen ausgegeben. Die labororientierten Auswertungen enthalten jeweils die Bewertungsgrundlagen wie zugewiesener Wert samt erweiterter Messunsicherheit sowie das Kriterium.

Eine Erläuterung zu den Tabellen und Grafiken kann Punkt D5 entnommen werden.

D4. Anmerkungen zur Auswertung

Wie unter Punkt D2 ersichtlich, können die z-Scores auch unter Einbeziehung der Vergleichsstandardabweichung der ausreißerbereinigten Ergebnisse der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs berechnet werden. Das kann zur Folge haben, dass es bei Parametern mit hoher Ergebnistreuung dazu kommen kann, dass der Bereich z-Score - 2 bis z-Score + 2 einen ungewöhnlich hohen Wiederfindungsbereich abdeckt. Umgekehrt führt eine sehr geringe Streuung der Ergebnisse der Teilnehmenden dazu, dass z-Score - 2 bis z-Score + 2 einen ungewöhnlich kleinen Wiederfindungsbereich abdeckt.

Die Wiederfindungsrate wird unabhängig von der Streuung der Ergebnisse, als prozentuelle Abweichung vom zugewiesenen Wert berechnet und sollte bei der Bewertung von Ergebnissen im Rahmen des internen Qualitätsmanagementsystems der teilnehmenden Labore berücksichtigt werden.

Als Ergebnis einer Langzeitauswertung über aktuell 9 Eignungsprüfungsrunden (2013–2021) in Realproben wurden Kriterien (RSDpool) zur Ergebnisbewertung berechnet. Diese wurden im Zuge der Auswertung den relativen Vergleichsstandardabweichungen (vR) des aktuellen Ringversuchs gegenübergestellt.

Parameter Phenanthren bei Probe P24 A: Für diesen Parameter wurde die relative Vergleichsstandardabweichung (vR) aus der aktuellen Eignungsprüfungsrounde von 31 % für die Bewertung gewählt.

Parameter Indeno[1,2,3-c,d]pyren bei Proben P24 A und P24 B: Für die Bewertung wurde die relative Vergleichsstandardabweichung (vR) aus der aktuellen Eignungsprüfungsrounde gewählt (20 % bei P24 A; 18 % bei P24 B).

Bei allen anderen Parametern erfolgt die Berechnung der Scores nach D2.

D5. Erläuterung zu Tabellen und Grafiken

D5.1. Angaben und Abkürzungen in Tabellen

Parameter	Allgemeine Bezeichnung des Analysenparameters
Probe	Bezeichnung der übermittelten Probe
Einheit	Vorgegebene Einheit für Messwert und Ergebnisunsicherheit (z.B. µg/l)
Zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)


U (k=2)	erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes, (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)
Mittelwert	Ausreißerbereinigter Mittelwert über die Ergebnisse der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
VB (99%)	99 % Vertrauensbereich (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Minimum	Minimales abgegebenes Messergebnis, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Maximum	Maximales abgegebenes Messergebnis, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
sR	Vergleichsstandardabweichung, berechnet aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
vR	relative Vergleichsstandardabweichung in %, berechnet aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs bezogen auf den Mittelwert (angegeben auf 2 signifikante Stellen)
Kontrollwert ± U (k=2)	Mittelwert der Kontrollmessungen des Veranstalters ± erweiterte Ergebnisunsicherheit des Kontrollwertes (jeweils angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Laborcode	anonymisierte, eindeutige Kennung des teilnehmenden Labors im jeweiligen Ringversuch
Messwert	einzelne(r) Messwert(e) lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt)
Messergebnis	Für die Bewertung herangezogenes Ergebnis lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt).
± U	Bei Eignungsprüfungsrounden mit Vorgabe von unabhängigen Mehrfachbestimmungen, entspricht dies dem berechneten Mittelwert aus den einzelnen Messwerten der Teilnehmenden.
BG	kombinierte Messunsicherheit ohne Erweiterungsfaktor (k=1) lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt)
NG	Bestimmungsgrenze
	Nachweisgrenze

WF	Wiederfindungsrate in %, bezogen auf den zugewiesenen Wert (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 1 Nachkommastelle)
MW	Mittelwert
z-Score	Abweichung des Messergebnisses zum zugewiesenen Wert, ausgedrückt als Vielfaches des Kriteriums (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 2 Nachkommastellen)
E _n -Score	Abweichung des Messergebnisses zum zugewiesenen Wert, ausgedrückt als Vielfaches der kombinierten Messunsicherheiten, bestehend aus erweiterter Unsicherheit des zugewiesenen Wertes und der erweiterten Unsicherheit der Messergebnisse der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 2 Nachkommastellen). Beim E _n -Score erfolgt die Berücksichtigung der Messunsicherheit der Teilnehmenden.
-	Keine Daten übermittelt bzw. keine Berechnung möglich
Anmerkungen	Anmerkungen zum jeweiligen Messergebnis (z.B. H, FN, FP)
H	Ausreißer nach dem Hampel-Test
FN	Falsch negativ – Messergebnis kleiner Bestimmungs- bzw. Nachweisgrenze dessen Betrag die Bedingungen eines Ausreißers nach dem Hampeltest erfüllt.
FP	Falsch positiv – Falls aufgrund des geringen Analytgehalts kein zugewiesener Wert ermittelt werden kann ($n < 6$), wird der Median der Beträge der übermittelten Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenzen ermittelt. Als falsch positiv wird ein Messergebnis bewertet, welches diesen Median um mehr als 100 % übersteigt.
Standardabweichung	Vergleichsstandardabweichung berechnet aus den Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
rel. Standardabweichung	relative Vergleichsstandardabweichung in %, berechnet aus den Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs bezogen auf den Mittelwert (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
n	Anzahl der Messergebnisse
*	Kennzeichnung für Hinweise zur Erläuterung

D5.2. Graphische Darstellung der Ergebnisse


Nachfolgend wird die graphische Darstellung anhand von kommentierten Beispieldiagrammen erläutert.

Beispieldiagramm: Messwerte

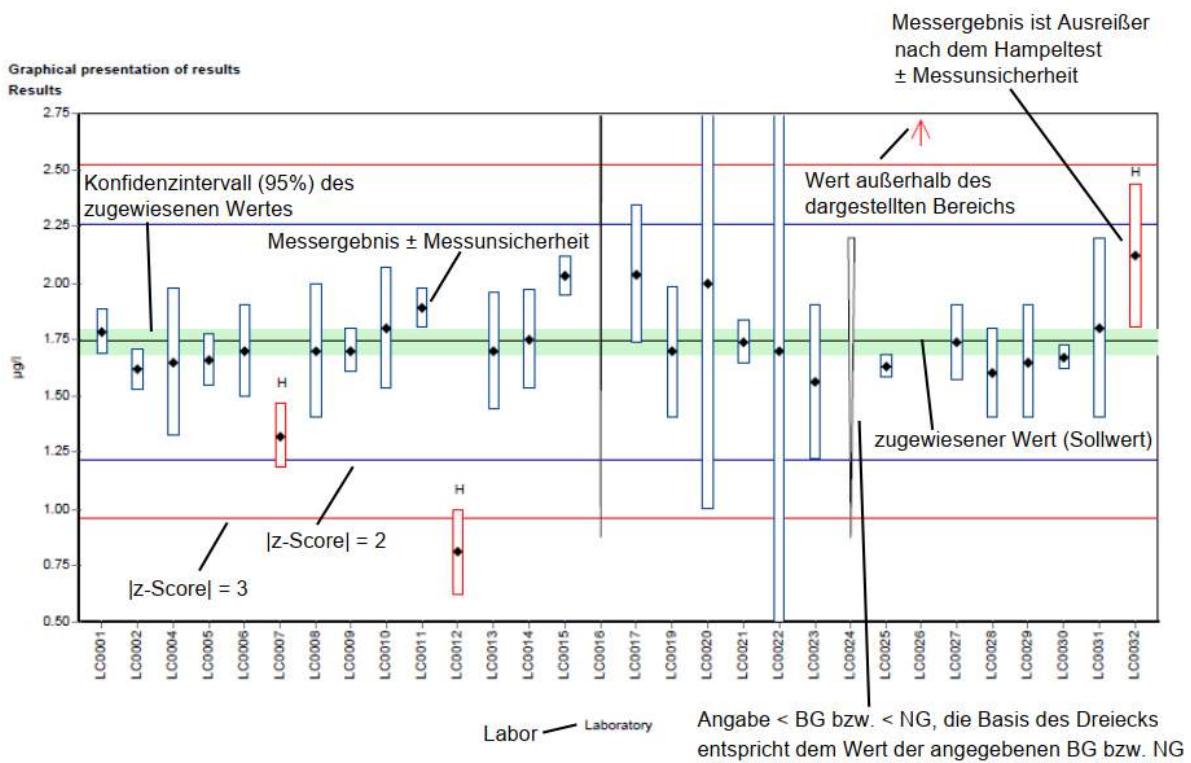


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

Beispieldiagramm: Wiederfindung zum zugewiesenen Wert

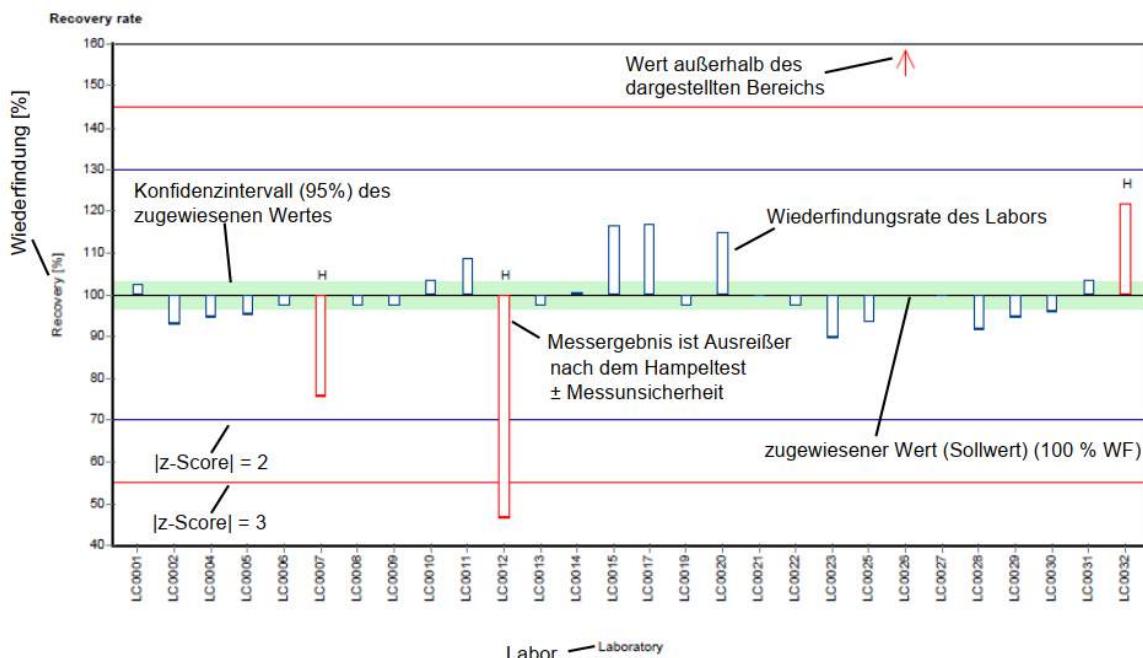


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

Beispieldiagramm: z-Score

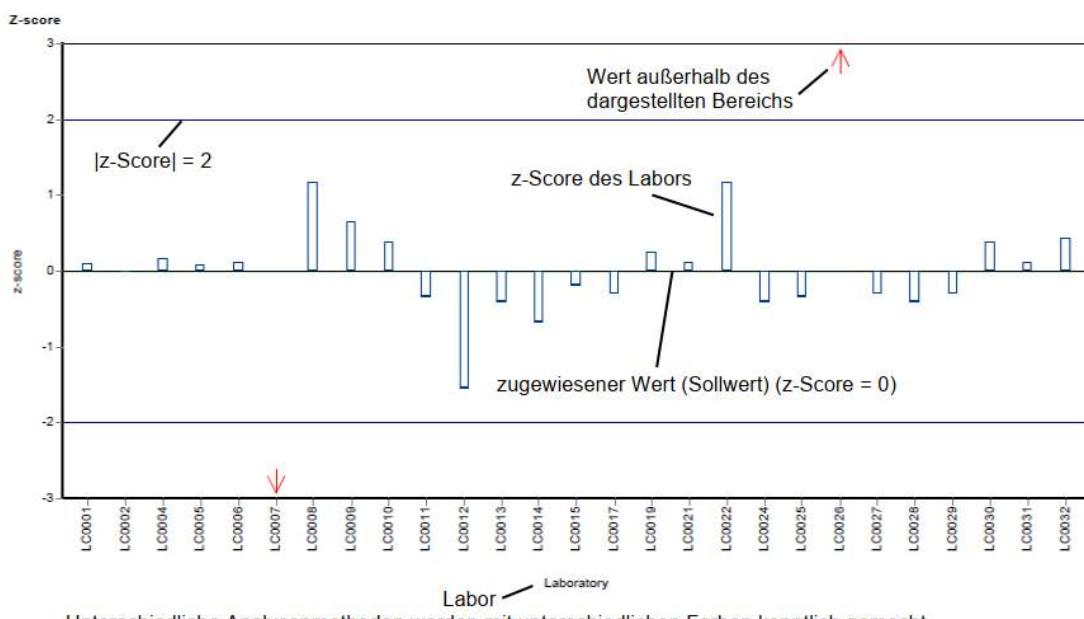


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

Beispieldiagramm: z-Score (labororientierte Auswertung)

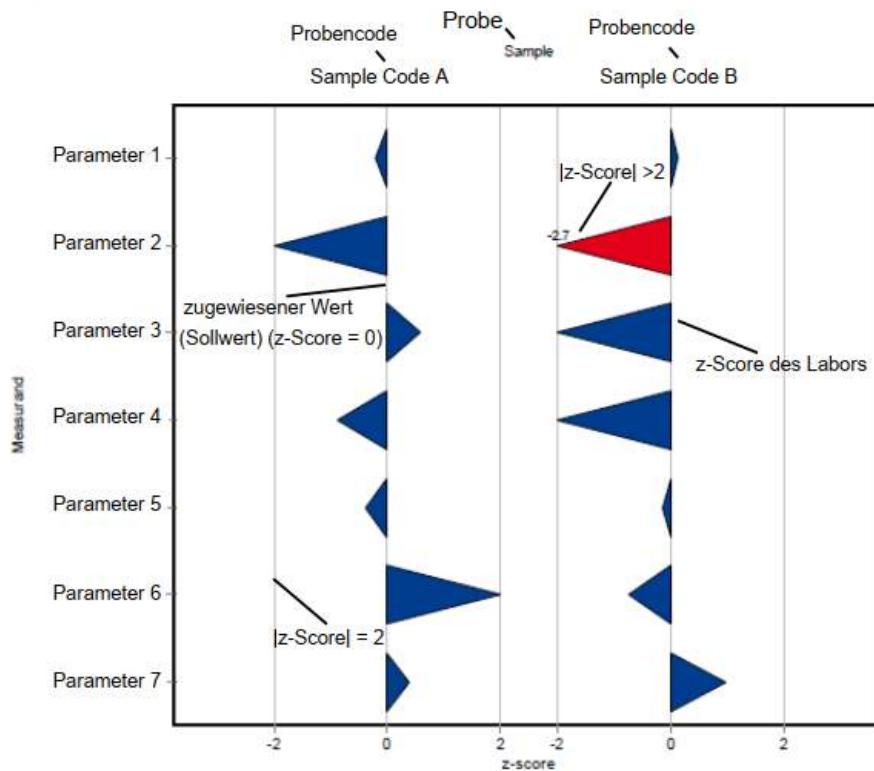

Beispieldiagramm: En-Score (labororientierte Auswertung)

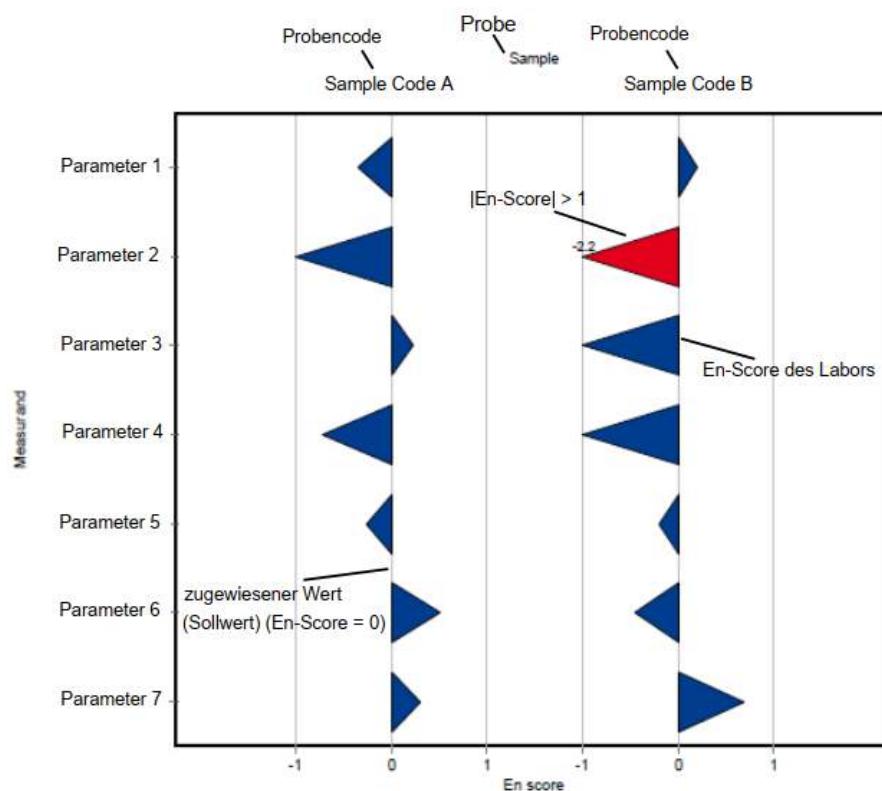

D6. Zusammenfassung

D6.1. Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener Wert	±	U (k=2)	Kriterium	Kriterium [%]
Acenaphthen	P24 A	ng/l	26.7	± 1.44	1.44	5.08	19
	P24 B	ng/l	180	± 10	10	34.1	19
Acenaphthylen	P24 A	ng/l	24.5	± 2.84	2.84	5.89	24
	P24 B	ng/l	143	± 10.4	10.4	34.4	24
Anthracen	P24 A	ng/l	24.6	± 1.09	1.09	6.39	26
	P24 B	ng/l	181	± 7.66	7.66	47.2	26
Benzo[a]anthracen	P24 A	ng/l	22.7	± 1.46	1.46	4.77	21
	P24 B	ng/l	147	± 7.68	7.68	30.8	21
Benzo[a]pyren	P24 A	ng/l	15.7	± 1.37	1.37	3.78	24
	P24 B	ng/l	147	± 8.62	8.62	35.4	24
Benzo[b]fluoranthen	P24 A	ng/l	23.8	± 1.52	1.52	4.05	17
	P24 B	ng/l	137	± 8.16	8.16	23.3	17
Benzo[g,h,i]perlylen	P24 A	ng/l	23.2	± 1.75	1.75	7.43	32
	P24 B	ng/l	152	± 11.6	11.6	48.6	32
Benzo[k]fluoranthen	P24 A	ng/l	21.6	± 1.11	1.11	5.61	26
	P24 B	ng/l	153	± 8.4	8.4	39.9	26
Chrysene	P24 A	ng/l	26.9	± 1.19	1.19	5.91	22
	P24 B	ng/l	180	± 7.8	7.8	39.7	22
Dibenzo[a,h]anthracen	P24 A	ng/l	25.7	± 1.57	1.57	7.7	30
	P24 B	ng/l	131	± 19.2	19.2	39.2	30
Fluoranthen	P24 A	ng/l	27.2	± 1.49	1.49	4.9	18
	P24 B	ng/l	180	± 8.62	8.62	32.3	18
Fluoren	P24 A	ng/l	27.4	± 1.24	1.24	3.83	14
	P24 B	ng/l	131	± 7.6	7.6	18.3	14
Indeno[1,2,3-cd]pyren	P24 A	ng/l	21.2	± 1.58	1.58	4.23	20
	P24 B	ng/l	111	± 7.43	7.43	20.1	18
Naphthalin	P24 A	ng/l	36.2	± 3.55	3.55	7.6	21
	P24 B	ng/l	182	± 12.7	12.7	38.3	21
Phenanthren	P24 A	ng/l	29.6	± 3.63	3.63	9.18	31
	P24 B	ng/l	180	± 13.7	13.7	26.9	15
Pyren	P24 A	ng/l	25.4	± 1.57	1.57	4.06	16
	P24 B	ng/l	179	± 8.09	8.09	28.7	16

D6.2. Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

Parameter	Probe	Anzahl Labors für Berechnung	Anzahl Ausreißer Labors	Einheit	Mittelwert	± VB (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Acenaphthen	P24 A	23	3	ng/l	26.7	± 2.16	20.4	33.5	3.45	13
	P24 B	24	3	ng/l	180	± 15	120	227	24.5	14
Acenaphthylen	P24 A	20	4	ng/l	24.5	± 4.26	8.53	34.4	6.35	26
	P24 B	21	5	ng/l	143	± 15.5	104	211	23.7	17
Anthracen	P24 A	26	2	ng/l	24.6	± 1.64	18	31.3	2.79	11
	P24 B	25	4	ng/l	181	± 11.5	146	211	19.1	11
Benzo[a]anthracen	P24 A	26	1	ng/l	22.7	± 2.19	15	31	3.72	16
	P24 B	24	4	ng/l	147	± 11.5	110	190	18.8	13
Benzo[a]pyren	P24 A	30	1	ng/l	15.7	± 2.05	8	23.3	3.74	24
	P24 B	30	3	ng/l	147	± 12.9	103	194	23.6	16
Benzo[b]fluoranthen	P24 A	30	1	ng/l	23.8	± 2.27	16.1	32.3	4.15	17
	P24 B	29	3	ng/l	137	± 12.2	86.8	192	22	16
Benzo[g,h,i]perlylen	P24 A	30	1	ng/l	23.2	± 2.62	11.2	32	4.78	21
	P24 B	29	3	ng/l	152	± 17.5	71.5	201	31.3	21
Benzo[k]fluoranthen	P24 A	29	2	ng/l	21.6	± 1.67	14.7	26.7	2.99	14
	P24 B	29	3	ng/l	153	± 12.6	97.5	189	22.6	15
Chrysen	P24 A	23	3	ng/l	26.9	± 1.78	22.5	33.1	2.85	11
	P24 B	24	4	ng/l	180	± 11.7	132	219	19.1	11
Dibenz[a,h]anthracen	P24 A	25	3	ng/l	25.7	± 2.35	17	33.5	3.91	15
	P24 B	29	0	ng/l	131	± 28.9	3.19	239	51.8	40
Fluoranthen	P24 A	24	4	ng/l	27.2	± 2.23	20.2	32.9	3.64	13
	P24 B	25	4	ng/l	180	± 12.9	136	213	21.5	12
Fluoren	P24 A	24	2	ng/l	27.4	± 1.86	19	32.2	3.03	11
	P24 B	25	2	ng/l	131	± 11.4	83.3	172	19	15
Indeno[1,2,3-cd]pyren	P24 A	29	2	ng/l	21.2	± 2.36	9.6	30	4.24	20
	P24 B	29	3	ng/l	111	± 11.1	62.7	147	20	18
Naphthalin	P24 A	22	2	ng/l	36.2	± 5.32	23	57.3	8.32	23

Parameter	Probe	Anzahl Labors für Berechnung	Anzahl Ausreißer Labors	Einheit	Mittelwert	± VB (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Naphthalin	P24 B	22	5	ng/l	182	± 19	105	246	29.7	16
Phenanthren	P24 A	25	2	ng/l	29.6	± 5.45	11.4	49.7	9.08	31
	P24 B	24	4	ng/l	180	± 20.5	129	274	33.5	19
Pyren	P24 A	25	3	ng/l	25.4	± 2.36	17.3	34.6	3.93	15
	P24 B	26	4	ng/l	179	± 12.1	141	213	20.6	11

E1. Description of the proficiency test

E1.1. Design and implementation

- Number of registrations: 34
- Number of submitted data records: 34
- Dispatch of samples: April 25th, 2023
- Closing date for submission of data: May 23rd, 2023

The results were submitted electronically by a password-protected online data entry. Upon completion of the data entry, the participant confirmed the complete and correct entry of all data and the authorization of the results for evaluation.

To anonymize results, each laboratory was given a laboratory code on a random basis.

E1.2. Description of the proficiency test items

The sampling of drinking water and ground water was carried out on the 20th of April 2023.

The following samples were made available

- 1 sample drinking water (P24 A)
- 1 sample ground water (P24 B)

Both samples were stored at 4 +/- 3°C until further processing. After filtration (40 µm), the samples were filled into bottles under continuous stirring (stirring vessel). Afterwards the samples were partly spiked in the bottles with specific substances and homogenized by shaking. The samples were stabilized by cooling.

The homogeneous proficiency test items were dispatched on the 25th of April 2023.

Each participant received:

- 2 samples each 2000 ml, filled in 2 x 1000 ml brown glass bottles

E1.3. Instructions for the participants

For reasons of stability, it was recommended to start the analysis by the 27th of April 2023 at the latest.

The participants are expected to use the test method or measurement method of their choice, which should be consistent with their routine procedures. In E9 you will find the overview of applied methods in course of the proficiency testing.

E1.4. Control testing for homogeneity evaluation

During filling of the bottles, aliquots of each sample were collected randomly for control testing. From each of the samples A and B, n=5 control test samples and n=1 unspiked real water sample were transferred to the laboratory for control testing.

All parameters were tested in the testing laboratory at the Environment Agency Austria (Prüfstelle für Umwelt-, GVO- & Treibstoffanalytik) close to the time of sample dispatch.

During evaluation the relative standard deviation between the individual results of the control test samples was assessed for each parameter by comparison with the reproducibility standard deviation of the actual proficiency test.

In the parameter-oriented evaluation (E7), the results of the control testing are given in the form of arithmetic means of the detected concentrations \pm expanded measurement uncertainty as control test value $\pm U$ (expanded uncertainty, k=2).

E1.5. Trend test for stability evaluation

The evaluation of stability of the proficiency test items was performed using the data statistics of the results of previous proficiency testing rounds for real water samples of the period from 2013 to 2021.

The assessment of the stability of the proficiency test items of the current round was carried out by evaluation of all participant results sorted by analysis date (until submission deadline): No systematic trends were identified.

Using all participants results, it was furthermore tested if systematic trends could be detected depending on the order in which the bottles were filled for the proficiency test: No systematic trends could be identified.

According to data obtained from previous rounds and based on the trend test evaluation of the current round, the stability of the test items for proficiency testing of real water samples can be confirmed for the recommended analysis period until deadline for submission of data.

E1.6. Determination of the assigned values

The analytical results had to be made available to the organiser not later than the 23rd of May 2023. Any values received at a later date were not considered.

In the course of the plausibility assessment of all received data (e.g. check for correct units, indication of measurement uncertainty, ...) the participants with noticeable results were asked to perform a subsequent data check and to give a prompt feedback within 24 h.

After plausibility assessment an outlier test according to Hampel was performed to identify outliers. Values identified as conspicuous are marked specifically in the parameter-oriented evaluation ('H').

In justified cases, for instance, when the outlier test according to Hampel is not applicable (e.g. many similar or identical results of the participants or in case of a very limited number of highly scattering results) a different outlier identification method can be applied (e.g. Dean and Dixon outlier test or manual outlier elimination by expert judgement). In such a case, this procedure is documented in section E4 of the report.

Further data evaluation was performed in accordance with ISO 5725-2. A statistical evaluation of proficiency testing data was only carried out if at least 6 valid results per parameter were available. Results < LOQ or < LOD are not included in the calculation for the assigned value.

The assigned values are normally calculated as the mean over all submitted results, after removal of outliers.

For real water samples in some exceptional cases it might occur, that no assigned value based on participants' results can be calculated and no evaluation of the participants results can be made. E.g due to large variations in the participant results ($vR > 50\%$) and/or insufficient traceability of the calculated mean of all participants after outlier-clearing to the mean of control testing or if the number of results (without outliers) of the group of accredited testing laboratories is too low.

In this case, a clear statement in section E7 of the report is made and all provided statistical data are for information only. In section E4 further information is given, when applicable, for each parameter and proficiency test item. In course of the internal quality measures, the participants can compare their results with the control test values.

E2. Criteria of performance evaluation

E2.1. Performance criterion z-Score

The adjusted average value (after removal of outliers) for all submitted results was used as a basis for the calculation of recovery rates and z-scores.

z-Scores were calculated on the basis of the following formula:

$$z - score = \frac{x_i - \bar{X}}{\text{Criteria}}$$

In this context,

x_i	is the measurement value (result) of the participating laboratory;
\bar{X}	assigned value the target value for the assessment of the performance of the participants (3 significant digits), normally the average value of the participants' results after removal of outliers; if this approach is not applicable, the target value is assigned according to the procedure given in section E4
Criteria	is the reproducibility standard deviation calculated from previous rounds for proficiency testing for real water samples from 2013 to 2021 (as RSD pooled) or from the participants' results after removal of outliers (s_R) in the current round (if less than 6 previous rounds for the parameters of real water samples A and B are available). Where justified (e.g. results for real water samples are close to minimum quantification limit or in case of regulatory requirements) the criteria is defined by expert judgement and the procedure is clearly described in section E4 of the report.

E2.2. Performance criterion E_n -Score

Since 2019 additional assessment of the participants' results using E_n -Scores for proficiency testing of real water samples is performed. This additional assessment takes into account the expanded measurement uncertainties of the participants results and the expanded uncertainty of the assigned value and is provided in the laboratory oriented part of the report (see E8 after the z-scores evaluation).

E_n -Scores were calculated on the basis of the following formula:

$$E_n - score = \frac{x_i - \bar{X}}{\sqrt{U(x_i)^2 + U(\bar{X})^2}}$$

In this context,

x_i	is the measurement value (result) of the participating laboratory
\bar{X}	assigned value the target value for the assessment of the performance of the participants (3 significant digits), normally the average value of the participants' results after removal of outliers; if this approach is not applicable, the target value is assigned according to the procedure given in section E4
$U(x_i)$	expanded measurement uncertainty for the result of the participating laboratory, $k=2$
$U(\bar{X})$	expanded measurement uncertainty for the assigned value, $k=2$

E2.3. Performance evaluation z-Score and E_n-Score

Interpretation of z-Scores:

- $|z\text{-Score}| \leq 2.0$ good result
- $2.0 < |z\text{-Score}| < 3.0$ questionable result
- $|z\text{-Score}| \geq 3.0$ unsatisfactory result

Note: In case of assessment of the participants' performance by z-scores the measurement uncertainty of the participants' results is not taken into account. The difference between result of participants and the assigned value is evaluated by the criteria.

Interpretation of E_n-Scores:

- $|E_n\text{-Score}| \leq 1.0$ satisfactory performance
- $|E_n\text{-Score}| > 1.0$ unsatisfactory performance

Note: In case of assessment of the participants' performance by E_n-Scores the expanded measurement uncertainties for the results and for the assigned values are taken into account. IE_n-Score > 1.0 might indicate to check the measurement uncertainty estimation or might point out to correct a measurement problem.

E3. Representation and interpretation of measurement results

The parameter-oriented report provides the measurement values (results) including uncertainty ($\pm U$), recovery rate, calculated z-Score and the outliers in tabular form. The results listed in the table are also represented graphically.

The laboratory oriented report shows the results of the individual laboratories (anonymous), including the measurement uncertainty ($\pm U$), recovery rates, z-Scores and additionally evaluation of E_n-Scores on separate pages.

The tables also contain the basis for the data assessment as the assigned values and expanded measurement uncertainties and the criteria.

An annotation of the tables and graphics is given in section E5.

E4. Explanatory notes

As explained in section E2, the z-Score can also be calculated using the reproducibility standard deviation, calculated from the participants' results (after removal of outliers) in the relevant test round. It might occur that the z-Score between -2 and 2 covers a large range of measurement values when the variance of the results is high. On the other hand, the range of good results can be very narrow, when the variation of the participants' results is small.

The recovery rate is calculated for the individual result based on the assigned value and is thus independent of the reproducibility standard deviation. In the case of a high variance of the results, participants should also consider recovery rates as additional criteria to decide on the necessity of internal quality assurance measures.

As a result of a long-term evaluation of 9 proficiency testing rounds (2013–2021 in real samples, evaluation criteria (RSDpool) were calculated.

These criteria were compared with the relative reproducibility standard deviation (vR) of the current proficiency testing.

Parameter Phenanthrene sample P24 A: For this parameter, the reproducibility standard deviation (vR) from the current proficiency testing round of 31 % was chosen for assessment.

Parameter Indeno[1,2,3-c,d]pyrene for samples P24 A and P24 B: The reproducibility standard deviation (vR) from the current proficiency testing round was used for evaluation (20 % for P24 A, 18 % for P24 B).

Scores for all other listed parameters were calculated according to E2.

E5. Annotations on tables and charts

E5.1. Information and abbreviations in tables


Parameter	Analyte identifier
Sample	Sample identifier
Unit	Given unit for result and uncertainty (e.g. µg/l)
Assigned value	Target value for proficiency assessment of the participants (3 significant digits)
U (k=2)	Expanded uncertainty (k=2) of the assigned value (3 significant digits)
Criteria	Specified value for the determination of the z-score in the given unit (3 significant digits)
Criteria [%]	Specified value for the determination of the z-score in % of the assigned value (2 significant digits)
Mean	Mean of the participants results, without outliers (3 significant digits)
CI (99 %)	99 % confidence interval (3 significant digits)
Minimum	Minimum of all submitted results, after removal of outliers (3 significant digits)
Maximum	Maximum of all submitted results, after removal of outliers (3 significant digits)
SD	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results, after removal of outliers (3 significant digits)

RSD %	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results relative to the target value, given in %, after removal of outliers (2 significant digits)
Control test value ± U (k=2)	Mean of control test value ± expanded measurement uncertainty (3 significant digits)
Labcode	Laboratory identifier (anonymized)
Result	Result as indicated by participant (max. 5 decimal places)
± U	combined measurement uncertainty without expansion factor (k=1), as indicated by participant (max. 5 decimal places)
LOQ	Limit of quantification
LOD	Limit of detection
Recovery	Recovery rate in % based on assigned value (target value) (3 significant digits, max. one decimal place given)
z-Score	Deviation of result based on the assigned value (target value) given as a multiple of the criteria (3 significant digits, max. 2 decimal places given)
E _n -Score	Deviation of result based on the assigned value (target value) given as a multiple of the combined expanded measurement uncertainty of the participant's results and expanded measurement uncertainty for the assigned value (3 significant digits, max. 2 decimal places given). Note: E _n -Score assessment takes into account the measurement uncertainty of the participants.
-	No data available or no calculation possible
Comments	Comment on the respective result (e.g. H, FN, FP)
H	Outlier according to Hampel-Test
FN	False negative – for a result < LOQ or result < LOD: The absolute value of the LOQ or LOD fulfils the condition of an outlier according to the Hampel test.
FP	False positive – for parameters where no target value is available because of a too low analyte content (n < 6): Result that exceeds the median of the absolute values of the transmitted LOQs or LODs by more than 100 %.
Standard deviation	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results (3 significant digits)
Rel. standard deviation	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results relative to the target value, given in %, (3 significant digits)
n	Number of results
*	mark for additional comments

E5.2. Graphical presentation of results


The graphic representation in the report is explained below by means of commented example diagrams:

Example chart: Results

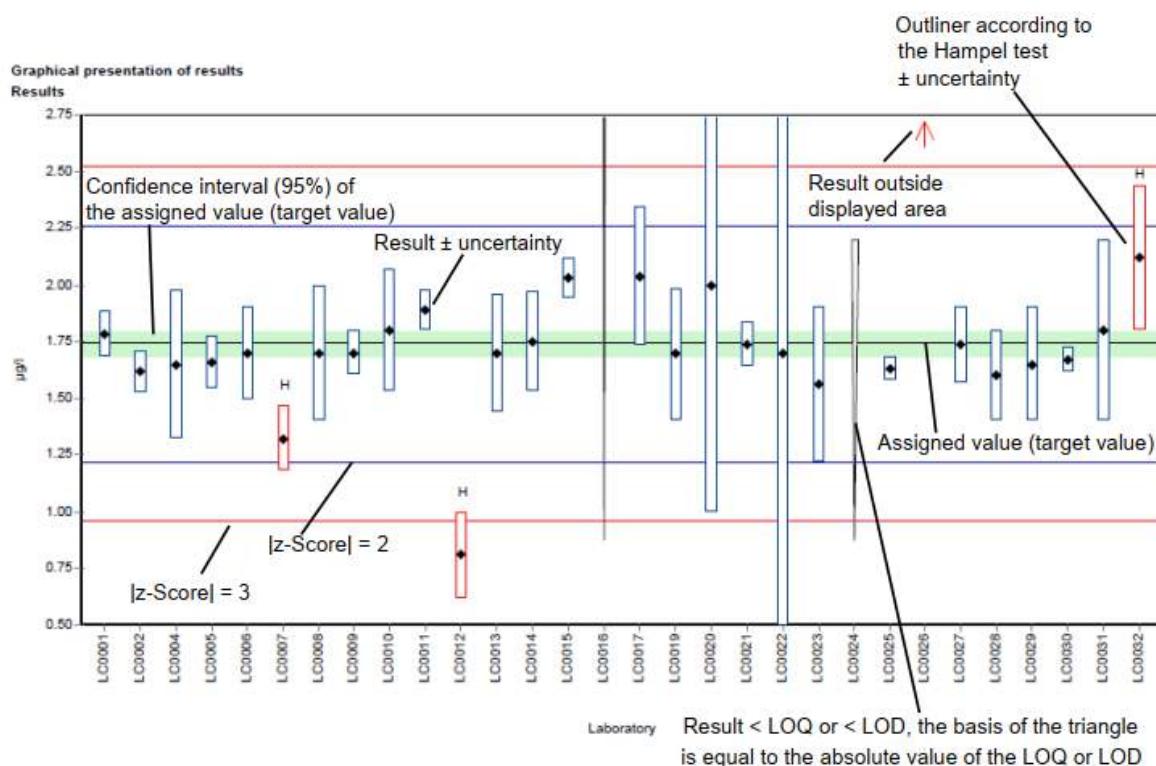


Different analysis methods are represented with different colors.

Example chart: Recovery

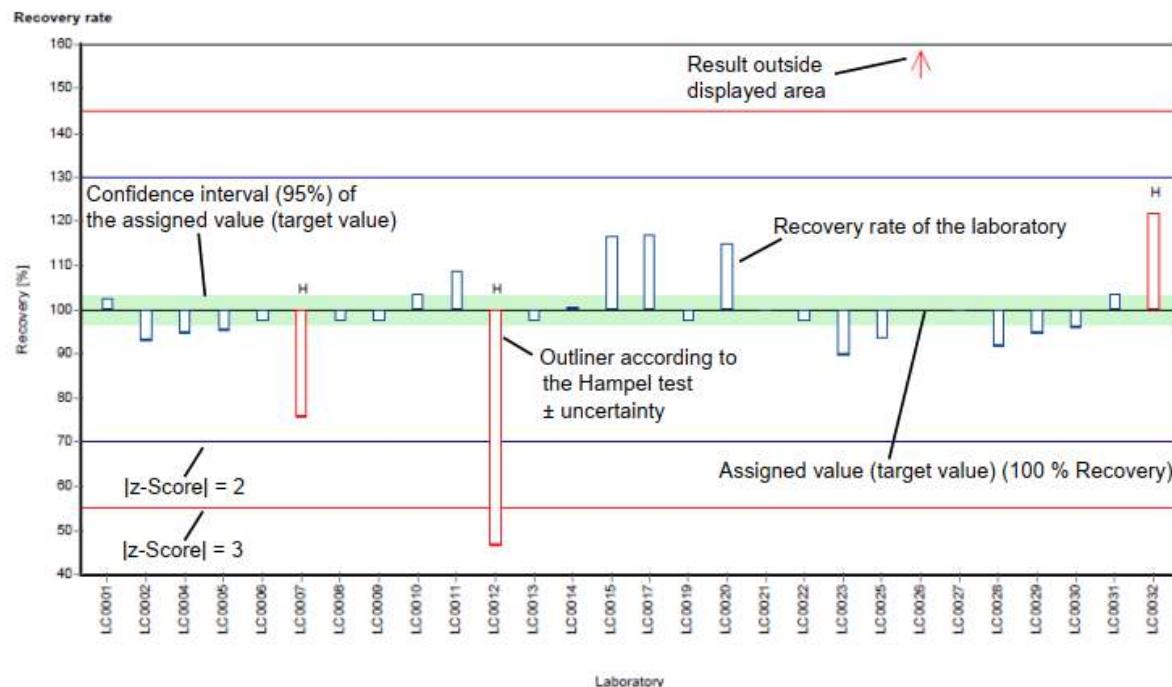


Different analysis methods are represented with different colors.

Example chart: z-Score

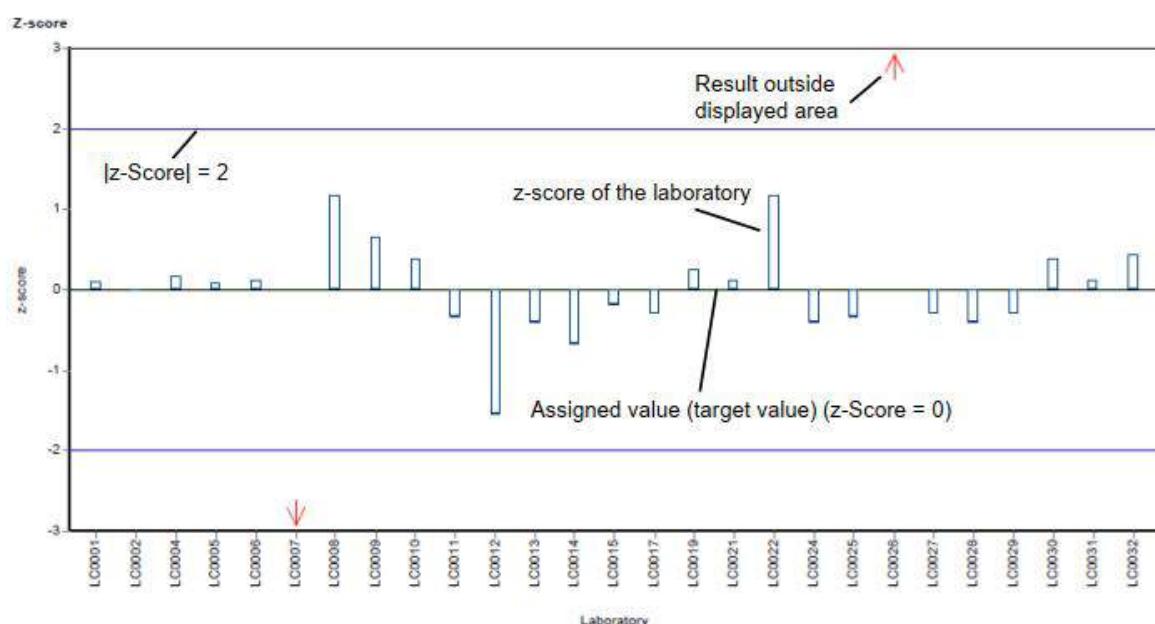


Different analysis methods are represented with different colors.

Example chart: z-Score (laboratory oriented report)

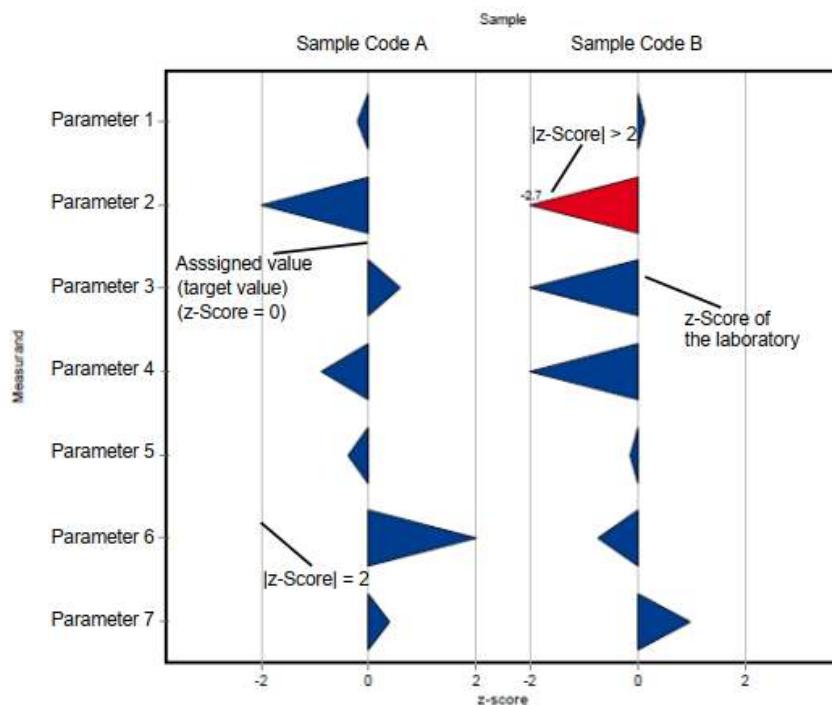

Example chart: En-Score (laboratory oriented report)

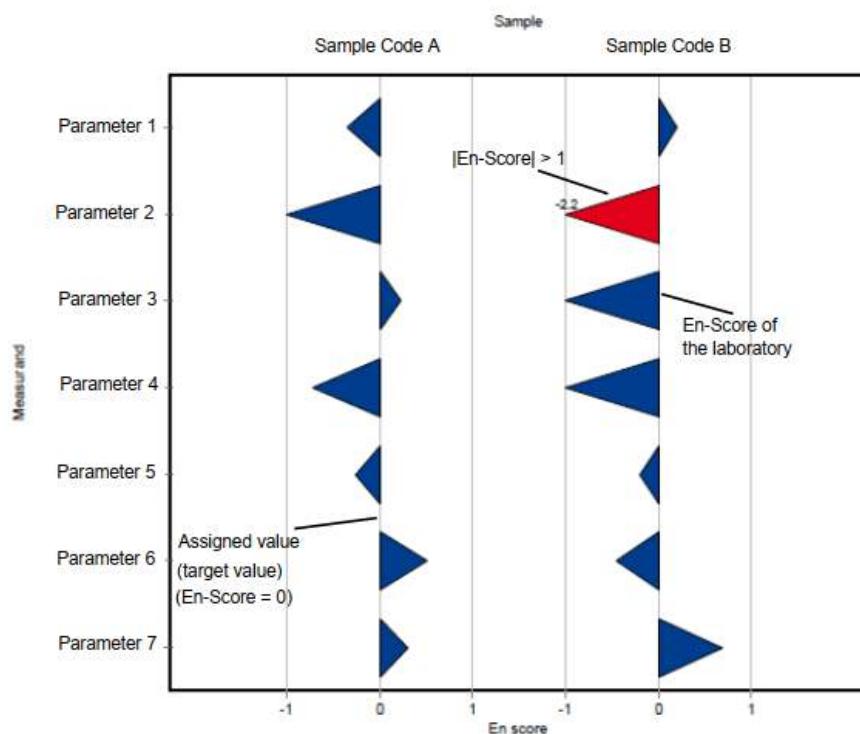

E6. Summary

E6.1. Table of assigned values

Parameter	Sample	Unit	Assigned value ±	U (k=2)	Criterion	Criterion [%]
Acenaphthene	P24 A	ng/l	26.7 ±	1.44	5.08	19
	P24 B	ng/l	180 ±	10	34.1	19
Acenaphthylene	P24 A	ng/l	24.5 ±	2.84	5.89	24
	P24 B	ng/l	143 ±	10.4	34.4	24
Anthracene	P24 A	ng/l	24.6 ±	1.09	6.39	26
	P24 B	ng/l	181 ±	7.66	47.2	26
Benzo[a]anthracene	P24 A	ng/l	22.7 ±	1.46	4.77	21
	P24 B	ng/l	147 ±	7.68	30.8	21
Benzo[a]pyrene	P24 A	ng/l	15.7 ±	1.37	3.78	24
	P24 B	ng/l	147 ±	8.62	35.4	24
Benzo[b]fluoranthene	P24 A	ng/l	23.8 ±	1.52	4.05	17
	P24 B	ng/l	137 ±	8.16	23.3	17
Benzo[g,h,i]perylene	P24 A	ng/l	23.2 ±	1.75	7.43	32
	P24 B	ng/l	152 ±	11.6	48.6	32
Benzo[k]fluoranthene	P24 A	ng/l	21.6 ±	1.11	5.61	26
	P24 B	ng/l	153 ±	8.4	39.9	26
Chrysene	P24 A	ng/l	26.9 ±	1.19	5.91	22
	P24 B	ng/l	180 ±	7.8	39.7	22
Dibenzo[a,h]anthracene	P24 A	ng/l	25.7 ±	1.57	7.7	30
	P24 B	ng/l	131 ±	19.2	39.2	30
Fluoranthene	P24 A	ng/l	27.2 ±	1.49	4.9	18
	P24 B	ng/l	180 ±	8.62	32.3	18
Fluorene	P24 A	ng/l	27.4 ±	1.24	3.83	14
	P24 B	ng/l	131 ±	7.6	18.3	14
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	P24 A	ng/l	21.2 ±	1.58	4.23	20
	P24 B	ng/l	111 ±	7.43	20.1	18
Naphthalene	P24 A	ng/l	36.2 ±	3.55	7.6	21
	P24 B	ng/l	182 ±	12.7	38.3	21
Phenanthrene	P24 A	ng/l	29.6 ±	3.63	9.18	31
	P24 B	ng/l	180 ±	13.7	26.9	15
Pyrene	P24 A	ng/l	25.4 ±	1.57	4.06	16
	P24 B	ng/l	179 ±	8.09	28.7	16

E6.2. Summary of results, after removal of outliers

Parameter	Sample	Number of results for calculation	Number of outliers	Unit	Mean	± CI (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Acenaphthene	P24 A	23	3	ng/l	26.7	± 2.16	20.4	33.5	3.45	13
	P24 B	24	3	ng/l	180	± 15	120	227	24.5	14
Acenaphthylene	P24 A	20	4	ng/l	24.5	± 4.26	8.53	34.4	6.35	26
	P24 B	21	5	ng/l	143	± 15.5	104	211	23.7	17
Anthracene	P24 A	26	2	ng/l	24.6	± 1.64	18	31.3	2.79	11
	P24 B	25	4	ng/l	181	± 11.5	146	211	19.1	11
Benzo[a]anthracene	P24 A	26	1	ng/l	22.7	± 2.19	15	31	3.72	16
	P24 B	24	4	ng/l	147	± 11.5	110	190	18.8	13
Benzo[a]pyrene	P24 A	30	1	ng/l	15.7	± 2.05	8	23.3	3.74	24
	P24 B	30	3	ng/l	147	± 12.9	103	194	23.6	16
Benzo[b]fluoranthene	P24 A	30	1	ng/l	23.8	± 2.27	16.1	32.3	4.15	17
	P24 B	29	3	ng/l	137	± 12.2	86.8	192	22	16
Benzo[g,h,i]perylene	P24 A	30	1	ng/l	23.2	± 2.62	11.2	32	4.78	21
	P24 B	29	3	ng/l	152	± 17.5	71.5	201	31.3	21
Benzo[k]fluoranthene	P24 A	29	2	ng/l	21.6	± 1.67	14.7	26.7	2.99	14
	P24 B	29	3	ng/l	153	± 12.6	97.5	189	22.6	15
Chrysene	P24 A	23	3	ng/l	26.9	± 1.78	22.5	33.1	2.85	11
	P24 B	24	4	ng/l	180	± 11.7	132	219	19.1	11
Dibenz[a,h]anthracene	P24 A	25	3	ng/l	25.7	± 2.35	17	33.5	3.91	15
	P24 B	29	0	ng/l	131	± 28.9	3.19	239	51.8	40
Fluoranthene	P24 A	24	4	ng/l	27.2	± 2.23	20.2	32.9	3.64	13
	P24 B	25	4	ng/l	180	± 12.9	136	213	21.5	12
Fluorene	P24 A	24	2	ng/l	27.4	± 1.86	19	32.2	3.03	11
	P24 B	25	2	ng/l	131	± 11.4	83.3	172	19	15
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	P24 A	29	2	ng/l	21.2	± 2.36	9.6	30	4.24	20
	P24 B	29	3	ng/l	111	± 11.1	62.7	147	20	18
Naphthalene	P24 A	22	2	ng/l	36.2	± 5.32	23	57.3	8.32	23
	P24 B	22	5	ng/l	182	± 19	105	246	29.7	16
Phenanthrene	P24 A	25	2	ng/l	29.6	± 5.45	11.4	49.7	9.08	31
	P24 B	24	4	ng/l	180	± 20.5	129	274	33.5	19
Pyrene	P24 A	25	3	ng/l	25.4	± 2.36	17.3	34.6	3.93	15
	P24 B	26	4	ng/l	179	± 12.1	141	213	20.6	11

E7. Parameterorientierte Auswertung / Parameter oriented report

Acenaphthene	32
Acenaphthylene.....	42
Anthracene.....	52
Benzo[a]anthracene	62
Benzo[a]pyrene	72
Benzo[b]fluoranthene	82
Benzo[g,h,i]perylene.....	92
Benzo[k]fluoranthene.....	102
Chrysene.....	112
Dibenzo[a,h]anthracene	122
Fluoranthene	132
Fluorene.....	142
Indeno[1,2,3-cd]pyrene.....	152
Naphthalene.....	162
Phenanthrene.....	172
Pyrene.....	182

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthene

Parameter oriented report

P24A

Acenaphthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 26.7 ± 1.44
 Criterion 5.08 (19 %)
 Minimum - Maximum 20.4 - 33.6
 Control test value ± U (k=2) 33.4 ± 11.7

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	31.2	4.1	117	0.88	
LC0002	26.6	5.3	99.6	-0.02	
LC0003	26.5	7.94	99.2	-0.04	
LC0004	27.6	3	103	0.17	
LC0005	26.2	5.8	98.1	-0.1	
LC0006	38.36	5.754	144	2.29	H
LC0007	27	5	101	0.06	
LC0008	23.8	0.63	89.1	-0.57	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	33.55	14.76	126	1.35	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	26.35	0.49	98.6	-0.07	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	28	7	105	0.25	
LC0016	26.1	1.18	97.7	-0.12	
LC0017	28.5	5.7	107	0.35	
LC0018	22.6	7.91	84.6	-0.81	
LC0019	10.47	2.3	39.2	-3.2	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	27.5	5.5	103	0.15	
LC0023	20.36	6.5	76.2	-1.25	
LC0024	27.6	2.8	103	0.17	
LC0025	28.8	6.05	108	0.41	
LC0026	31.9	2.7	119	1.02	
LC0027	21.6	4.8	80.8	-1.01	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	23	4.6	86.1	-0.73	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	29.7	6.1	111	0.59	
LC0032	29.23	2.79	109	0.5	
LC0033	62.1	14	232	6.97	H
LC0034	20.8	2.68	77.9	-1.17	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Acenaphthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	27.9 ± 5.1	26.7 ± 2.16 ng/l
Minimum	10.5	20.4 ng/l
Maximum	62.1	33.6 ng/l
Standard deviation	8.66	3.45 ng/l
rel. standard deviation	31.1	12.9 %
n	26	23 -


Graphical presentation of results

Results

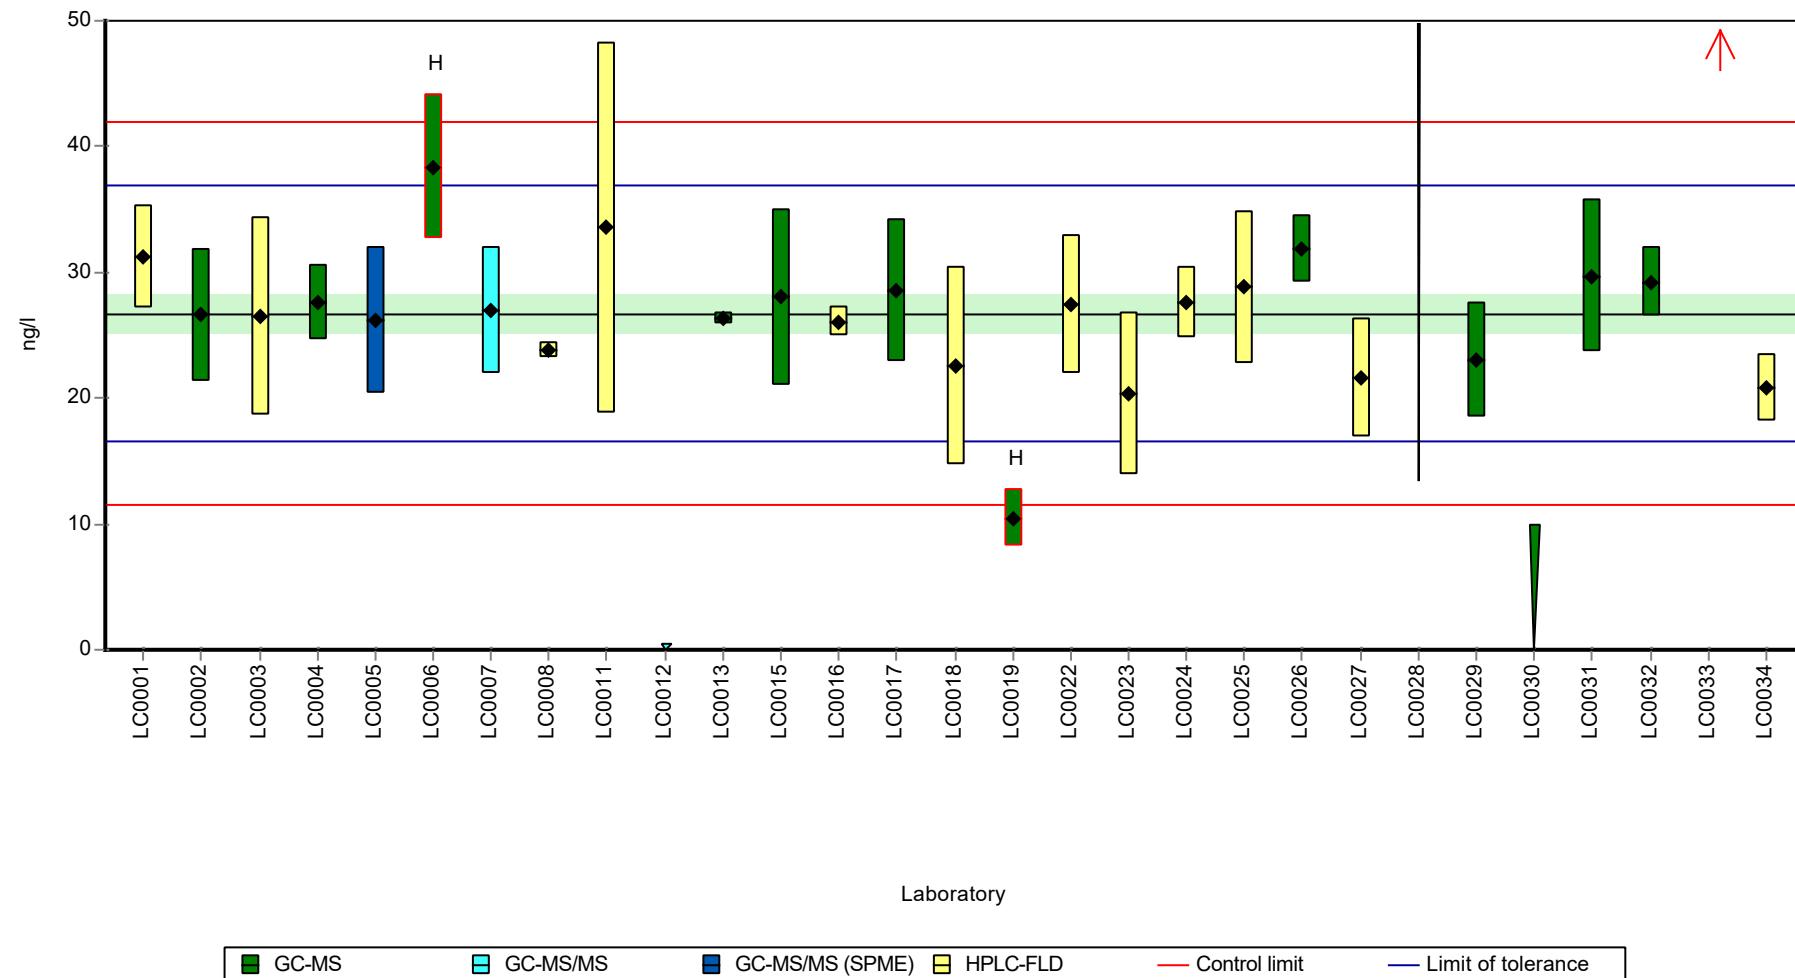


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthene

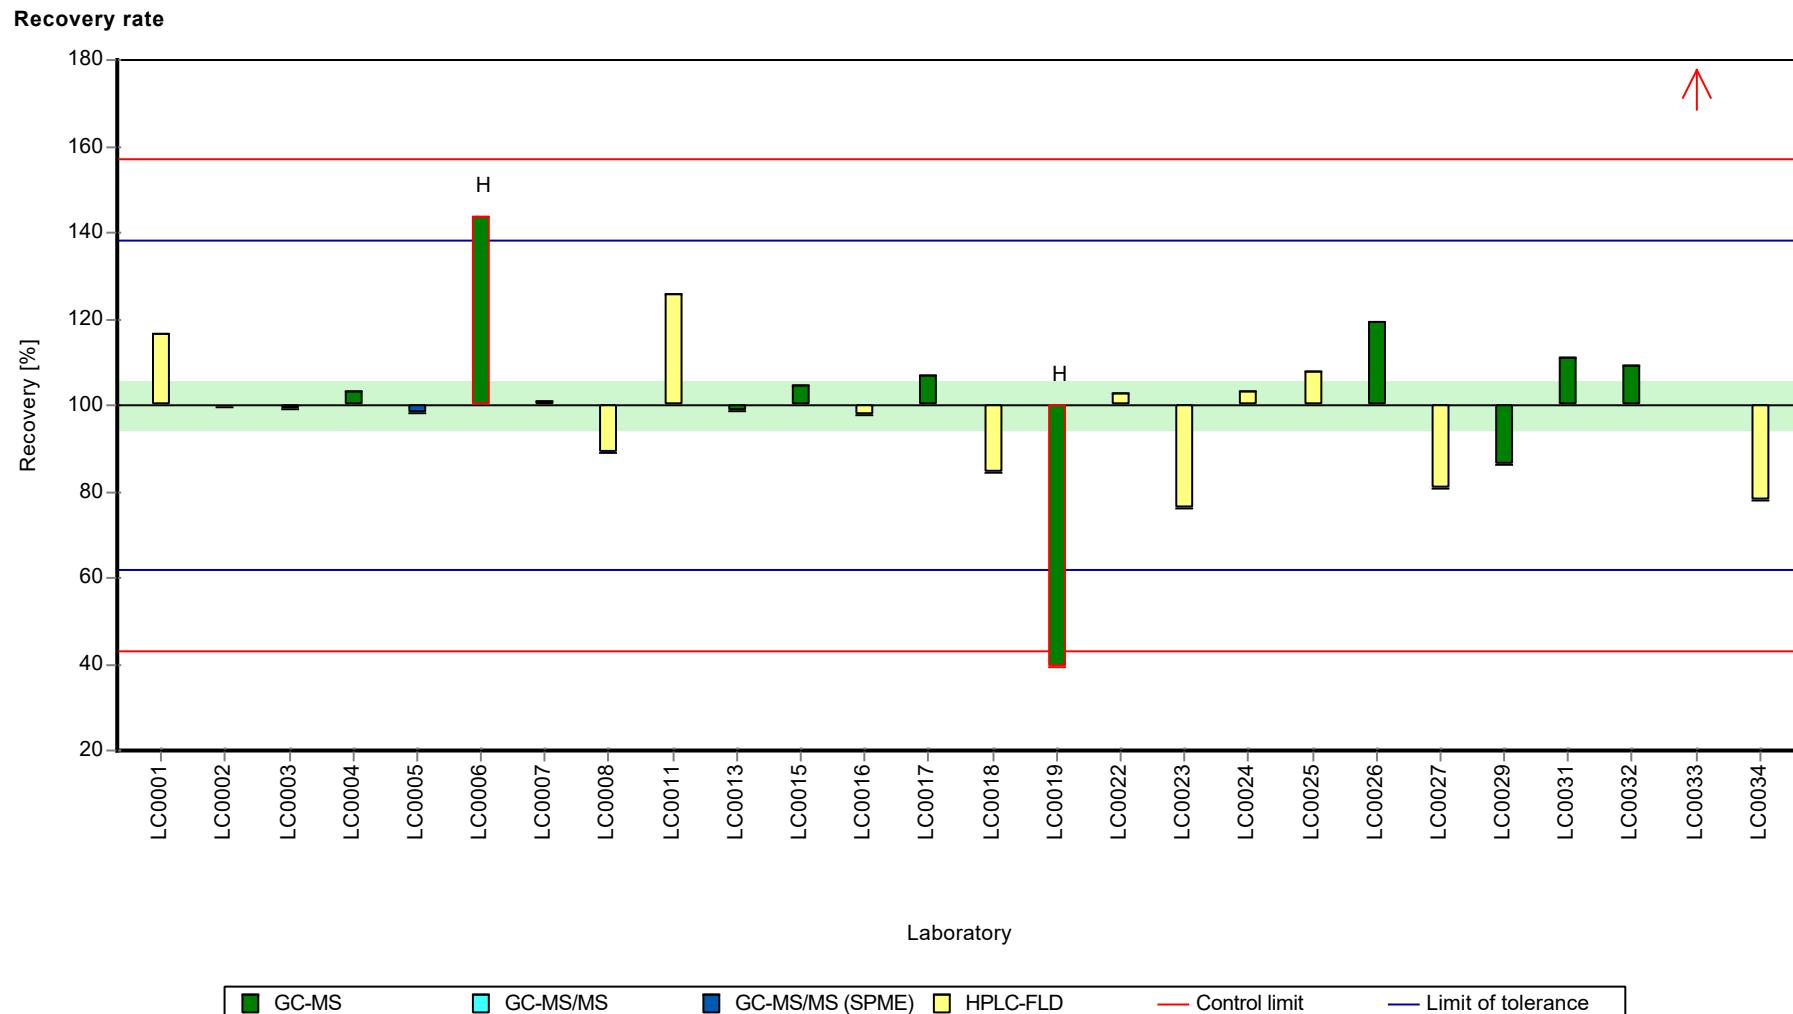

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthene

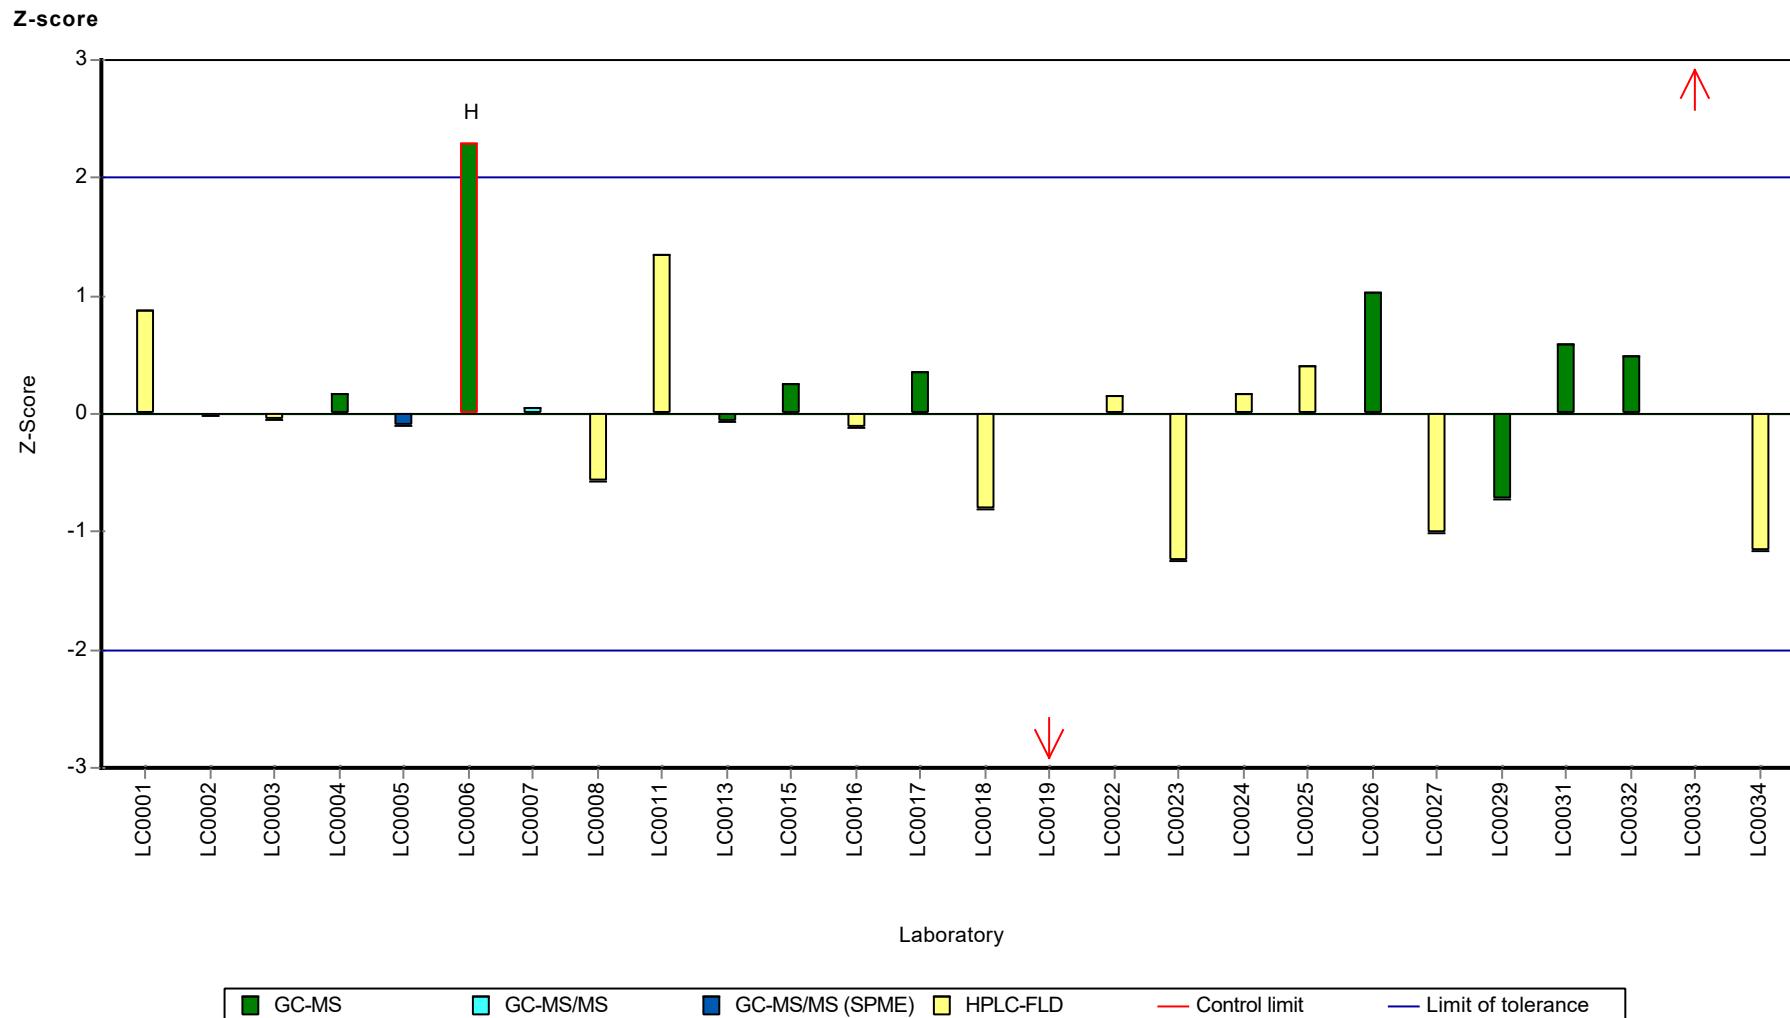

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthene

Parameter oriented report

P24 B

Acenaphthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 180 ± 10
 Criterion 34.1 (19 %)
 Minimum - Maximum 120 - 227
 Control test value ± U (k=2) 220.0 ± 77

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	190	25	106	0.31	
LC0002	158	32	88	-0.63	
LC0003	181	54.2	101	0.04	
LC0004	190.61	19	106	0.32	
LC0005	181	40	101	0.04	
LC0006	175.86	26.379	97.9	-0.11	
LC0007	195	39	109	0.45	
LC0008	325	3	181	4.26	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	180.51	79.425	101	0.03	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	166.7	3.17	92.8	-0.38	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	206	49	115	0.78	
LC0016	180	4.81	100	0.01	
LC0017	178.3	35.7	99.3	-0.04	
LC0018	157	55	87.4	-0.66	
LC0019	163.15	35.89	90.9	-0.48	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	185	37	103	0.16	
LC0023	98.27	17.8	54.7	-2.38	H
LC0024	192.8	19.3	107	0.39	
LC0025	222.5	46.73	124	1.26	
LC0026	227	22.7	126	1.39	
LC0027	138	30	76.9	-1.22	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	178	36	99.1	-0.05	
LC0030	20	4	11.1	-4.68	H
LC0031	203	41	113	0.69	
LC0032	191.19	18.26	106	0.34	
LC0033	149.3	33.7	83.1	-0.89	
LC0034	119.5	15.4	66.6	-1.76	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Acenaphthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	176 ± 29.2	180 ± 15 ng/l
Minimum	20	120 ng/l
Maximum	325	227 ng/l
Standard deviation	50.7	24.5 ng/l
rel. standard deviation	28.8	13.7 %
n	27	24 -


Graphical presentation of results

Results

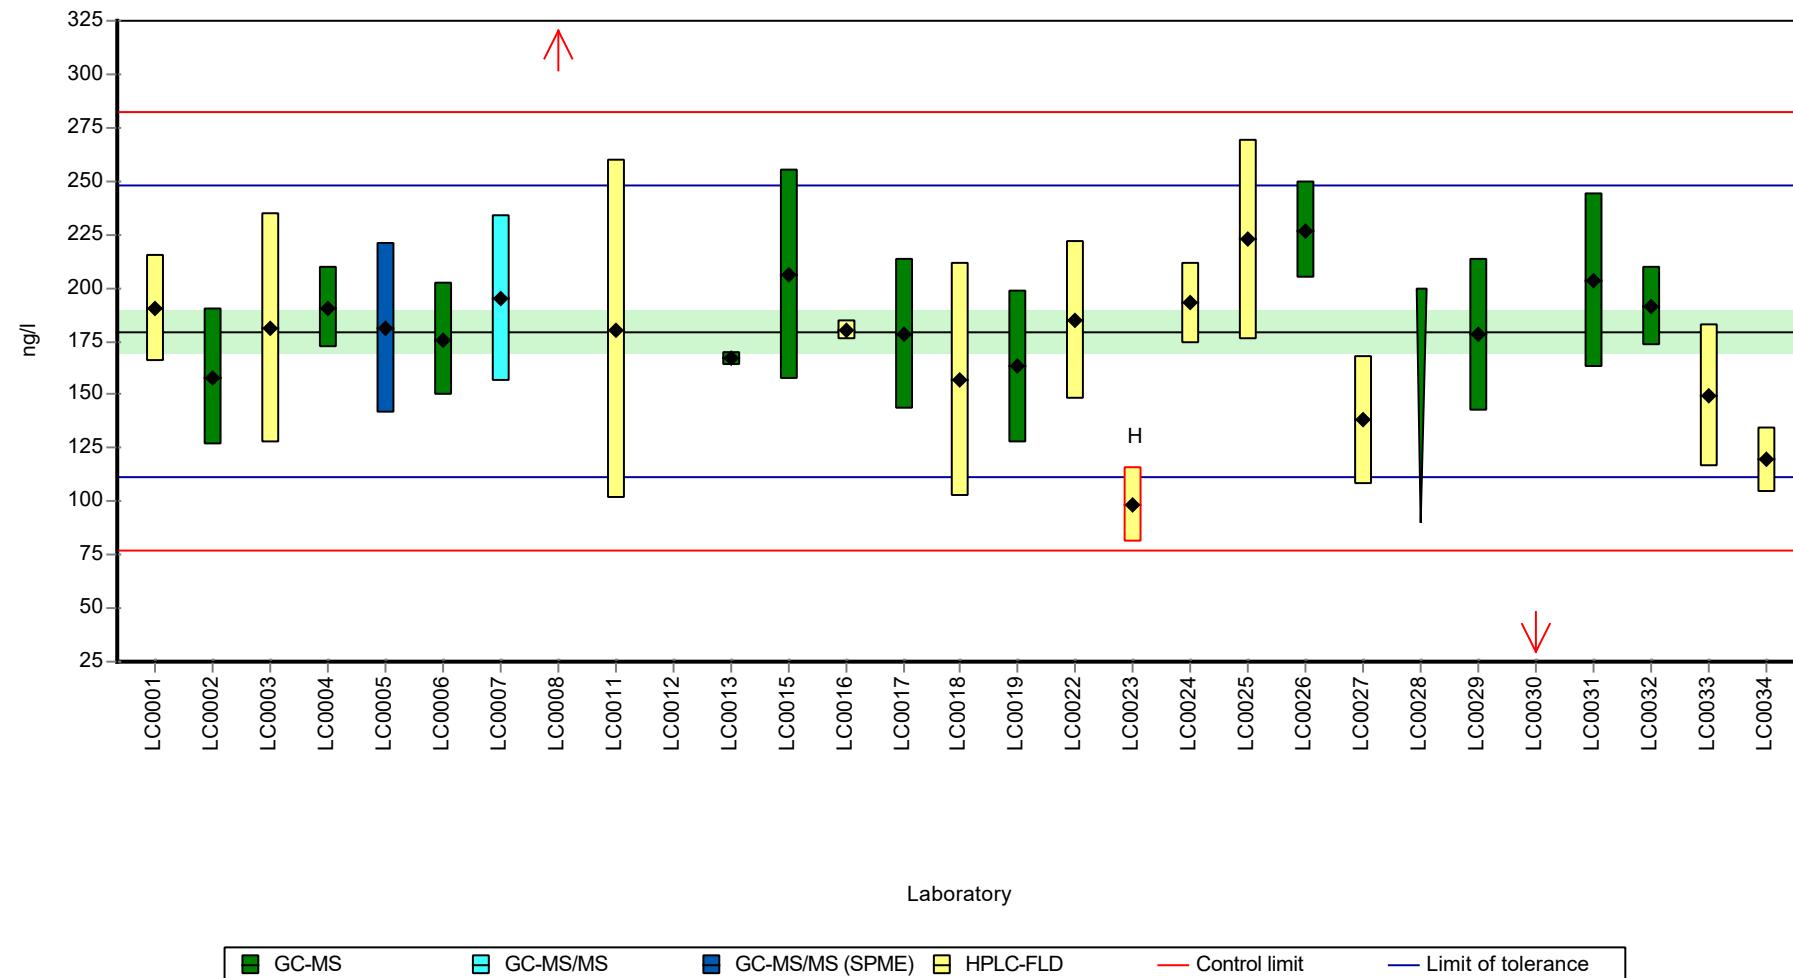


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthene

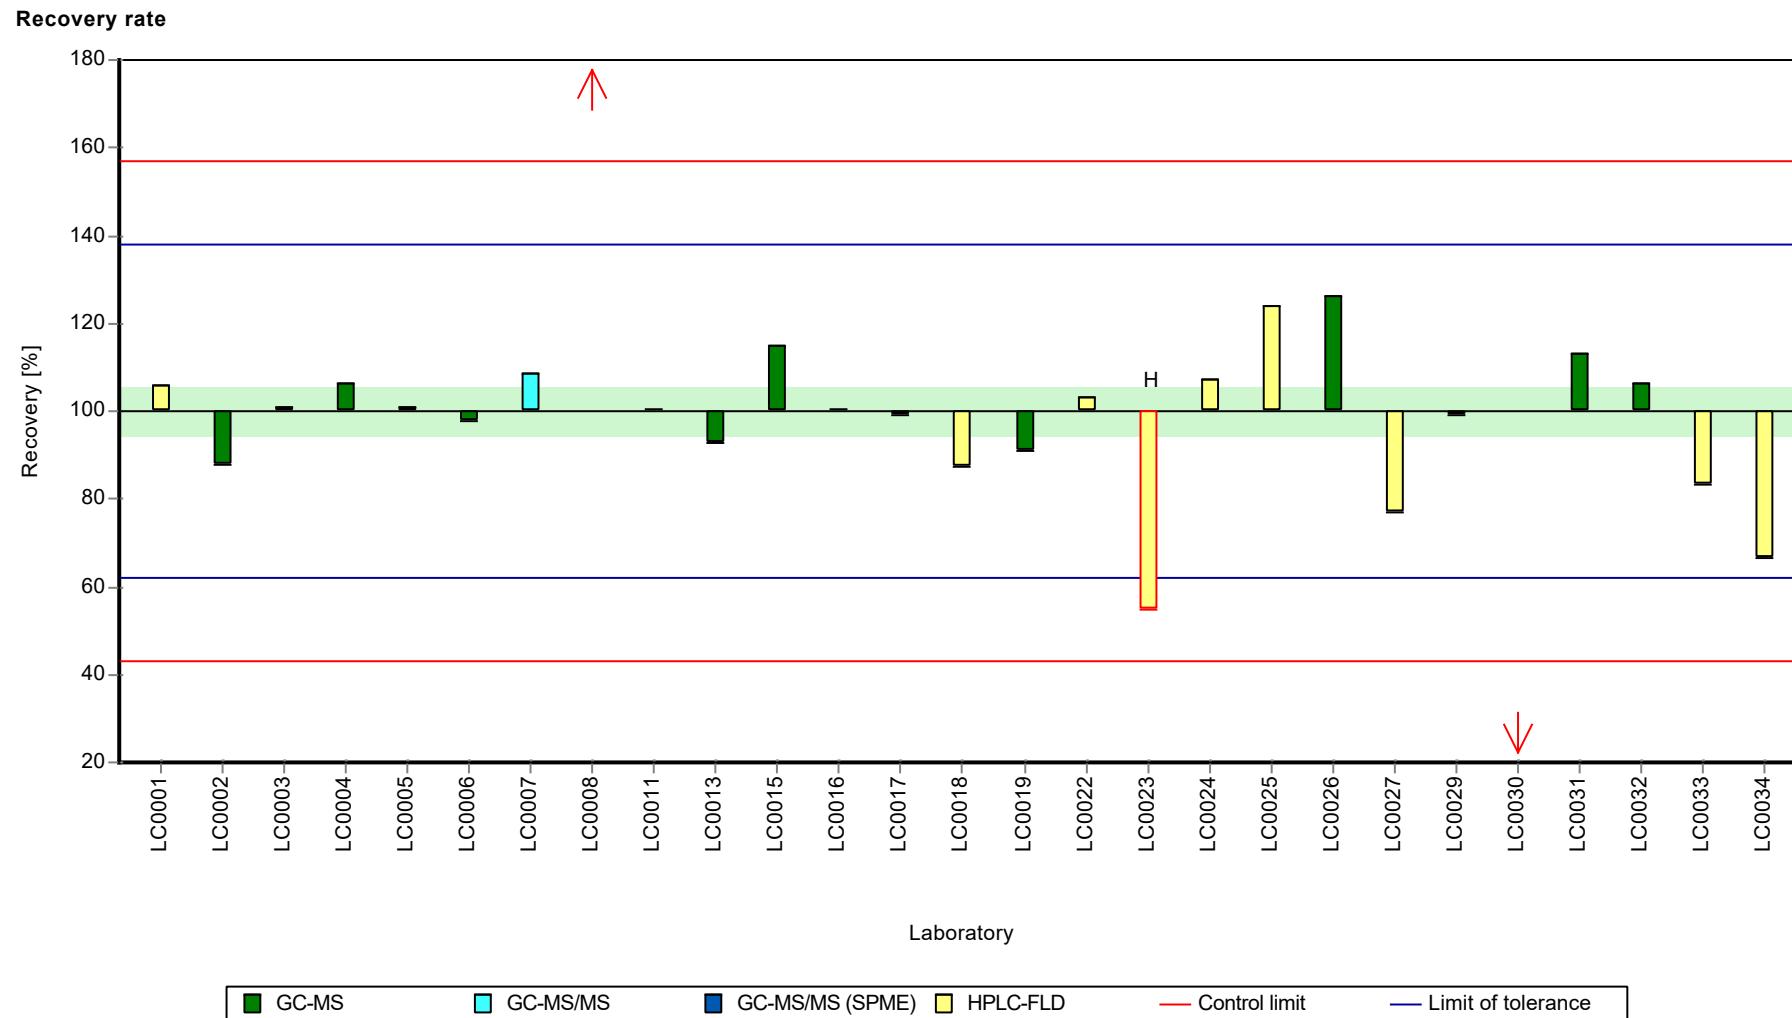

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthene

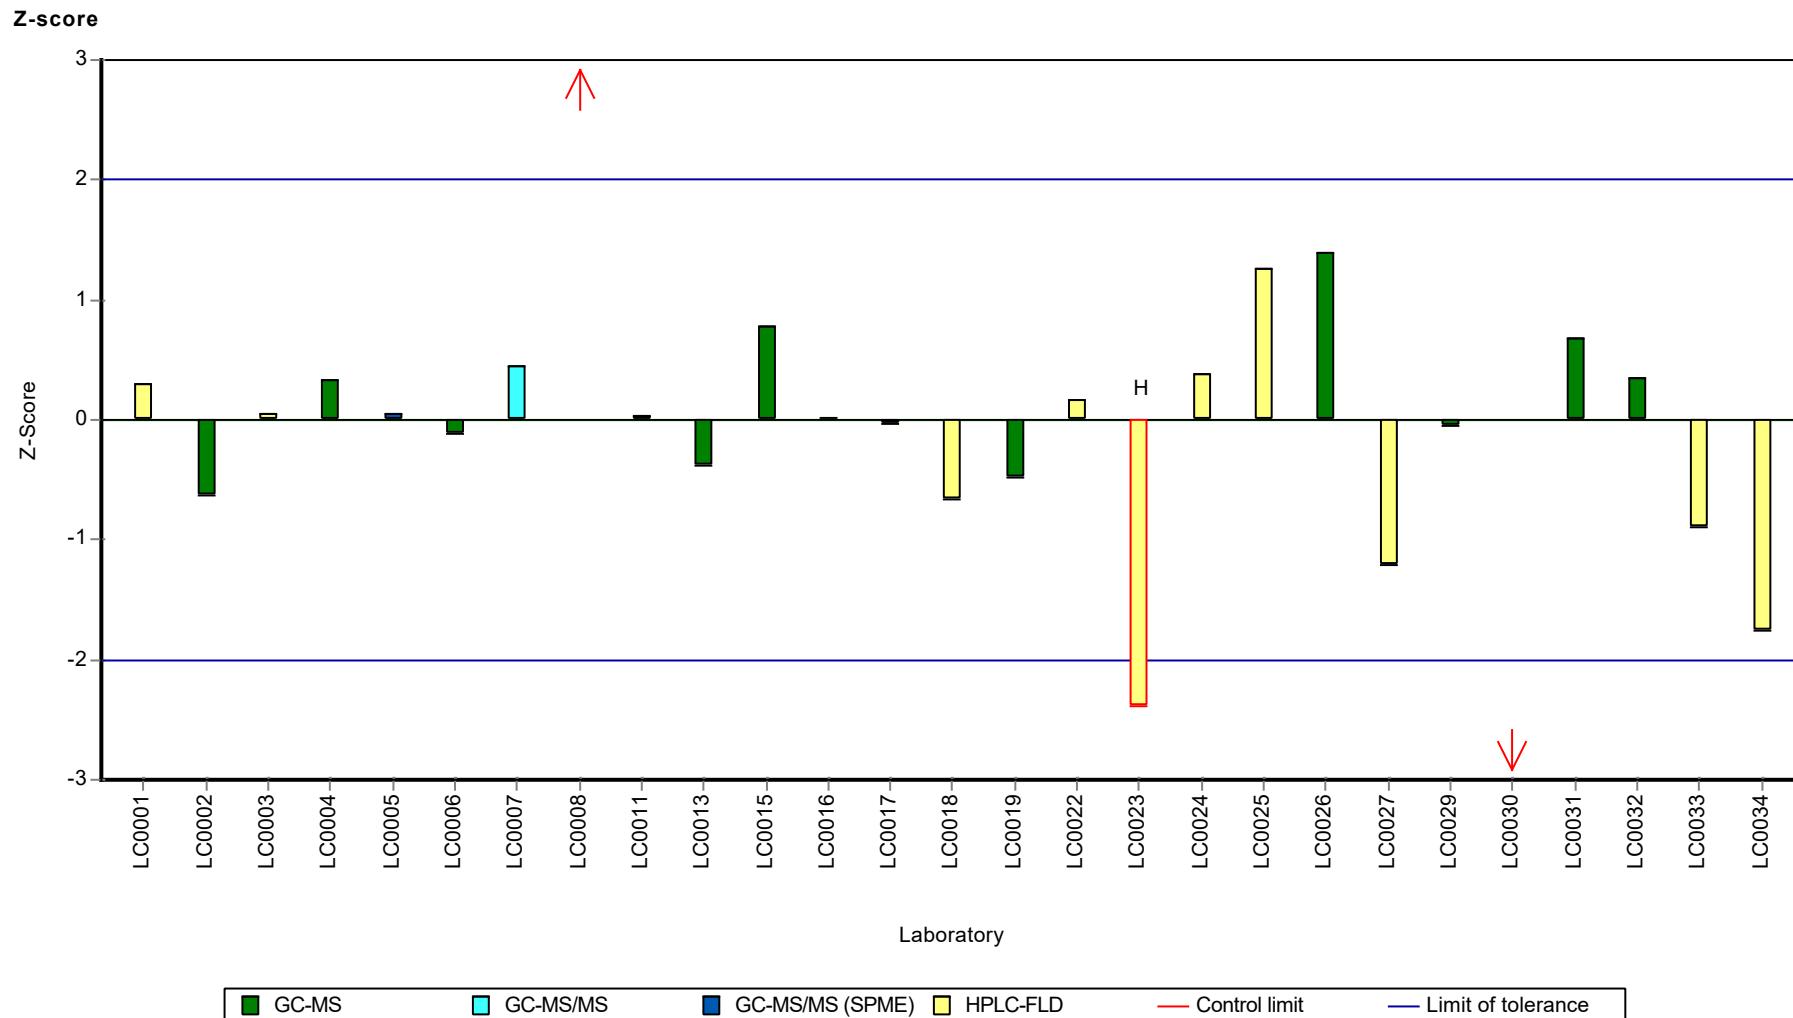

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthylene

Parameter oriented report

P24A

Acenaphthylene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 24.5 \pm 2.84
 Criterion 5.89 (24 %)
 Minimum - Maximum 8.53 - 34.4
 Control test value \pm U (k=2) 33.1 \pm 9.92

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	162	21	660	23.34	H
LC0002	28.4	5.7	116	0.65	
LC0003	21.8	6.53	88.8	-0.47	
LC0004	26.71	3	109	0.37	
LC0005	25.6	5.6	104	0.18	
LC0006	31.45	4.718	128	1.17	
LC0007	17	3	69.3	-1.28	
LC0008	23.9	1.2	97.4	-0.11	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	87.24	38.385	355	10.64	H
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	25.78	0.65	105	0.21	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	27	7	110	0.42	
LC0016	89.5	1.57	365	11.03	H
LC0017	28.3	5.7	115	0.64	
LC0018	26.3	9.21	107	0.3	
LC0019	8.53	1.88	34.8	-2.72	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	34.4	6.9	140	1.67	
LC0023	25.46	7.6	104	0.16	
LC0024	< 25 (LOQ)	-	-	-	
LC0025	-	-	-	-	
LC0026	26.3	1.29	107	0.3	
LC0027	19.7	4.3	80.3	-0.82	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	31.6	6.3	129	1.2	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	
LC0031	11.8	2.4	48.1	-2.16	
LC0032	28.03	1.96	114	0.59	
LC0033	57.5	7.6	234	5.6	H
LC0034	22.8	2.99	92.9	-0.3	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthylene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	37 ± 20.3	24.5 ± 4.26 ng/l
Minimum	8.53	8.53 ng/l
Maximum	162	34.4 ng/l
Standard deviation	33.1	6.35 ng/l
rel. standard deviation	89.5	25.9 %
n	24	20 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthylene


Graphical presentation of results

Results

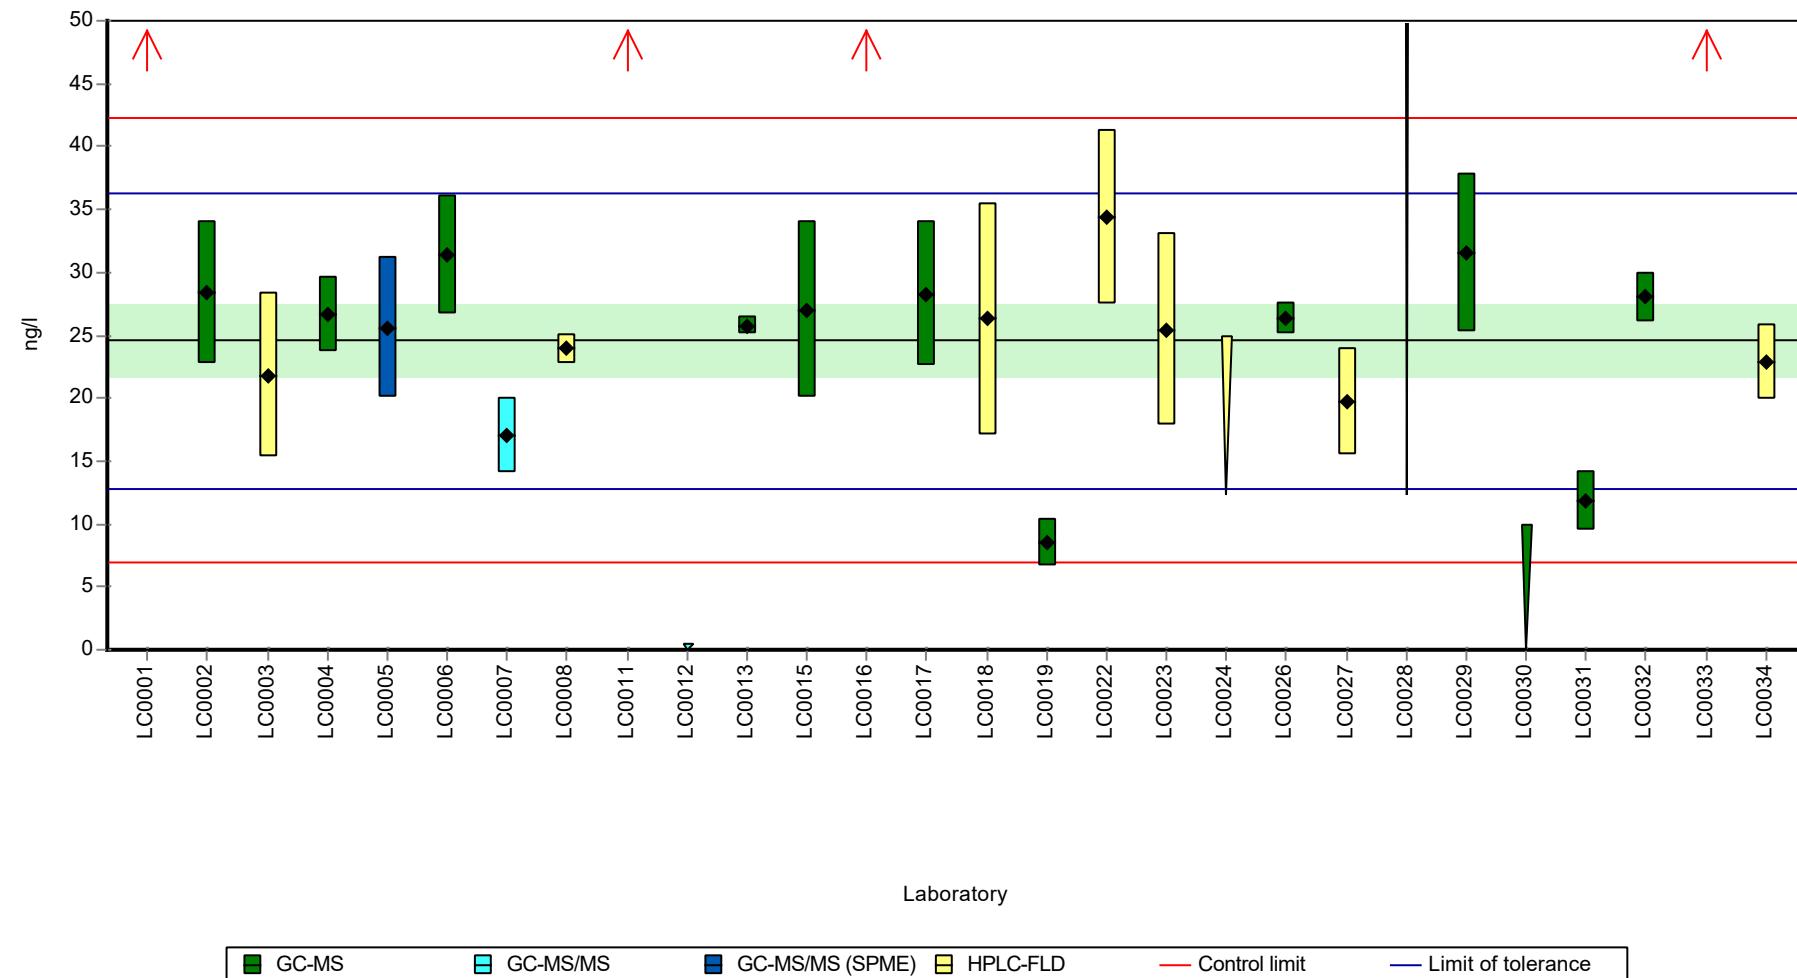


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthylene

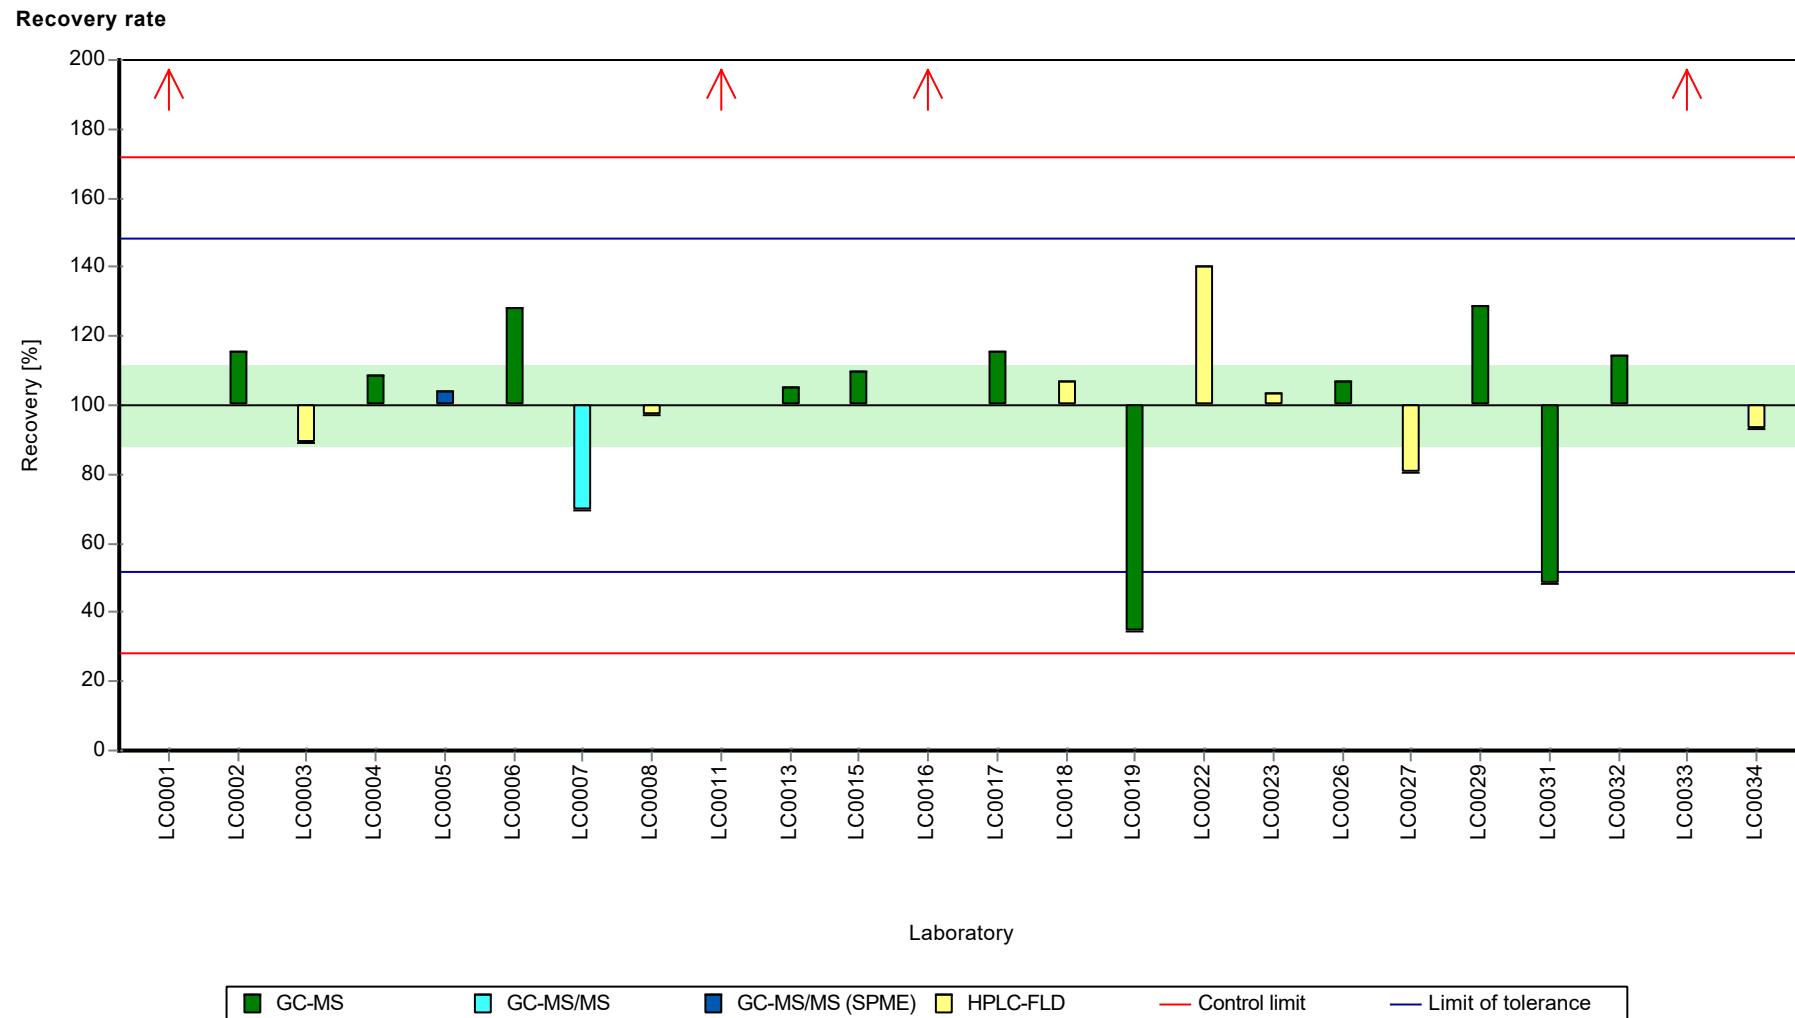

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Acenaphthylene

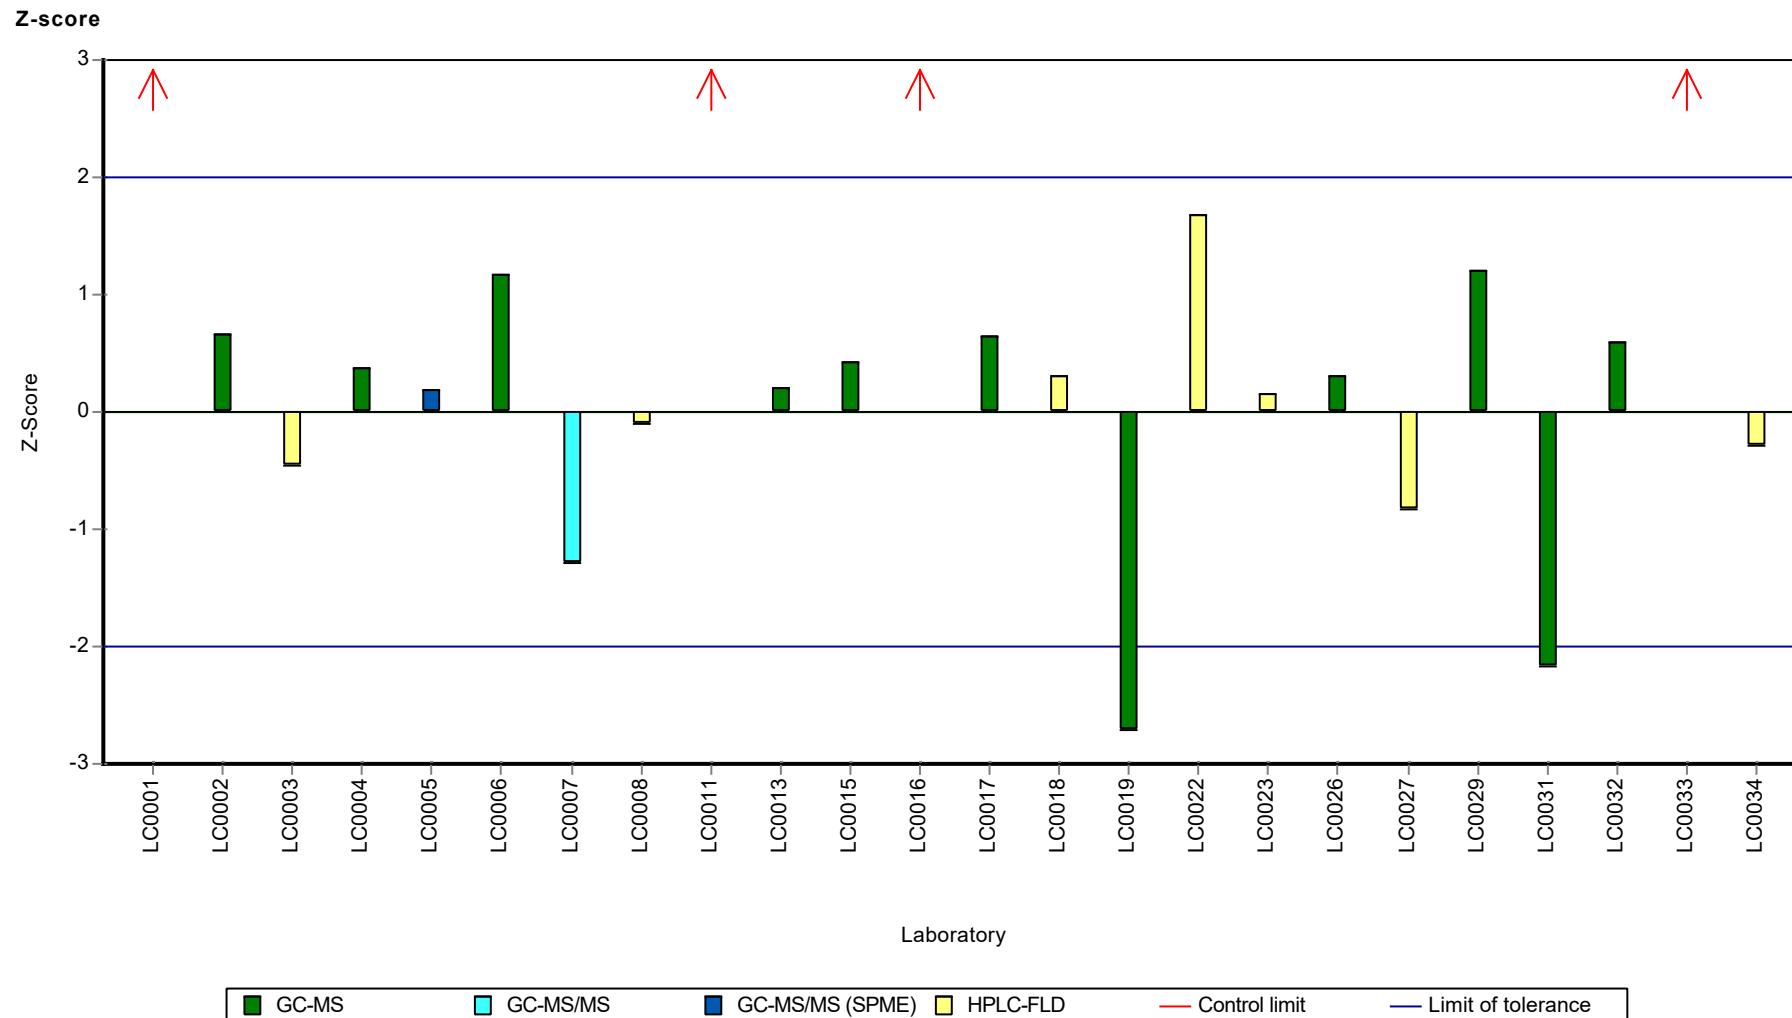

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthylene

Parameter oriented report

P24 B

Acenaphthylene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 143 ± 10.4
 Criterion 34.4 (24 %)
 Minimum - Maximum 104 - 211
 Control test value ± U (k=2) 177.0 ± 53

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	283	37	197	4.06	
LC0002	147	29	103	0.11	
LC0003	141	42.3	98.4	-0.07	
LC0004	148.67	15	104	0.15	
LC0005	138	30	96.3	-0.16	
LC0006	142.06	21.309	99.1	-0.04	
LC0007	130	26	90.7	-0.39	
LC0008	260	5.7	181	3.39	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	259.36	114.119	181	3.37	H
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	134.6	1.82	93.9	-0.25	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	157	38	110	0.4	
LC0016	211	5.19	147	1.97	
LC0017	142.4	28.5	99.3	-0.03	
LC0018	143	50.1	99.8	-0.01	
LC0019	130.54	28.72	91.1	-0.37	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	154	30.8	107	0.31	
LC0023	110.7	19.2	77.2	-0.95	
LC0024	172.5	17.3	120	0.85	
LC0025	-	-	-	-	
LC0026	219	1	153	2.2	H
LC0027	104	23	72.5	-1.14	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	163	33	114	0.57	
LC0030	13.5	2.7	9.4	-3.77	H
LC0031	158	32	110	0.43	
LC0032	150.42	10.53	105	0.21	
LC0033	128.6	17	89.7	-0.43	
LC0034	103.9	13.64	72.5	-1.15	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Acenaphthylene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	156 ± 32.6	143 ± 15.5 ng/l
Minimum	13.5	104 ng/l
Maximum	283	211 ng/l
Standard deviation	55.3	23.7 ng/l
rel. standard deviation	35.6	16.6 %
n	26	21 -


Graphical presentation of results

Results

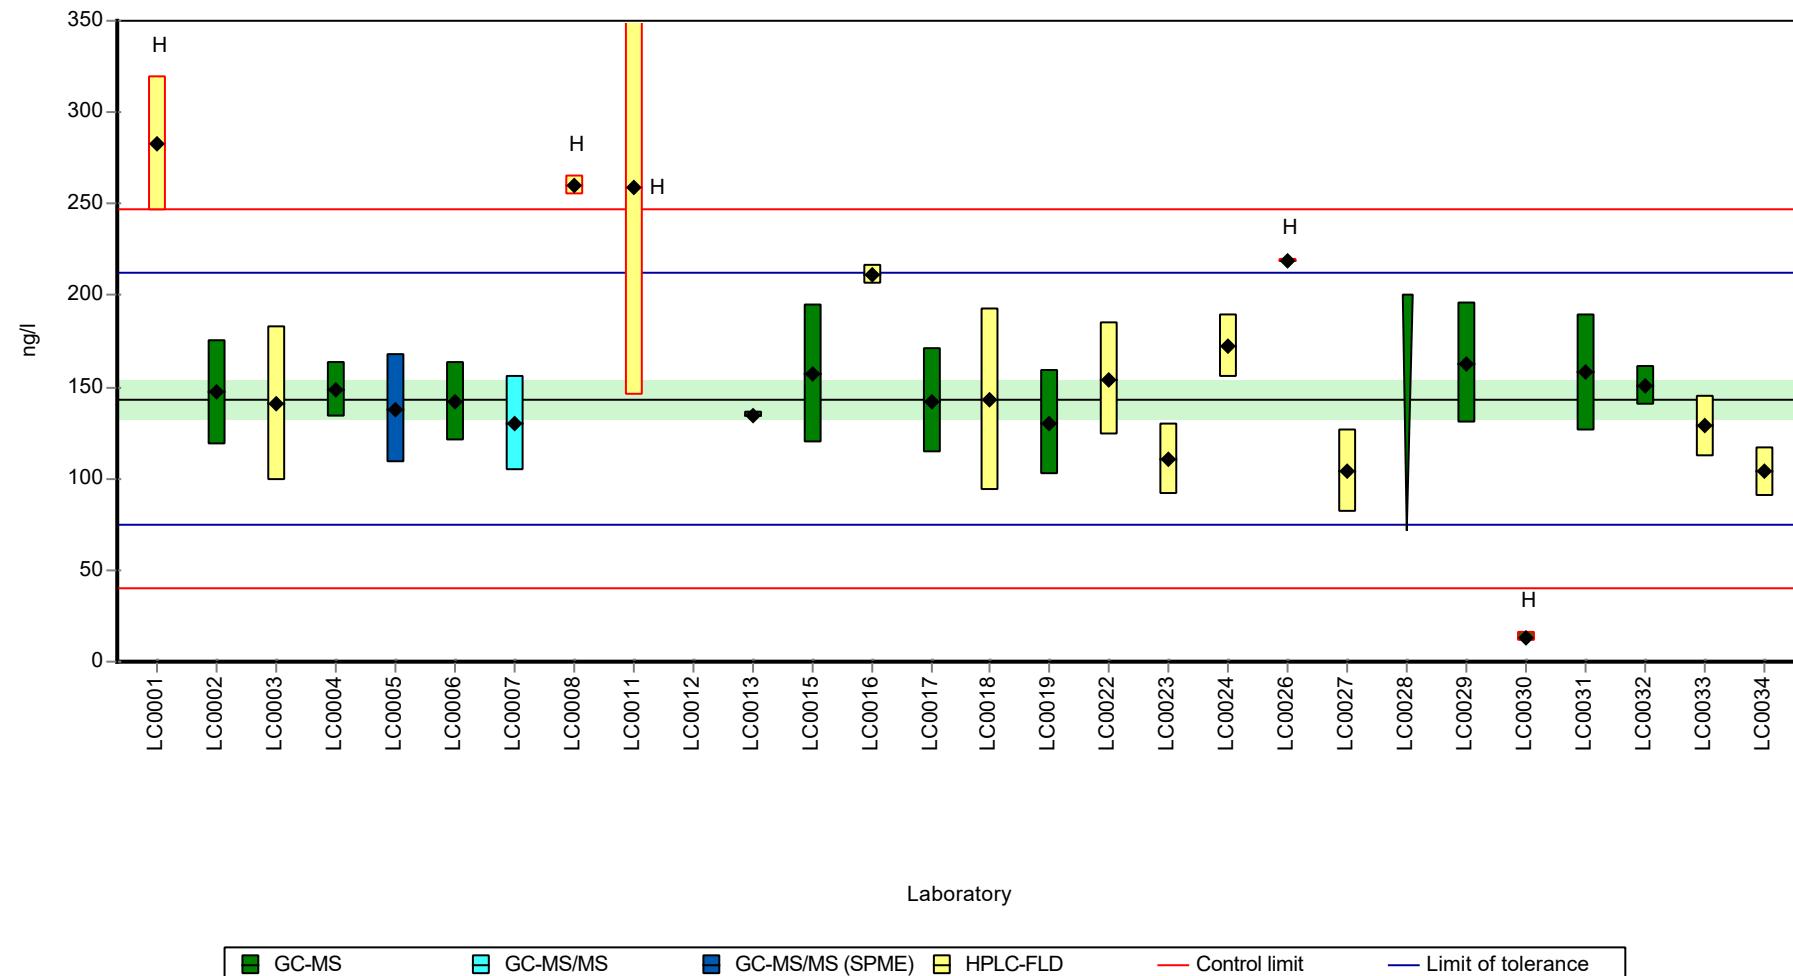


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthylene

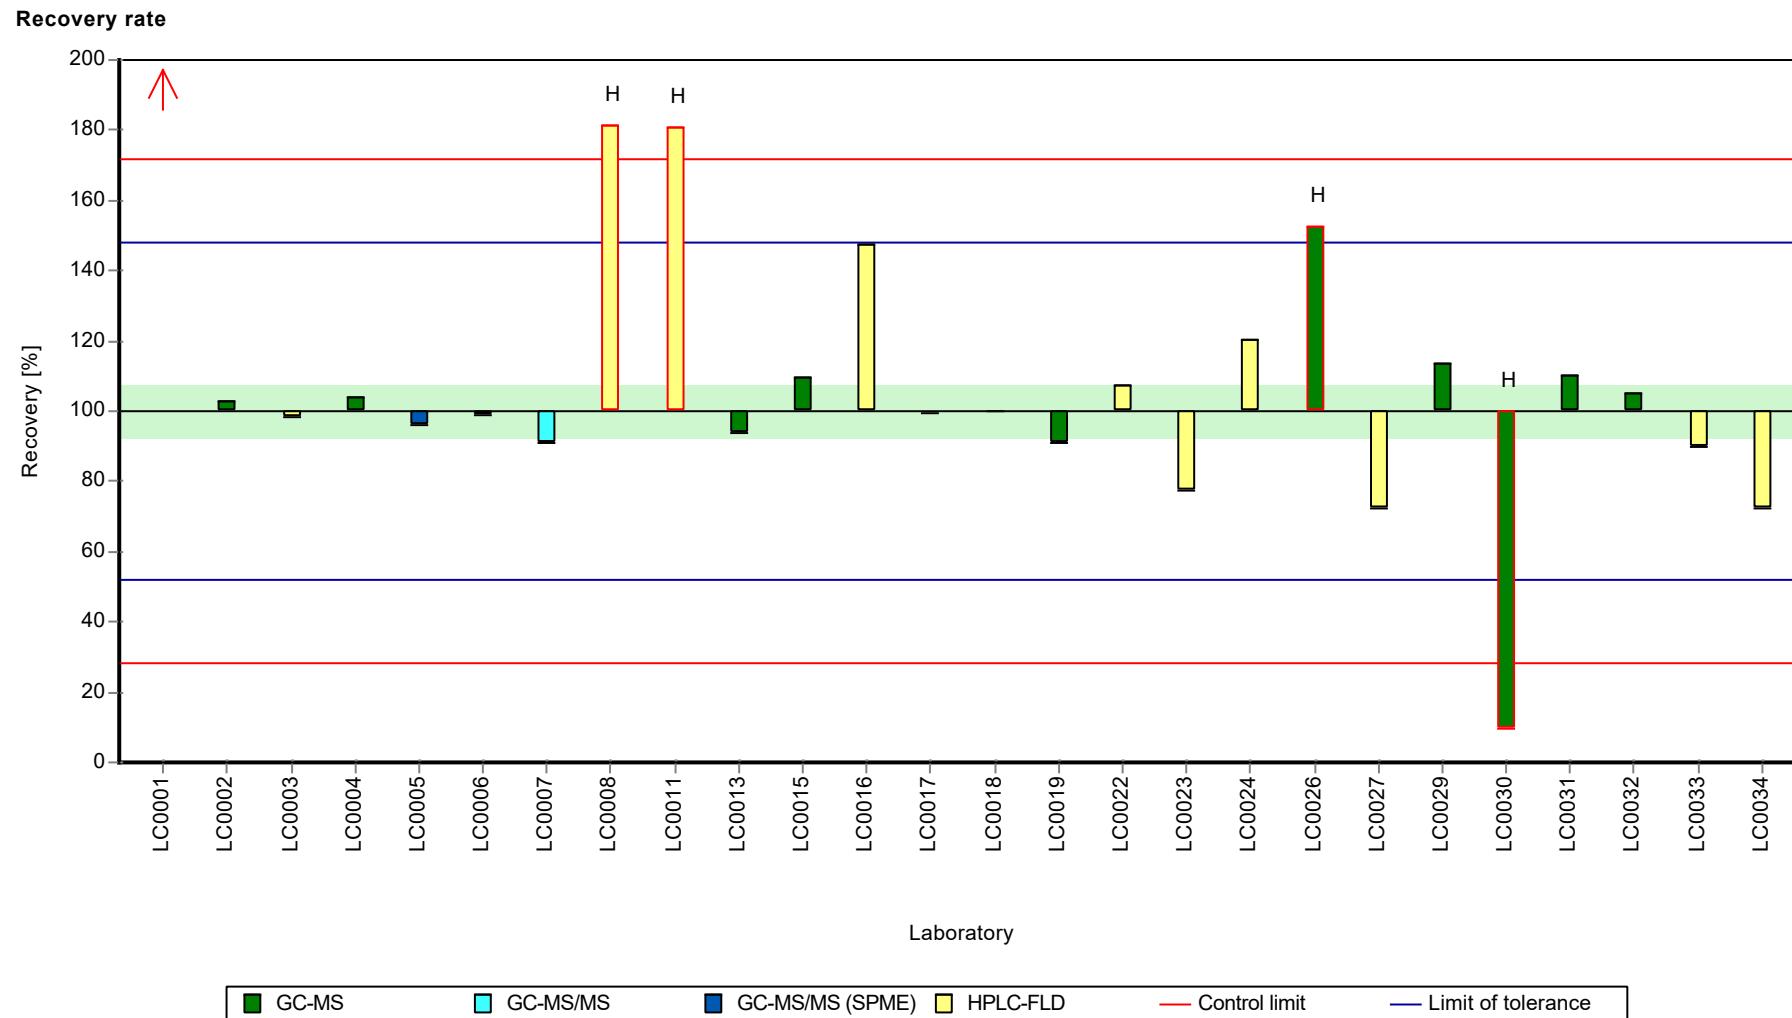

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Acenaphthylene

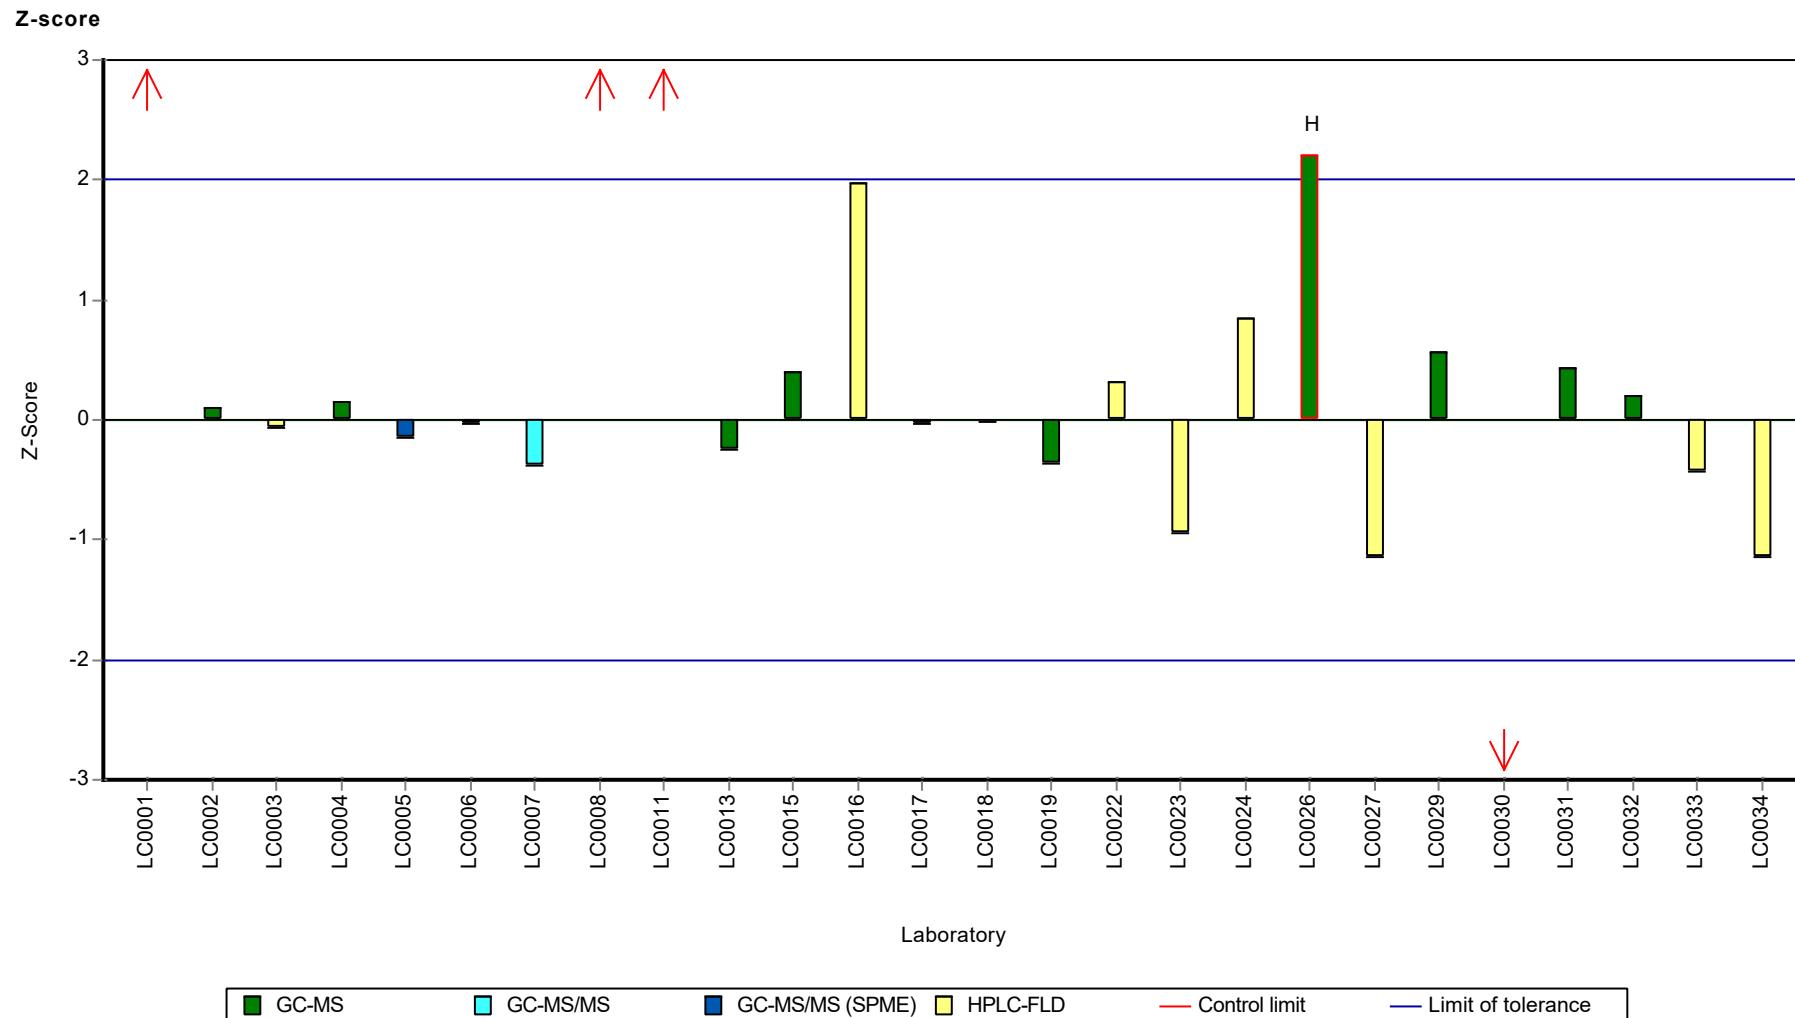

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Anthracene

Parameter oriented report

P24A

Anthracene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 24.6 ± 1.09
 Criterion 6.39 (26 %)
 Minimum - Maximum 18 - 31.3
 Control test value ± U (k=2) 31.7 ± 7.93

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	24.9	3.2	101	0.05	
LC0002	24.9	5	101	0.05	
LC0003	25.2	7.56	102	0.09	
LC0004	26.09	3	106	0.23	
LC0005	21.9	4.8	89	-0.42	
LC0006	25.66	3.849	104	0.17	
LC0007	18	4	73.2	-1.03	
LC0008	25.9	0.65	105	0.2	
LC0009	21.65	9.53	88	-0.46	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	31.29	13.769	127	1.05	
LC0012	9.55	0.1	38.8	-2.35	H
LC0013	25.2	0.14	102	0.09	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	26	7	106	0.22	
LC0016	22.5	1.37	91.5	-0.33	
LC0017	25.7	5.1	105	0.17	
LC0018	23.7	8.3	96.4	-0.14	
LC0019	9.91	2.18	40.3	-2.3	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	29.1	5.8	118	0.7	
LC0023	25.44	6.3	103	0.13	
LC0024	27.6	2.8	112	0.47	
LC0025	22.8	4.79	92.7	-0.28	
LC0026	27.8	2.5	113	0.5	
LC0027	21.4	4.7	87	-0.5	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	24.9	5	101	0.05	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	21.8	4.1	88.6	-0.44	
LC0032	25.09	1.97	102	0.08	
LC0033	24	1.6	97.6	-0.09	
LC0034	20.9	1.54	85	-0.58	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Anthracene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	23.5 ± 2.68	24.6 ± 1.64 ng/l
Minimum	9.55	18 ng/l
Maximum	31.3	31.3 ng/l
Standard deviation	4.73	2.79 ng/l
rel. standard deviation	20.1	11.3 %
n	28	26 -


Graphical presentation of results

Results

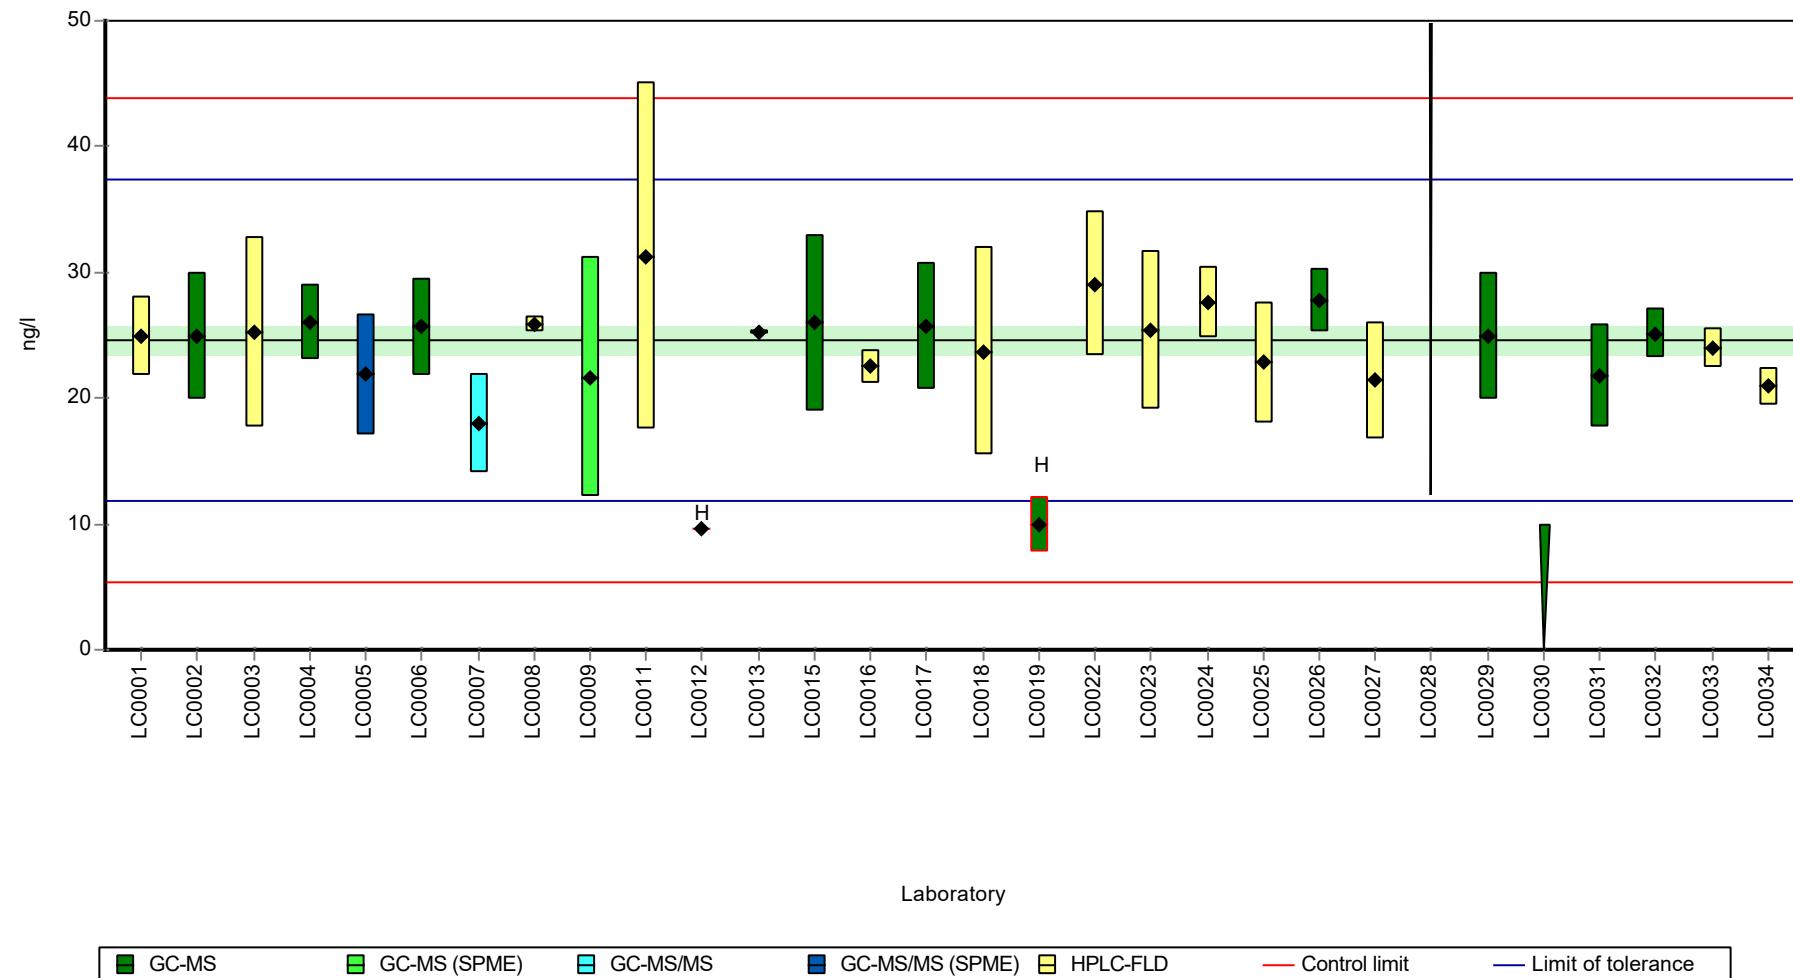


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Anthracene

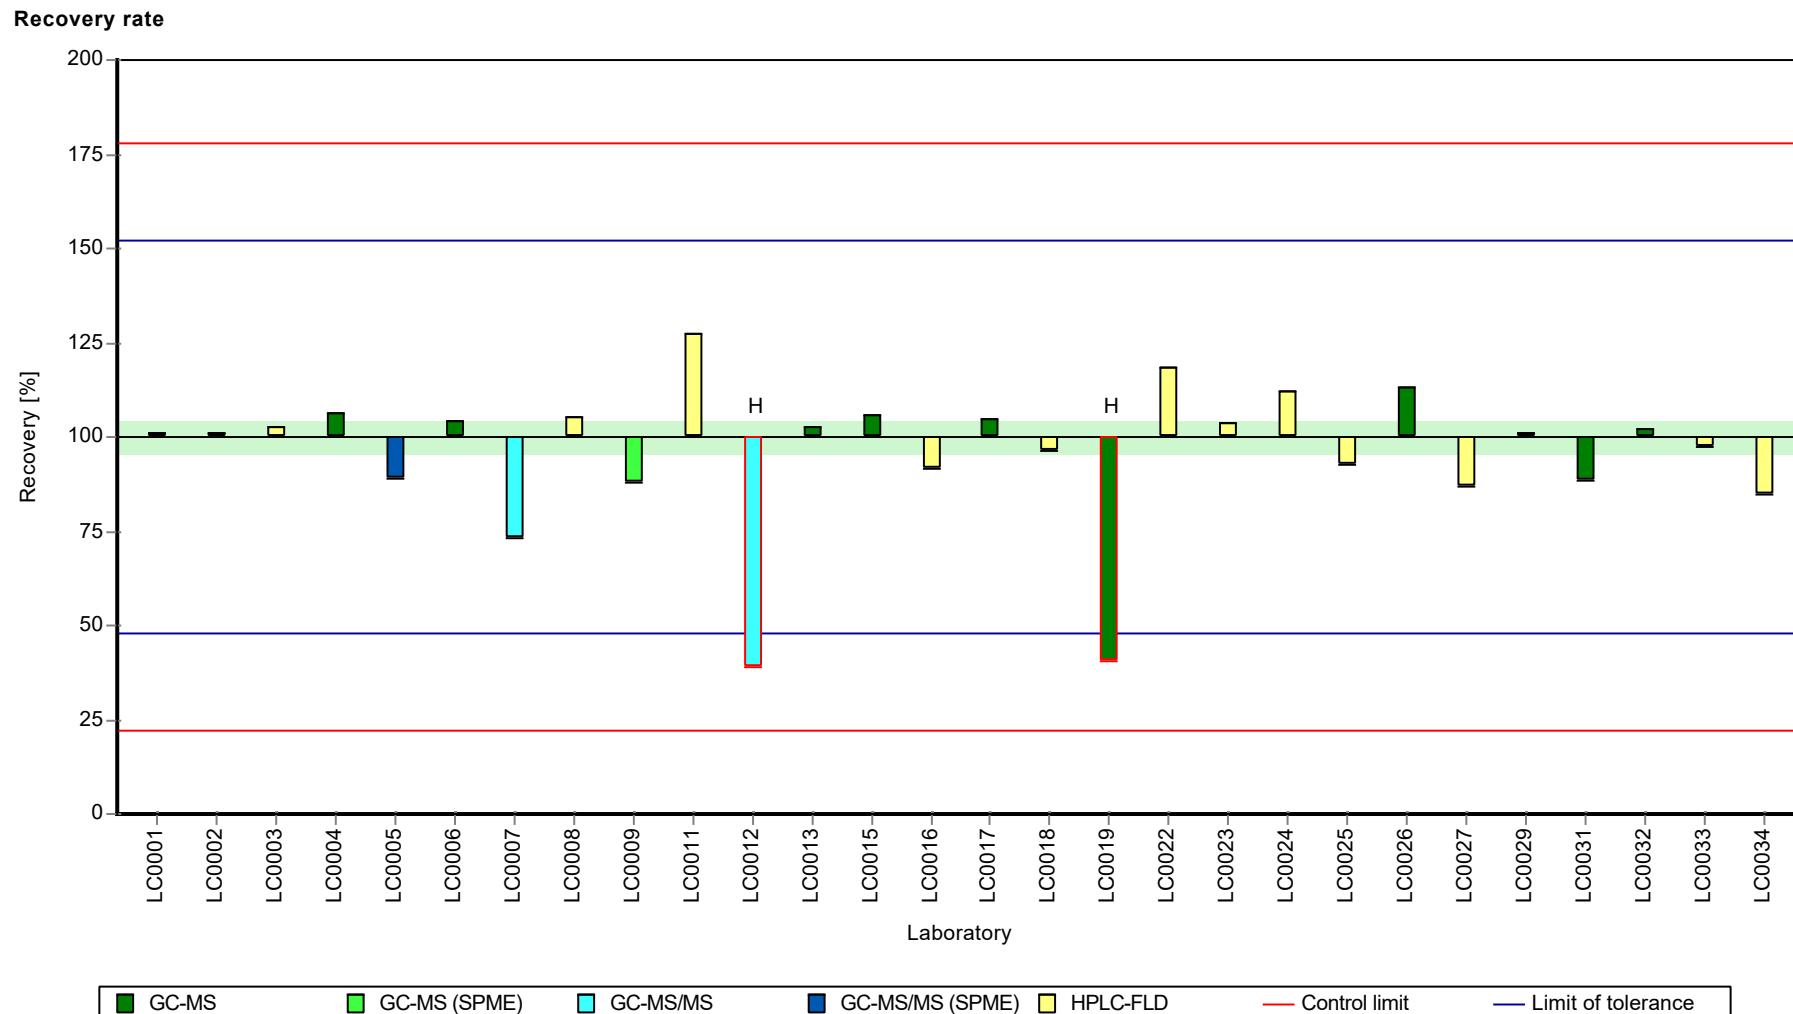

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Anthracene

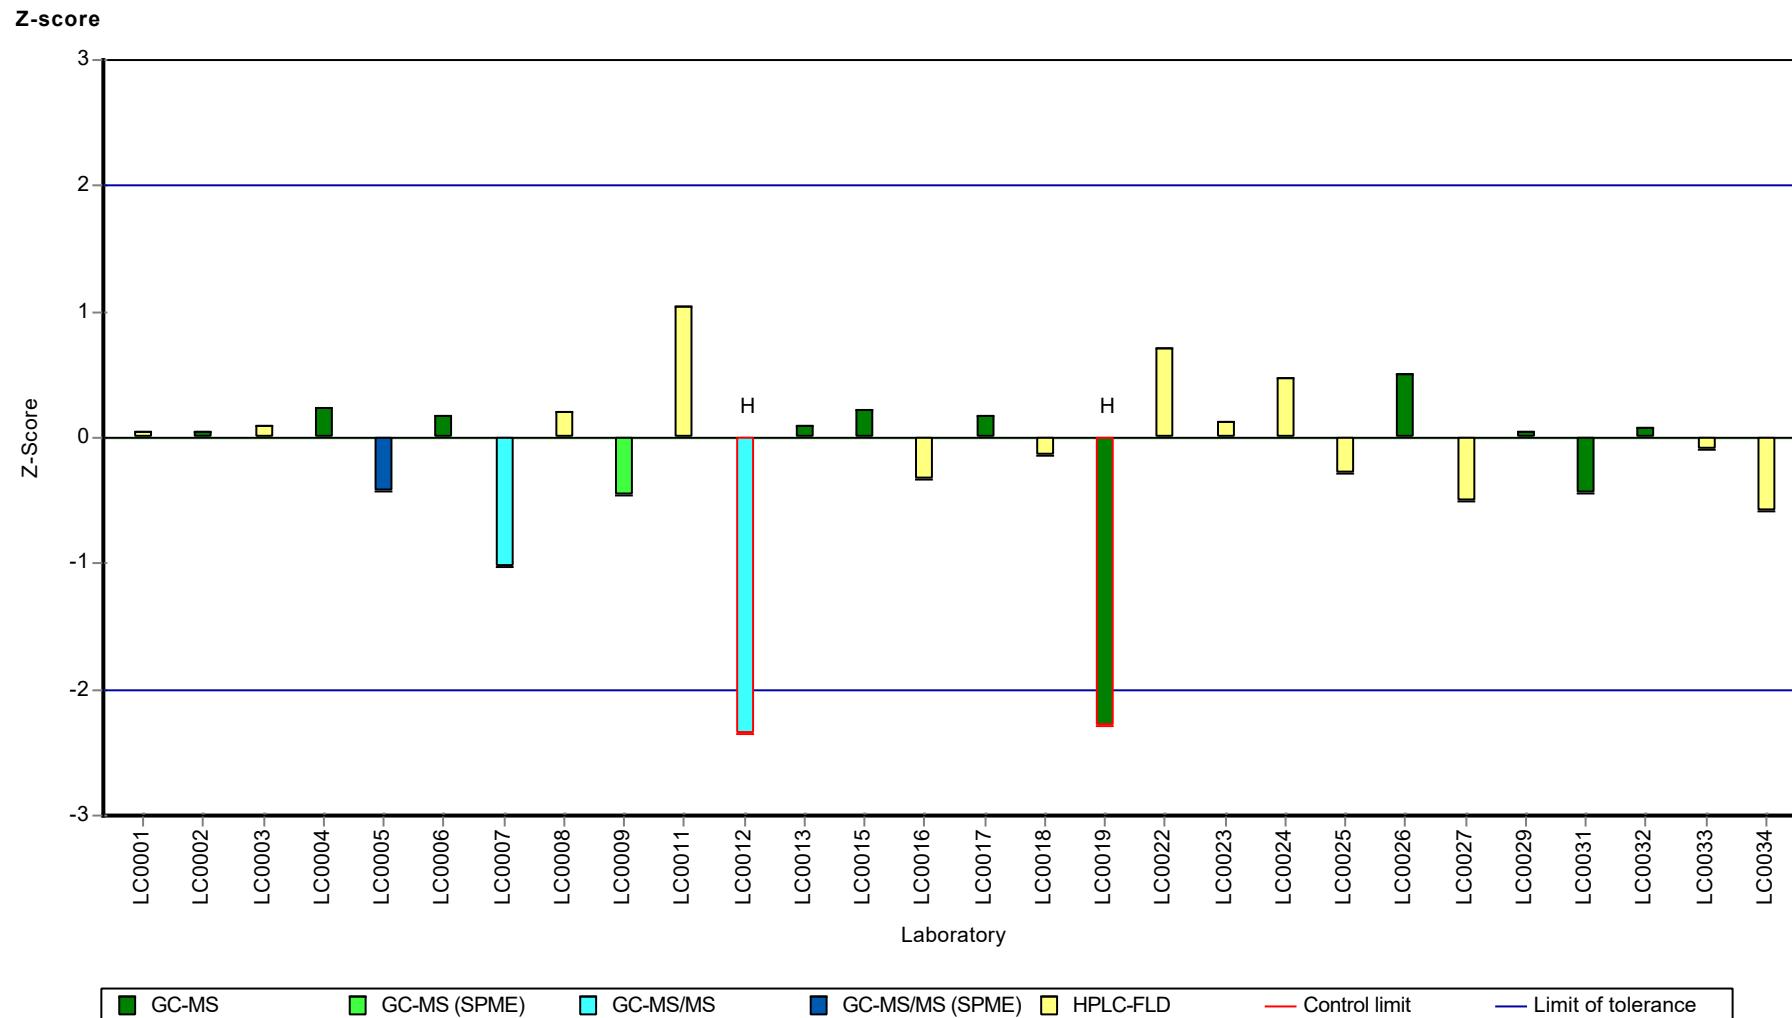

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Anthracene

Parameter oriented report

P24 B

Anthracene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 181 ± 7.66
 Criterion 47.2 (26 %)
 Minimum - Maximum 146 - 211
 Control test value ± U (k=2) 216.0 ± 54

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	207	27	114	0.54	
LC0002	179	36	98.6	-0.05	
LC0003	187	56	103	0.12	
LC0004	204.37	20	113	0.49	
LC0005	171	38	94.2	-0.22	
LC0006	179.15	26.873	98.7	-0.05	
LC0007	157	31	86.5	-0.52	
LC0008	361	11	199	3.81	H
LC0009	177.6	78.1	97.9	-0.08	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	178.24	78.427	98.2	-0.07	
LC0012	339.5212	0.1	187	3.35	H
LC0013	172	2.25	94.8	-0.2	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	198	48	109	0.35	
LC0016	199	5.65	110	0.37	
LC0017	186.1	37.2	103	0.1	
LC0018	175	61.3	96.4	-0.14	
LC0019	170.43	37.49	93.9	-0.23	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	210	42	116	0.6	
LC0023	148.1	22.6	81.6	-0.71	
LC0024	211.4	21.1	117	0.63	
LC0025	178.9	37.57	98.6	-0.05	
LC0026	277	8.5	153	2.03	H
LC0027	152	33	83.8	-0.62	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	205	41	113	0.5	
LC0030	21.5	4.3	11.8	-3.39	H
LC0031	195	37	107	0.29	
LC0032	184.45	14.48	102	0.06	
LC0033	164.7	11	90.8	-0.36	
LC0034	146	10.76	80.5	-0.75	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Anthracene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	191 ± 33	181 ± 11.5 ng/l
Minimum	21.5	146 ng/l
Maximum	361	211 ng/l
Standard deviation	59.2	19.1 ng/l
rel. standard deviation	31	10.5 %
n	29	25 -


Graphical presentation of results

Results

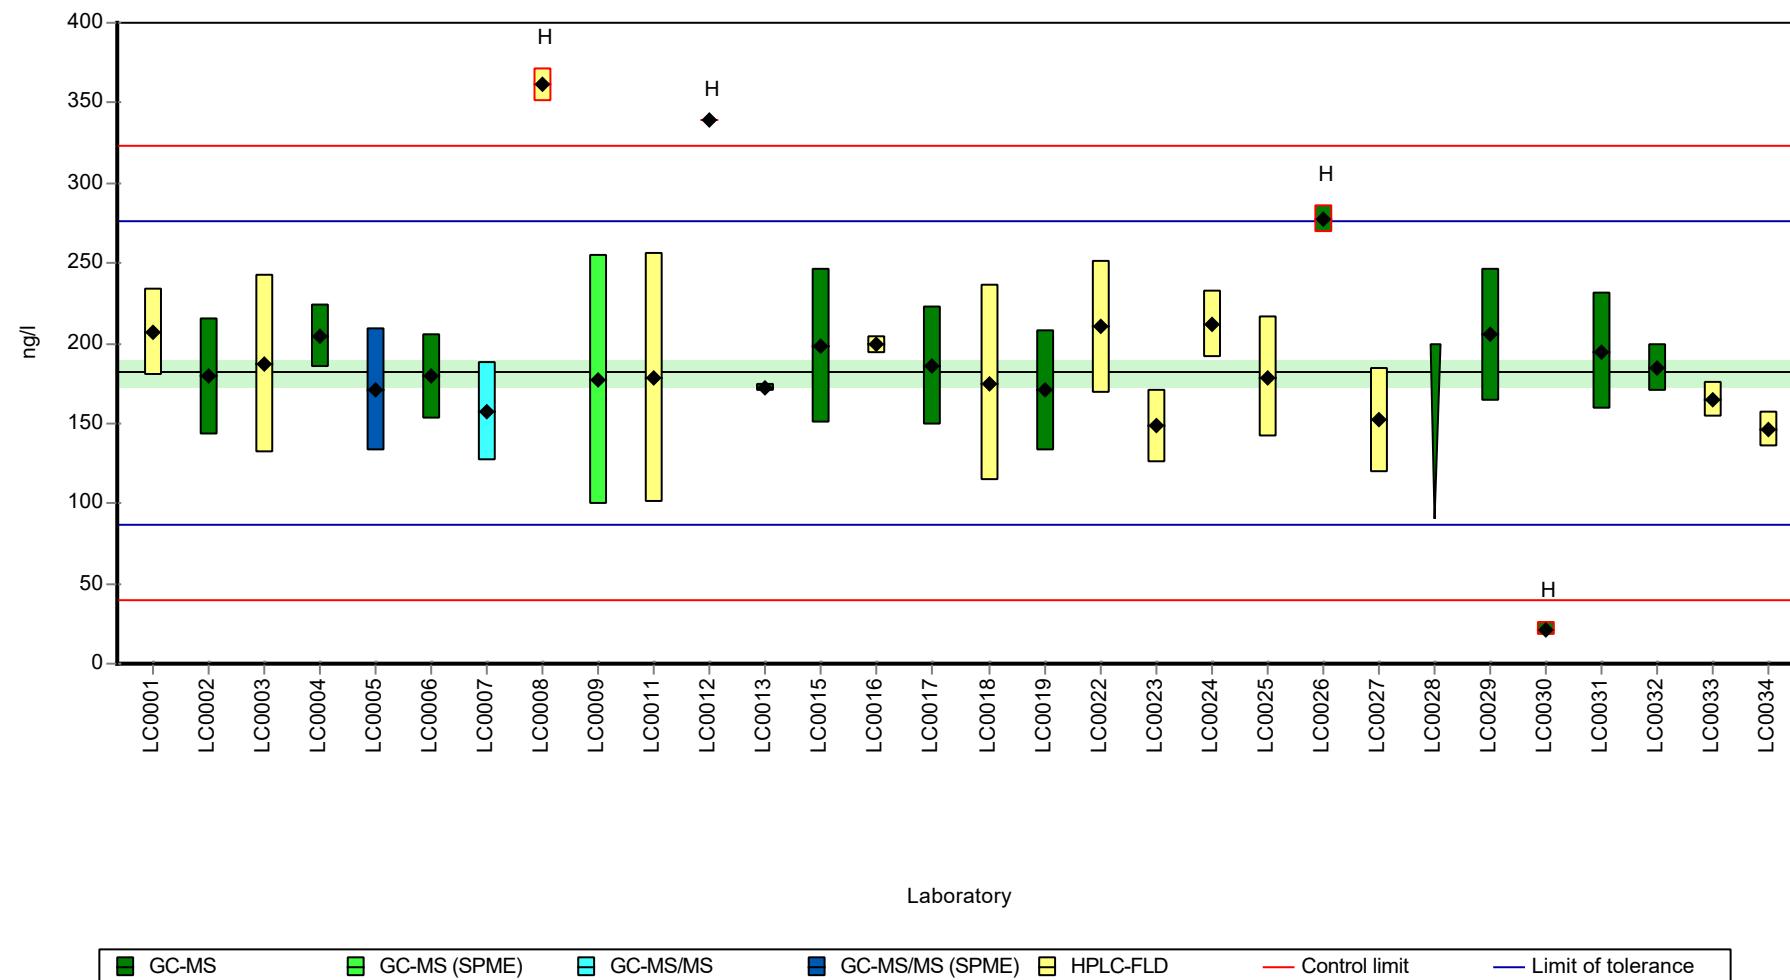


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Anthracene

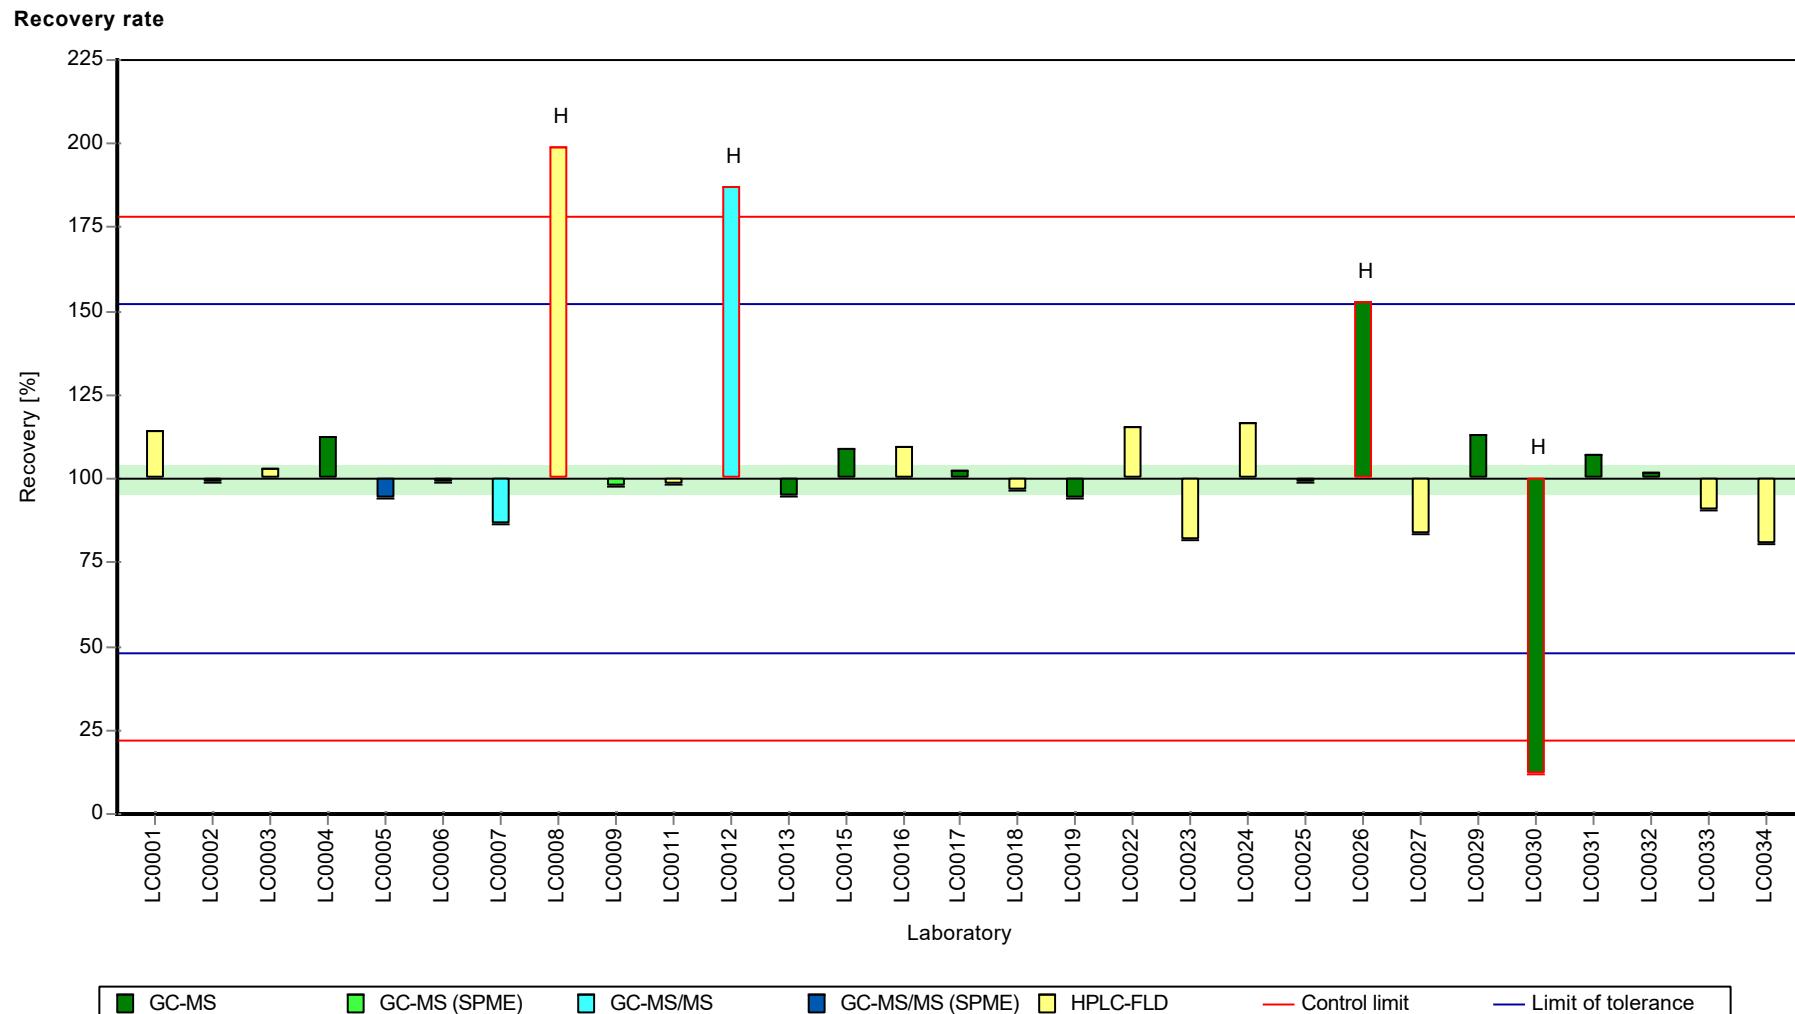

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Anthracene

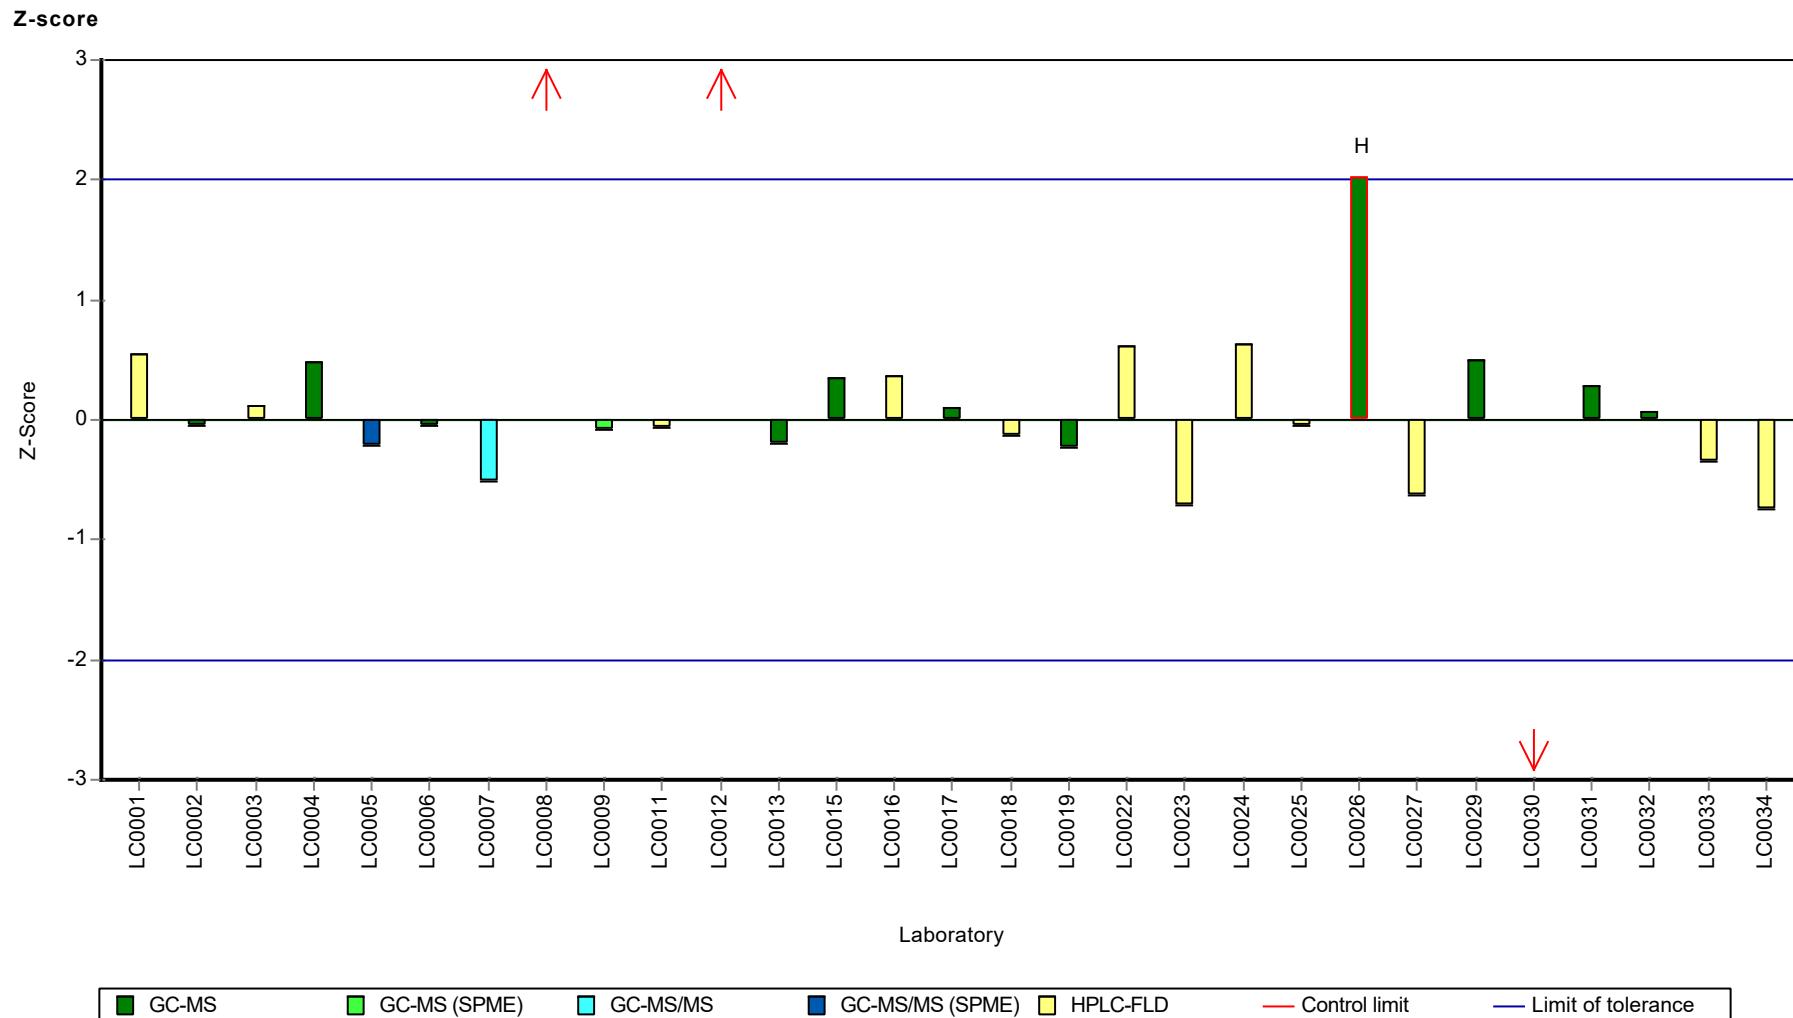

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]anthracene

Parameter oriented report

P24A

Benzo[a]anthracene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 22.7 ± 1.46
 Criterion 4.77 (21 %)
 Minimum - Maximum 15 - 31
 Control test value ± U (k=2) 26.3 ± 6.57

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	24.6	3.2	108	0.39	
LC0002	22.2	4.4	97.6	-0.11	
LC0003	21.9	6.57	96.3	-0.18	
LC0004	25.22	2.5	111	0.52	
LC0005	19.6	4.3	86.2	-0.66	
LC0006	24.33	3.65	107	0.33	
LC0007	15	3	66	-1.62	
LC0008	23.5	0.25	103	0.16	
LC0009	19.83	8.73	87.2	-0.61	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	31.02	13.65	136	1.74	
LC0012	5.59	0.24	24.6	-3.59	H
LC0013	24.06	0.44	106	0.28	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	17	4	74.8	-1.2	
LC0016	24.2	1.55	106	0.31	
LC0017	24.4	4.9	107	0.35	
LC0018	22.7	7.95	99.8	-0.01	
LC0019	-	-	-	-	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	27.6	5.5	121	1.02	
LC0023	24.7	6.4	109	0.41	
LC0024	23.7	2.4	104	0.2	
LC0025	22.8	4.79	100	0.01	
LC0026	30.9	3.4	136	1.71	
LC0027	20	4.4	88	-0.57	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	18.9	3.8	83.1	-0.8	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	22.8	2.8	100	0.01	
LC0032	21.07	4.575	92.7	-0.35	
LC0033	21.1	3.2	92.8	-0.34	
LC0034	18	1.89	79.2	-0.99	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]anthracene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	22.1 ± 2.84	22.7 ± 2.19 ng/l
Minimum	5.59	15 ng/l
Maximum	31	31 ng/l
Standard deviation	4.92	3.72 ng/l
rel. standard deviation	22.2	16.3 %
n	27	26 -


Graphical presentation of results

Results

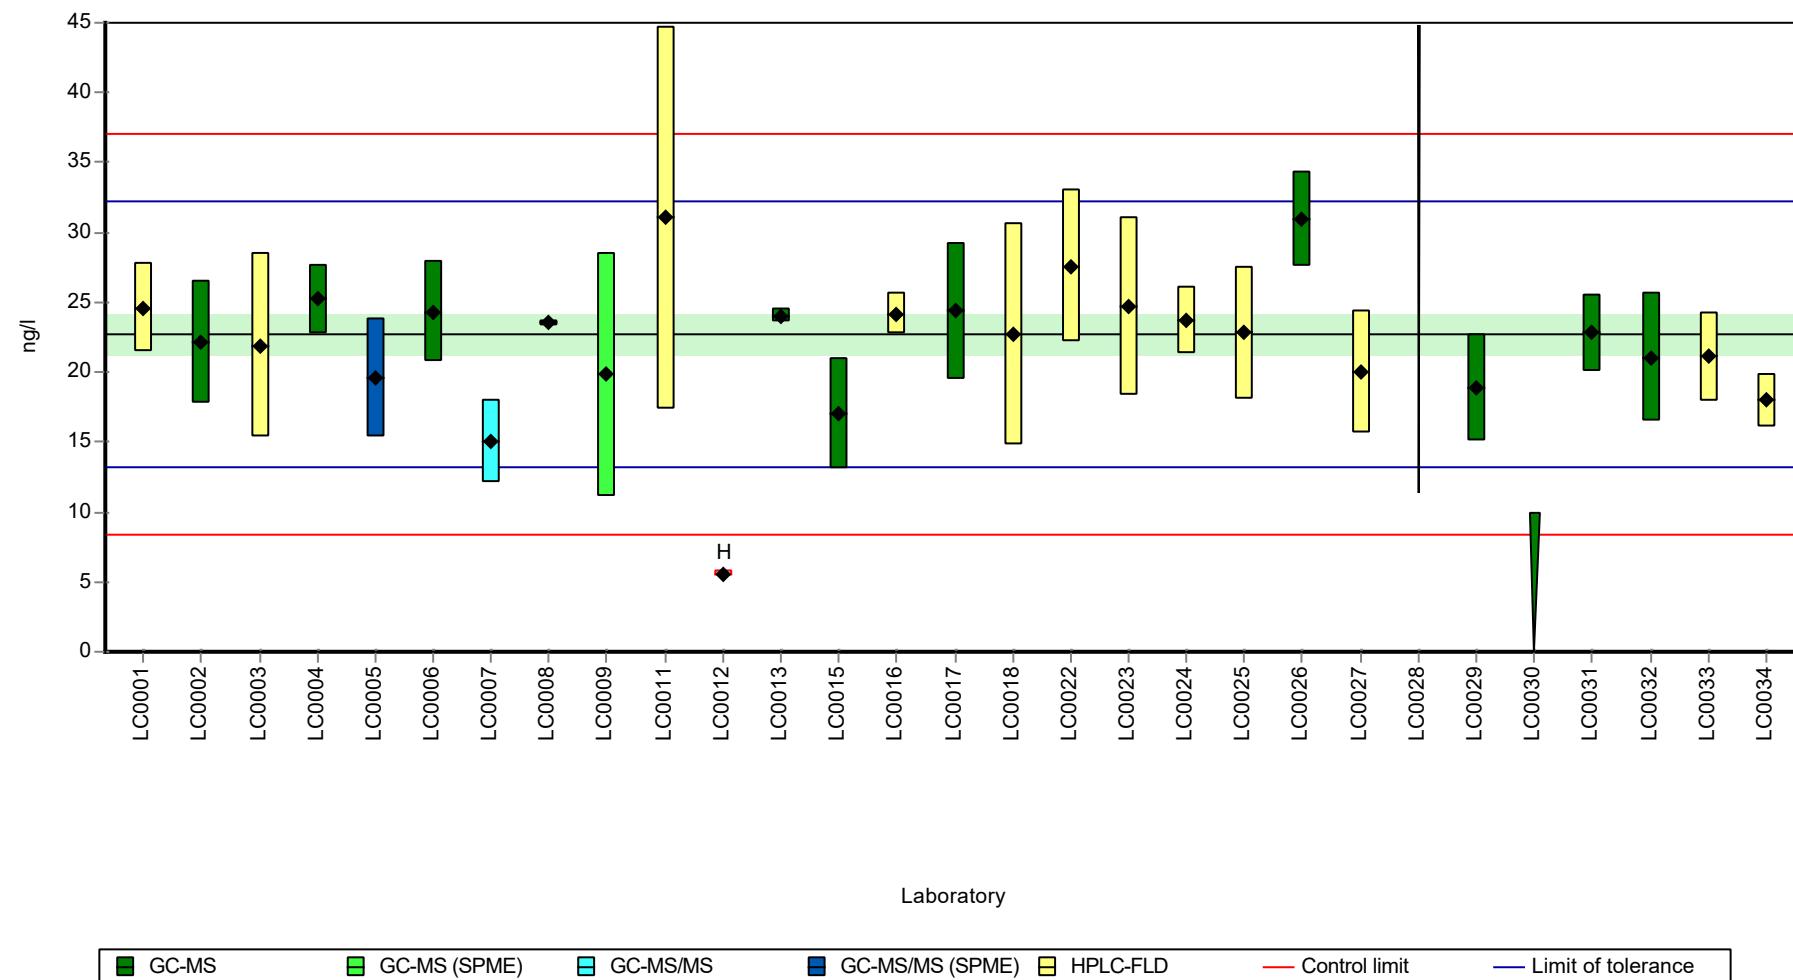


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]anthracene

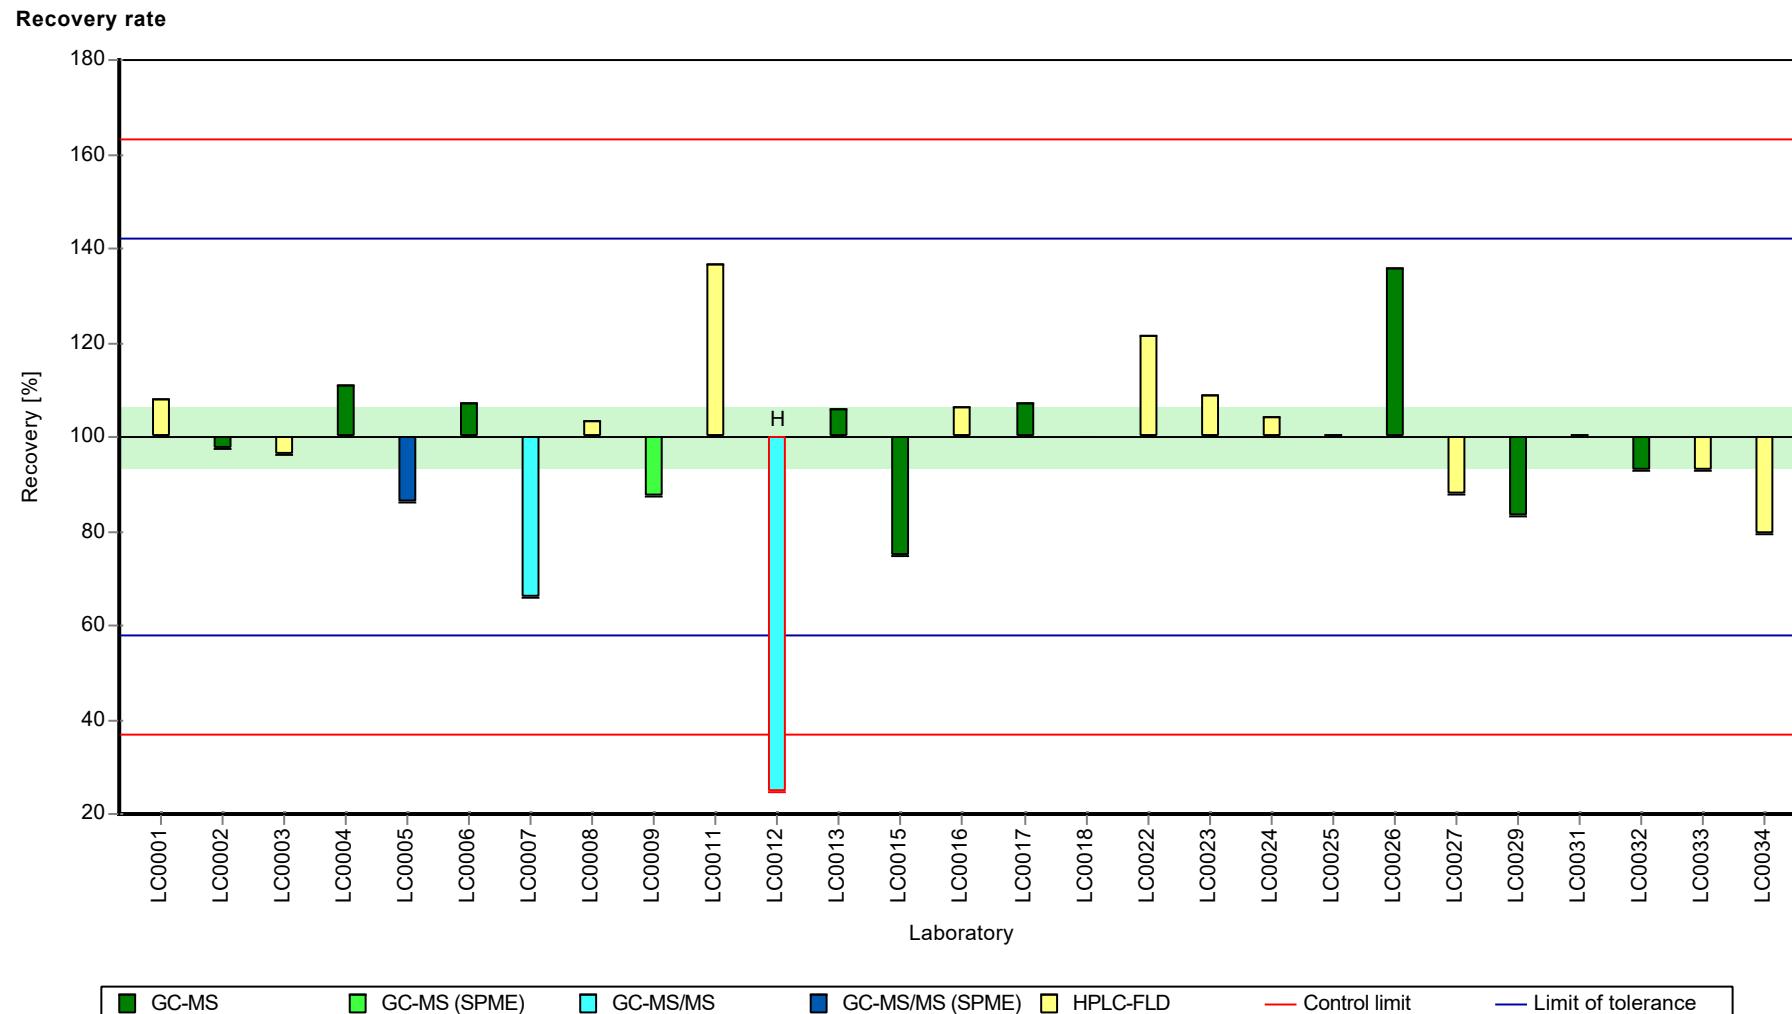

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]anthracene

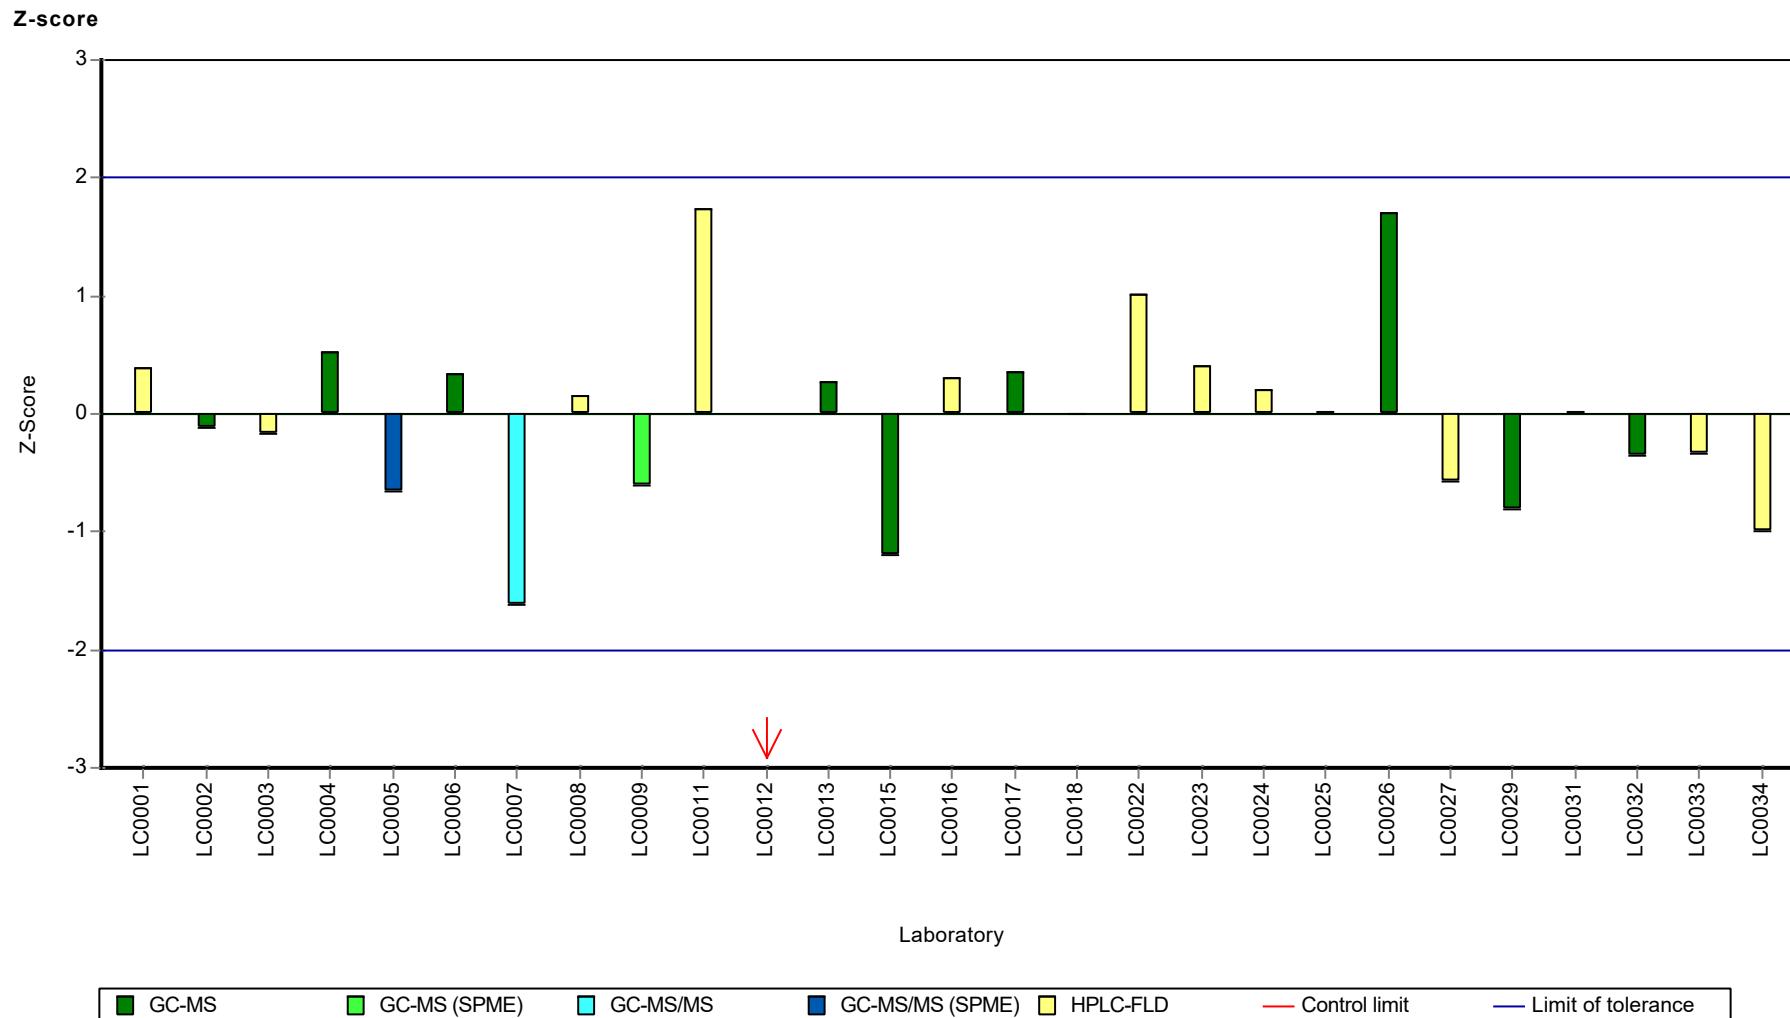

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]anthracene

Parameter oriented report

P24 B

Benzo[a]anthracene

Unit	ng/l
Assigned value ± U (k=2)	147 ± 7.68
Criterion	30.8 (21 %)
Minimum - Maximum	110 - 190
Control test value ± U (k=2)	167.0 ± 41.7

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	158	21	108	0.37	
LC0002	139	28	94.8	-0.25	
LC0003	146	43.7	99.6	-0.02	
LC0004	190.11	19	130	1.41	
LC0005	123	27	83.9	-0.77	
LC0006	142.02	21.303	96.9	-0.15	
LC0007	134	27	91.4	-0.41	
LC0008	293	11	200	4.75	H
LC0009	126.2	55.5	86.1	-0.66	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	178.37	78.485	122	1.03	
LC0012	20.9314	0.24	14.3	-4.08	H
LC0013	152.4	1.45	104	0.19	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	136	33	92.8	-0.34	
LC0016	159	6.22	108	0.4	
LC0017	152.8	30.6	104	0.2	
LC0018	144	50.4	98.2	-0.09	
LC0019	-	-	-	-	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	168	33.4	115	0.69	
LC0023	131.5	14.6	89.7	-0.49	
LC0024	165.3	16.5	113	0.61	
LC0025	167	35.07	114	0.66	
LC0026	209	5	143	2.03	H
LC0027	127	28	86.6	-0.64	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	135	27	92.1	-0.38	
LC0030	18	3.6	12.3	-4.18	H
LC0031	152	19	104	0.17	
LC0032	150.14	32.58	102	0.11	
LC0033	131.7	20.2	89.8	-0.48	
LC0034	110.4	11.6	75.3	-1.18	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]anthracene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	145 ± 28	147 ± 11.5 ng/l
Minimum	18	110 ng/l
Maximum	293	190 ng/l
Standard deviation	49.3	18.8 ng/l
rel. standard deviation	34	12.8 %
n	28	24 -


Graphical presentation of results

Results

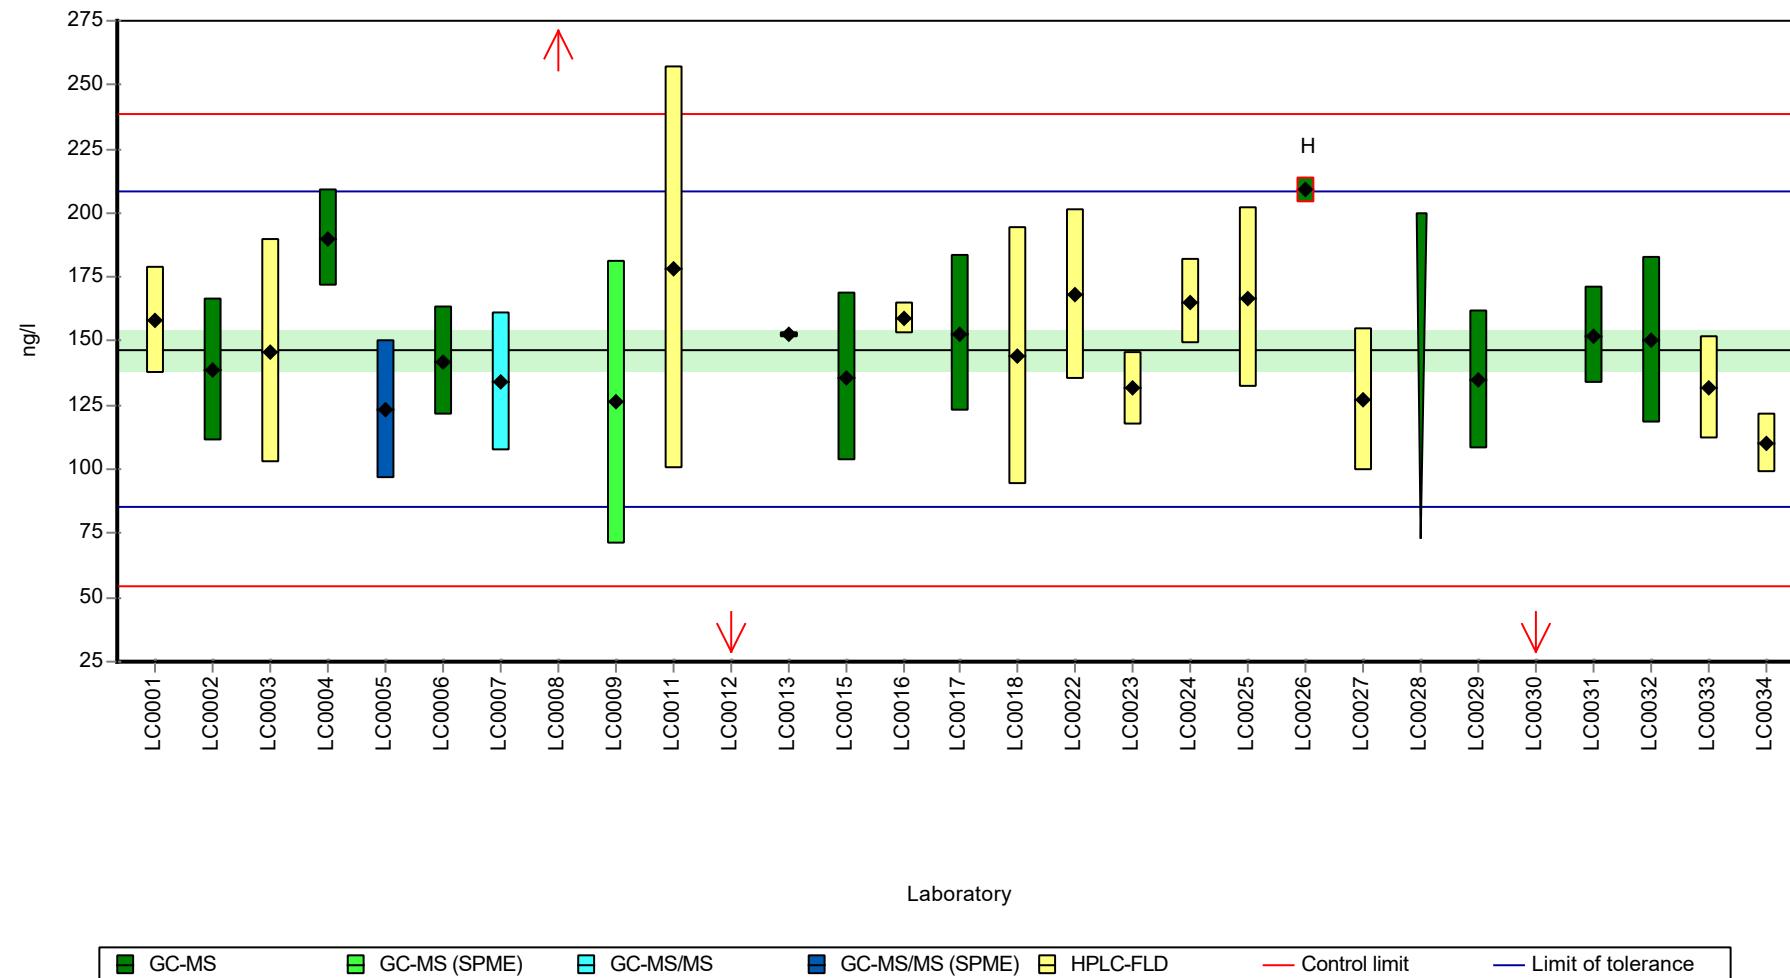


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]anthracene

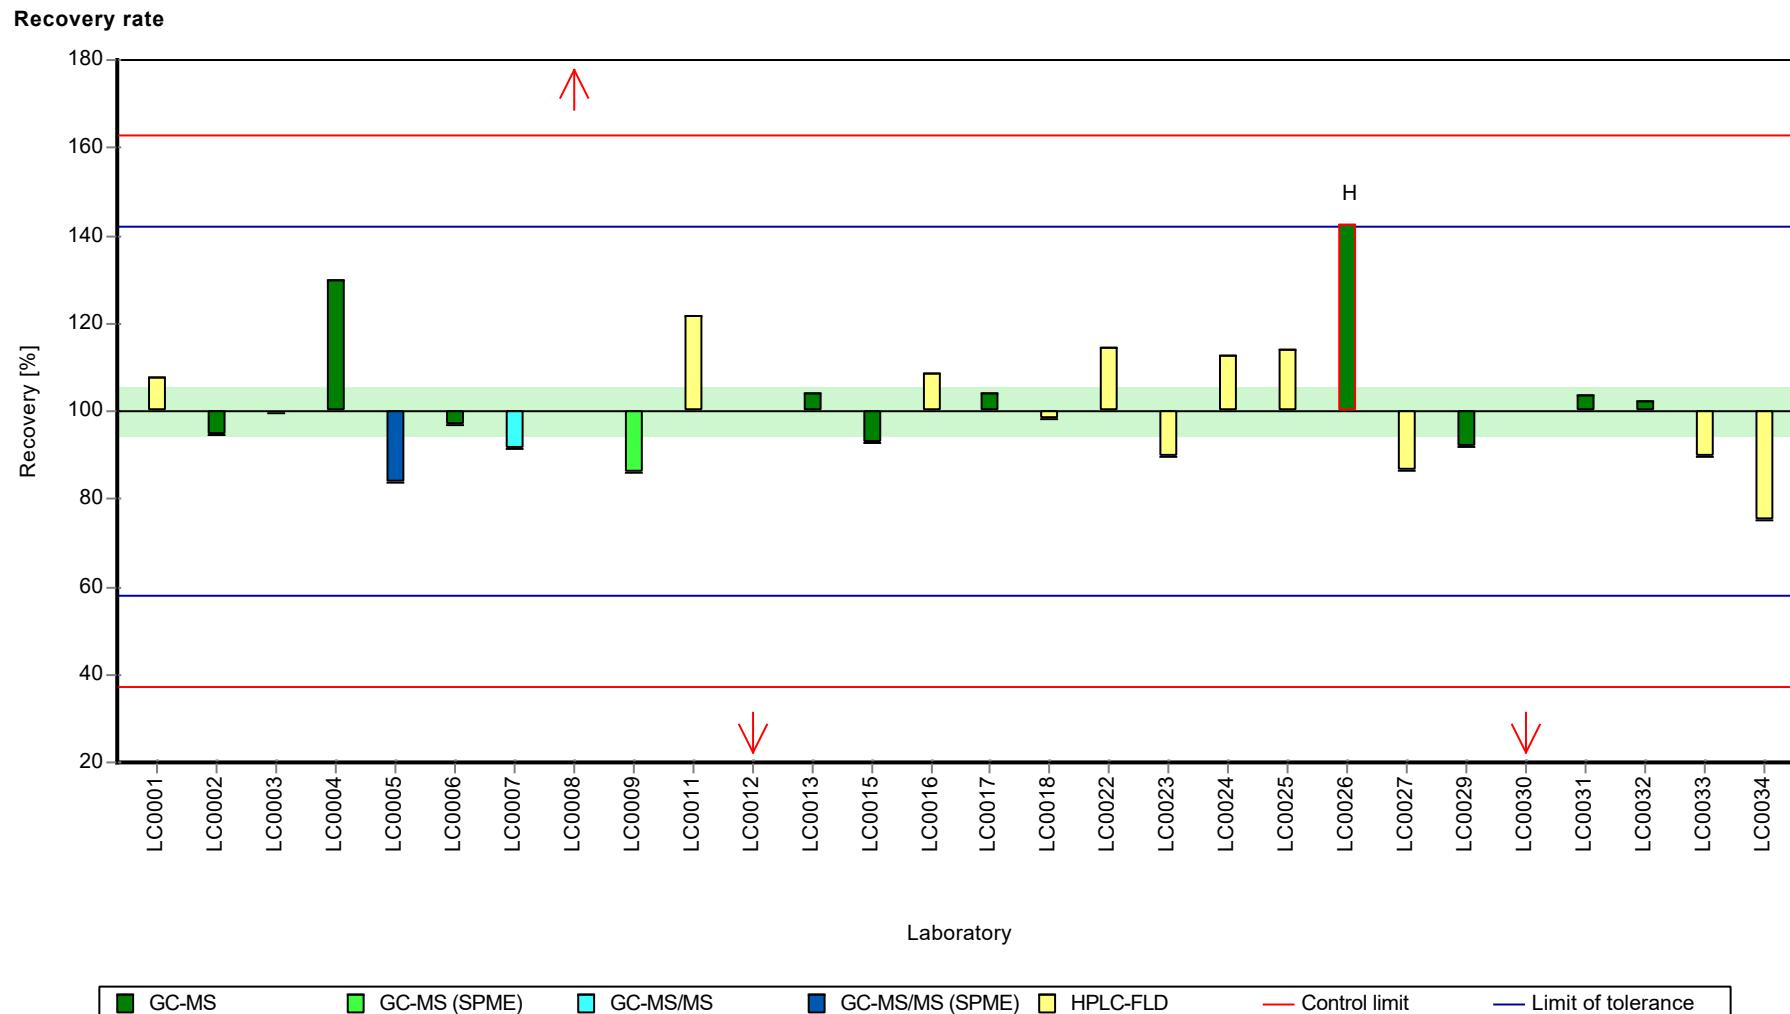

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]anthracene

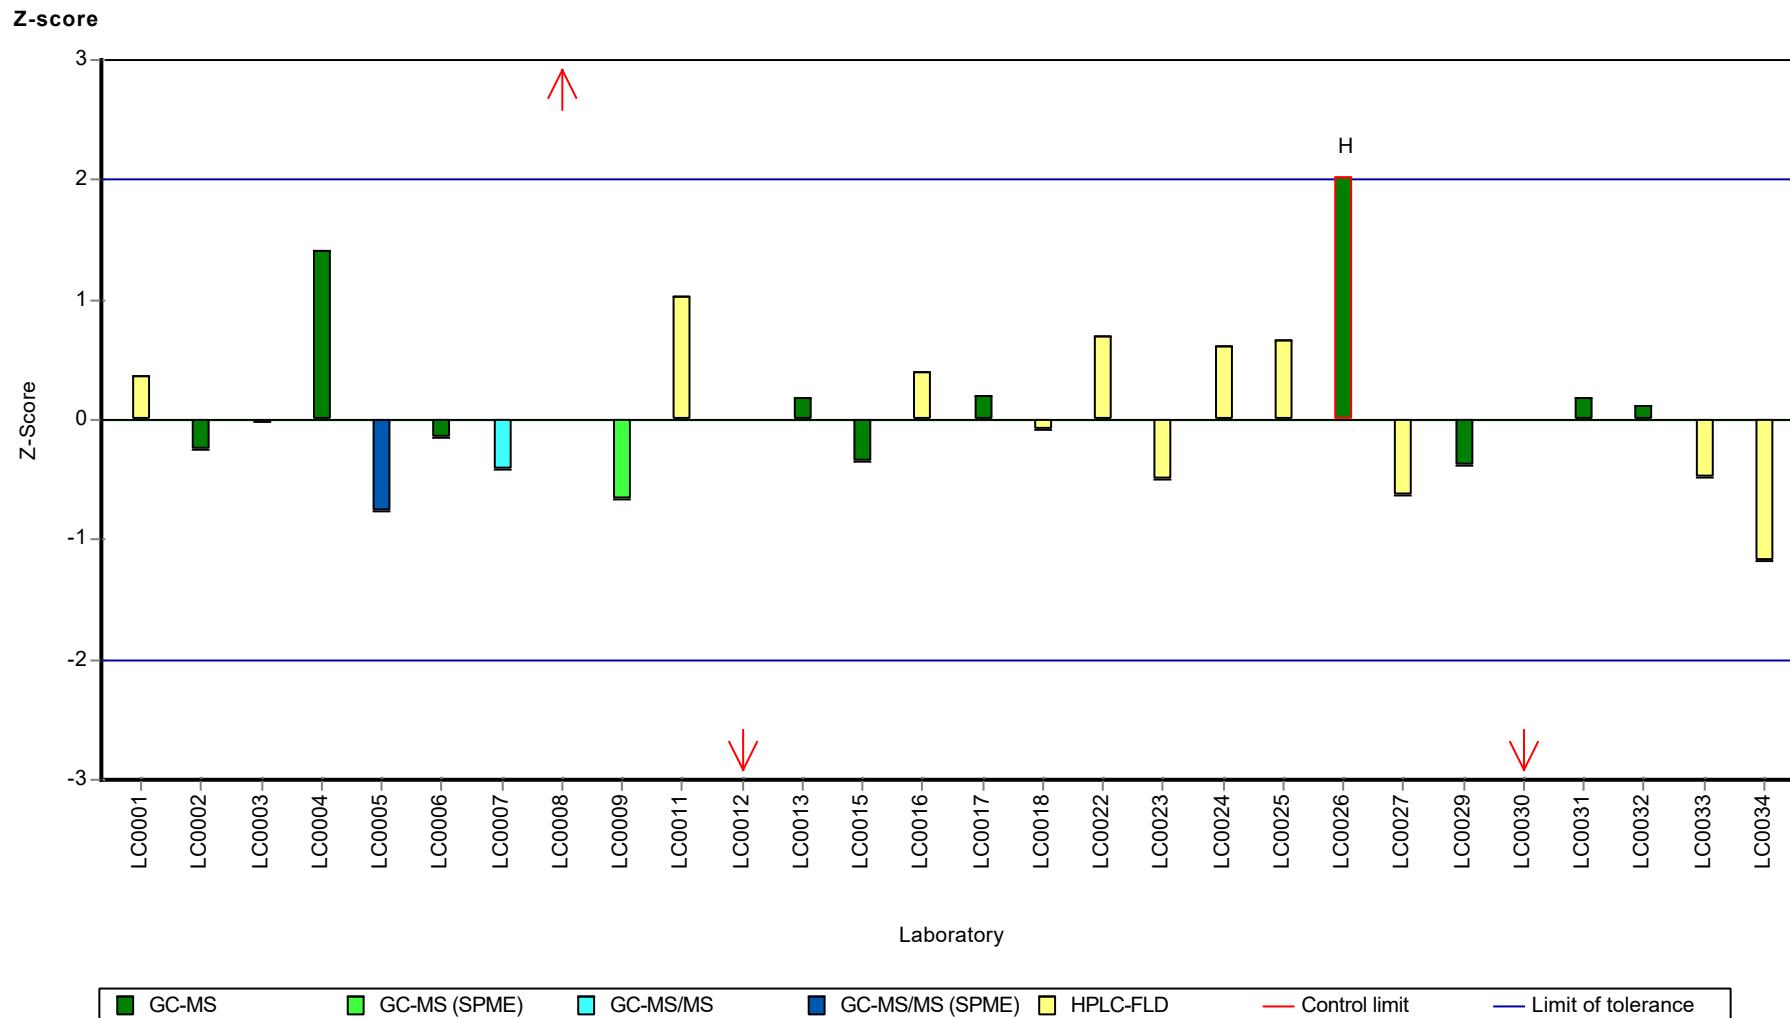

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]pyrene

Parameter oriented report

P24 A

Benzo[a]pyrene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 15.7 \pm 1.37
 Criterion 3.78 (24 %)
 Minimum - Maximum 8 - 23.3
 Control test value \pm U (k=2) 20.9 \pm 7.32

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	19.5	2.5	124	0.99	
LC0002	15.4	3.9	97.8	-0.09	
LC0003	16.8	5.04	107	0.28	
LC0004	17.67	2	112	0.51	
LC0005	12.7	2.8	80.6	-0.81	
LC0006	17.1	2.565	109	0.36	
LC0007	9	2	57.1	-1.79	
LC0008	17.1	0.3	109	0.36	
LC0009	12.15	5.35	77.2	-0.95	
LC0010	18.7	3.59	119	0.78	
LC0011	23.26	10.233	148	1.99	
LC0012	1.29	0.36	8.2	-3.83	H
LC0013	< 20 (LOQ)	-	-	-	
LC0014	21.27	18.29	135	1.46	
LC0015	13	3	82.5	-0.73	
LC0016	15.4	1.36	97.8	-0.09	
LC0017	17.8	3.6	113	0.54	
LC0018	16	5.6	102	0.07	
LC0019	10.97	2.41	69.7	-1.26	
LC0020	14.6	3.6	92.7	-0.3	
LC0021	20.1	6.04	128	1.15	
LC0022	21.1	4.2	134	1.42	
LC0023	18.71	5.6	119	0.78	
LC0024	18.6	1.9	118	0.75	
LC0025	17	3.57	108	0.33	
LC0026	8	0.65	50.8	-2.05	
LC0027	15	3.3	95.2	-0.2	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	12.5	2.5	79.4	-0.86	
LC0030	< 5 (LOQ)	-	-	-	
LC0031	10.6	1.2	67.3	-1.36	
LC0032	16.72	2.525	106	0.26	
LC0033	11.7	1.3	74.3	-1.07	
LC0034	14	1.27	88.9	-0.46	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]pyrene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	15.3 ± 2.43	15.7 ± 2.05 ng/l
Minimum	1.29	8 ng/l
Maximum	23.3	23.3 ng/l
Standard deviation	4.5	3.74 ng/l
rel. standard deviation	29.5	23.8 %
n	31	30 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]pyrene


Graphical presentation of results

Results

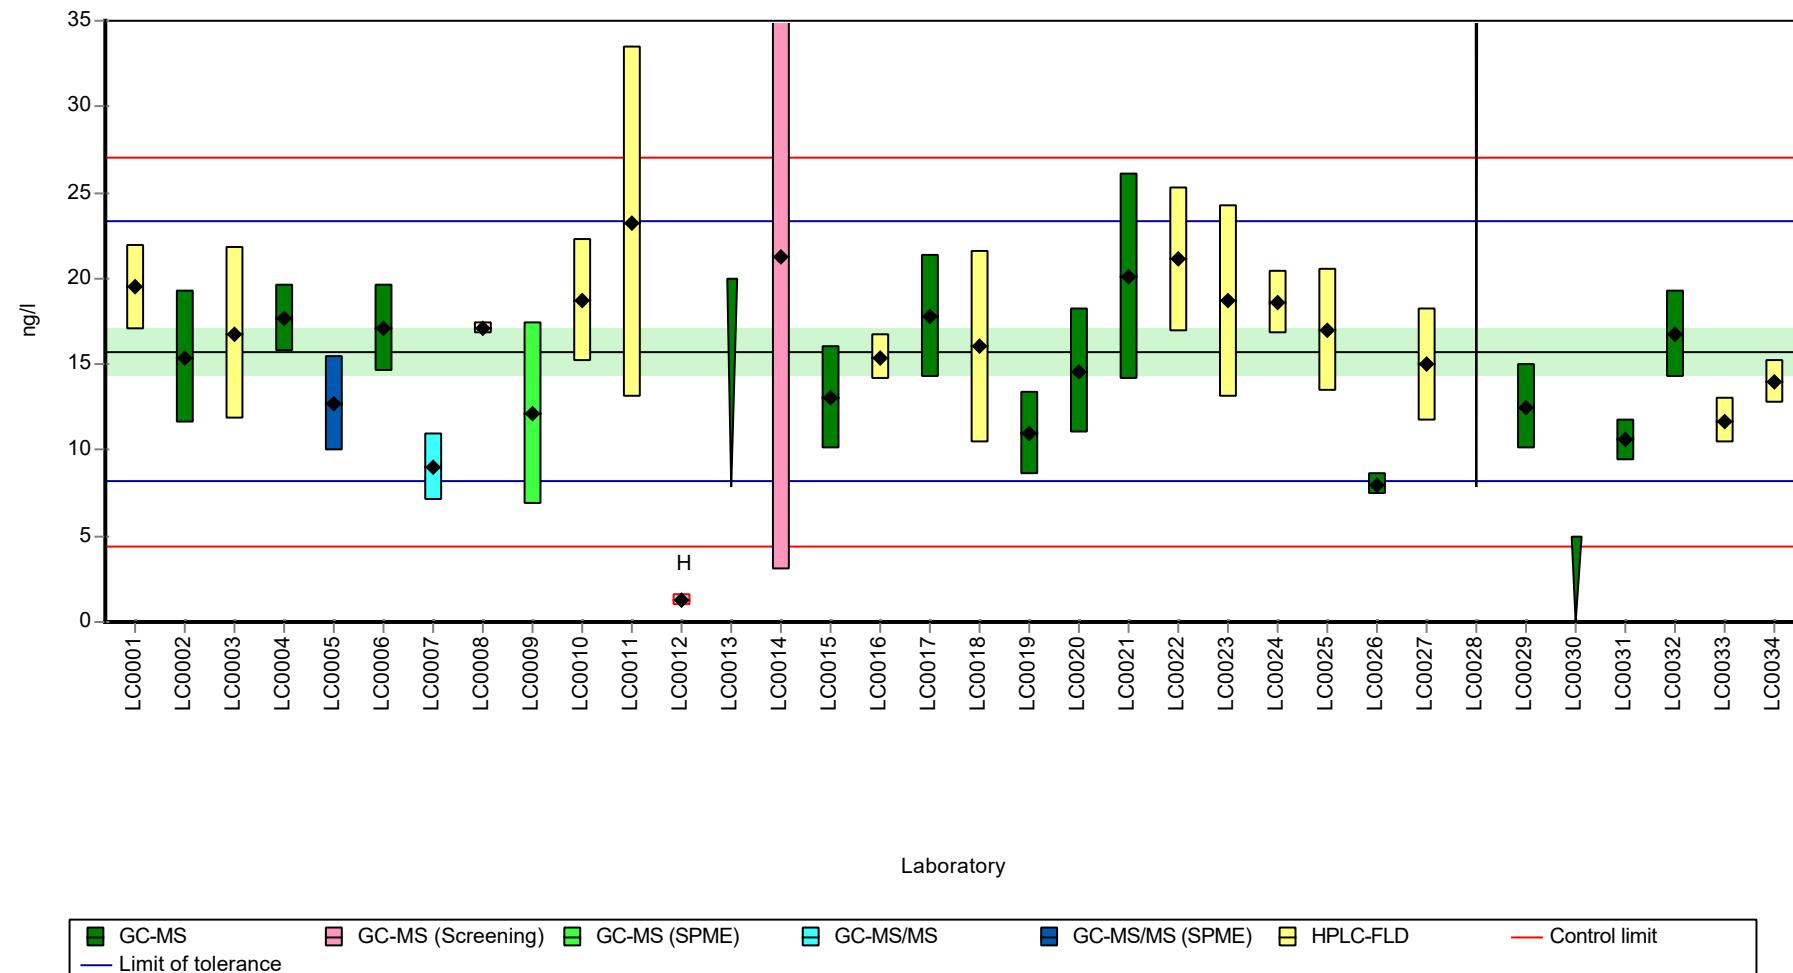


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]pyrene

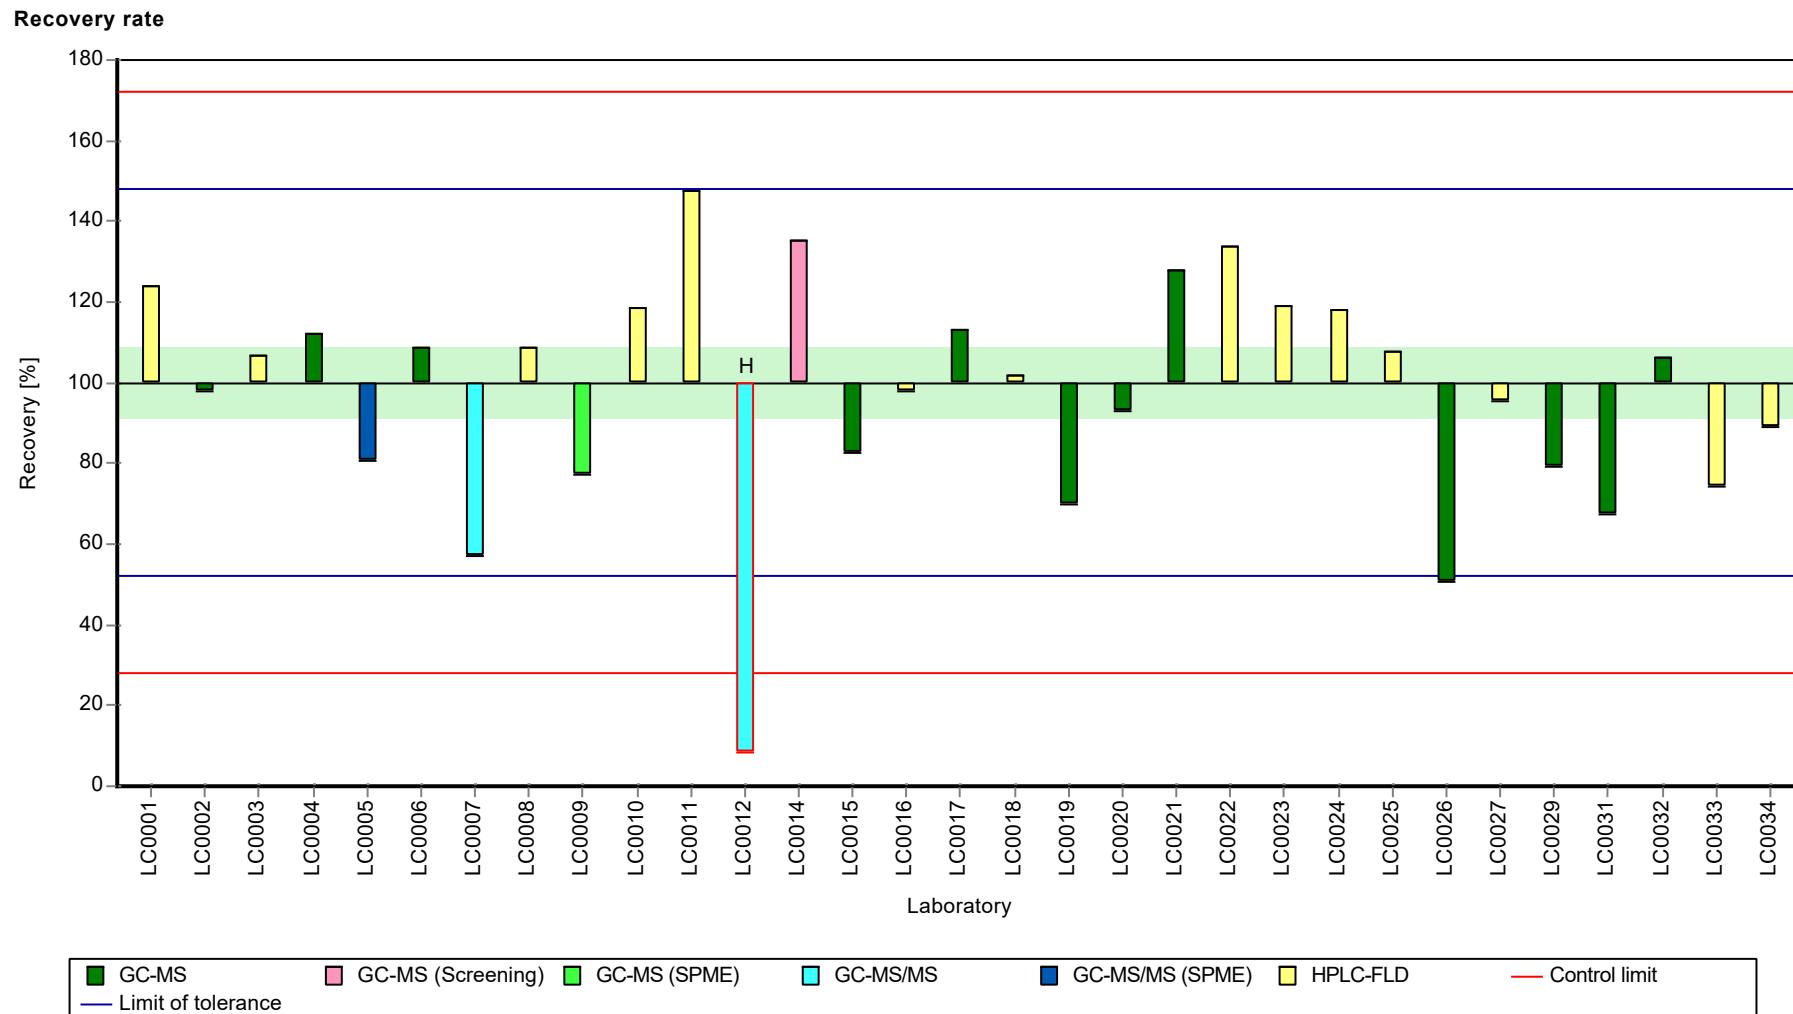

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[a]pyrene

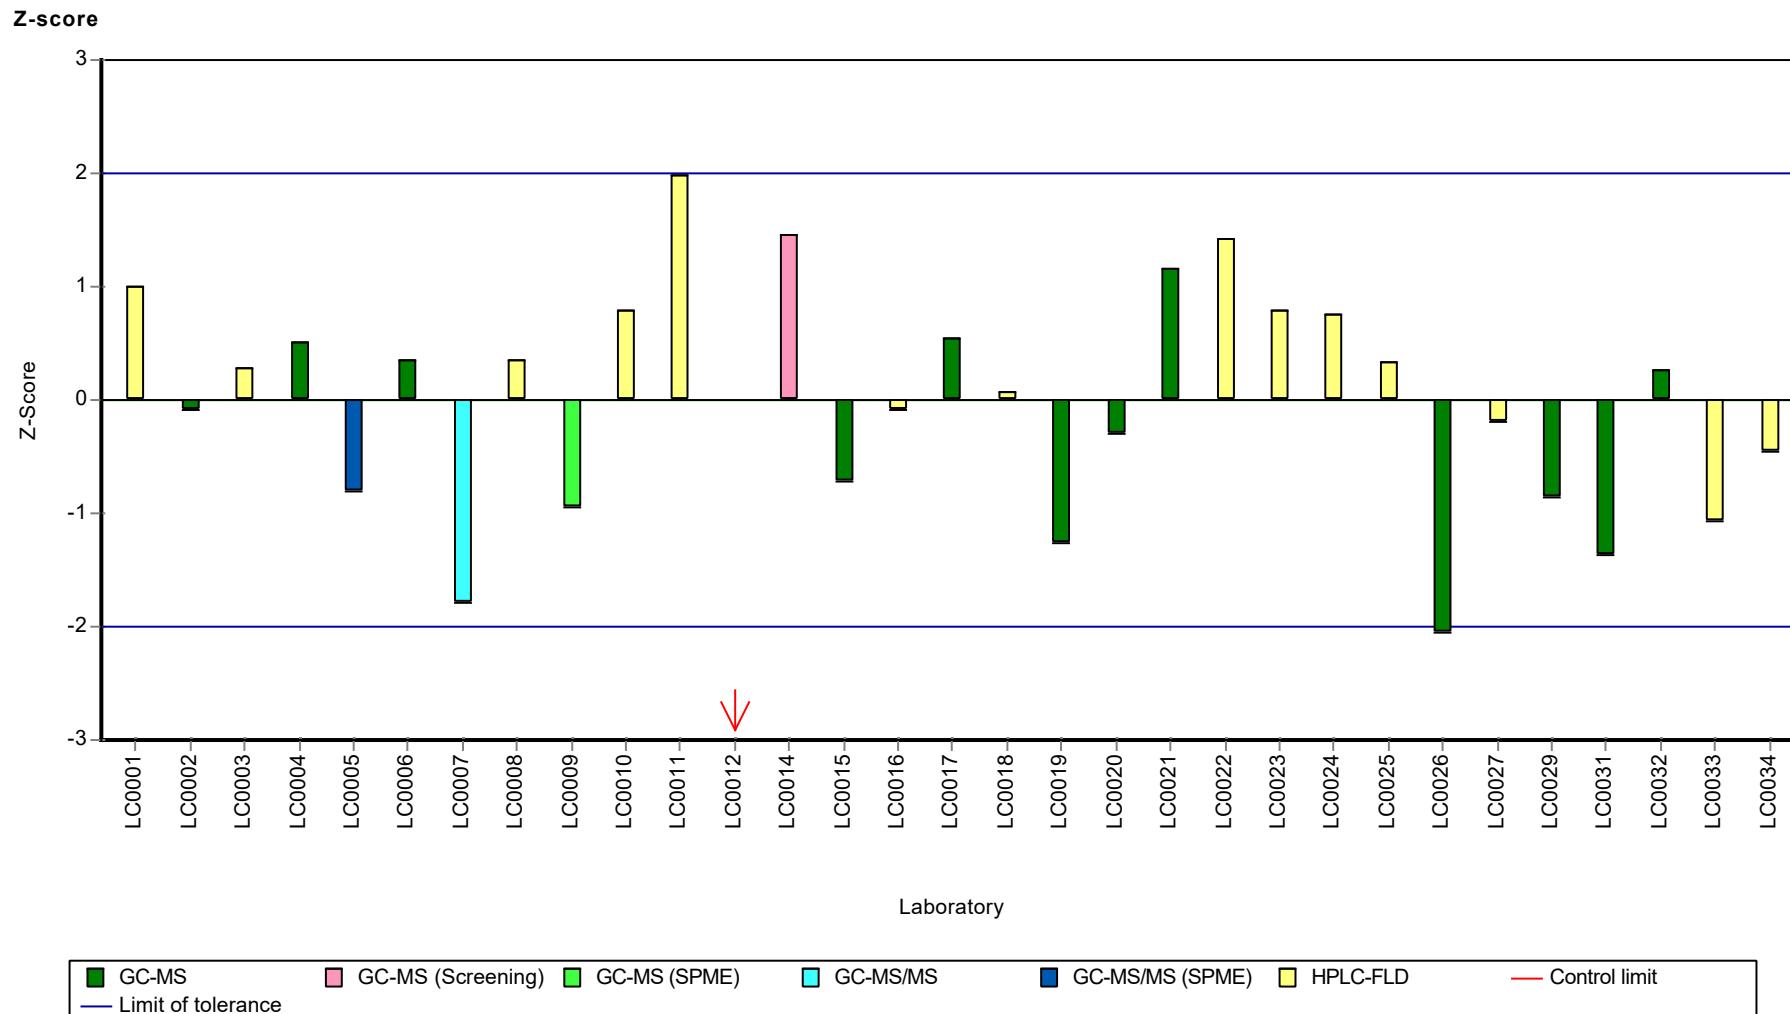

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]pyrene

Parameter oriented report

P24 B

Benzo[a]pyrene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 147 ± 8.62
 Criterion 35.4 (24 %)
 Minimum - Maximum 103 - 194
 Control test value ± U (k=2) 160.0 ± 56.1

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	177	23	120	0.83	
LC0002	148	37	100	0.02	
LC0003	148	44.3	100	0.02	
LC0004	194.11	19	132	1.32	
LC0005	124	27	84.1	-0.66	
LC0006	139.06	20.859	94.3	-0.24	
LC0007	122	24	82.7	-0.72	
LC0008	290	12	197	4.03	H
LC0009	126.4	55.6	85.7	-0.6	
LC0010	153	29.5	104	0.16	
LC0011	177.73	78.202	121	0.86	
LC0012	10.272	0.36	7	-3.88	H
LC0013	153.7	3.44	104	0.18	
LC0014	165.27	142.14	112	0.5	
LC0015	134	32	90.9	-0.38	
LC0016	169	5.41	115	0.61	
LC0017	156.6	31.3	106	0.26	
LC0018	157	55	106	0.27	
LC0019	113.93	25.06	77.3	-0.95	
LC0020	141.5	35	96	-0.17	
LC0021	160	48	109	0.35	
LC0022	179	35.8	121	0.89	
LC0023	106.1	18.8	72	-1.17	
LC0024	177.8	17.8	121	0.86	
LC0025	158.1	33.2	107	0.3	
LC0026	103	5.82	69.8	-1.26	
LC0027	129	28	87.5	-0.52	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	131	26	88.8	-0.47	
LC0030	16.5	3.3	11.2	-3.7	H
LC0031	153	18	104	0.16	
LC0032	167.35	25.27	113	0.56	
LC0033	146.5	16.6	99.3	-0.03	
LC0034	112.7	10.21	76.4	-0.98	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]pyrene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	144 ± 24.8	147 ± 12.9 ng/l
Minimum	10.3	103 ng/l
Maximum	290	194 ng/l
Standard deviation	47.4	23.6 ng/l
rel. standard deviation	33	16 %
n	33	30 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]pyrene


Graphical presentation of results

Results

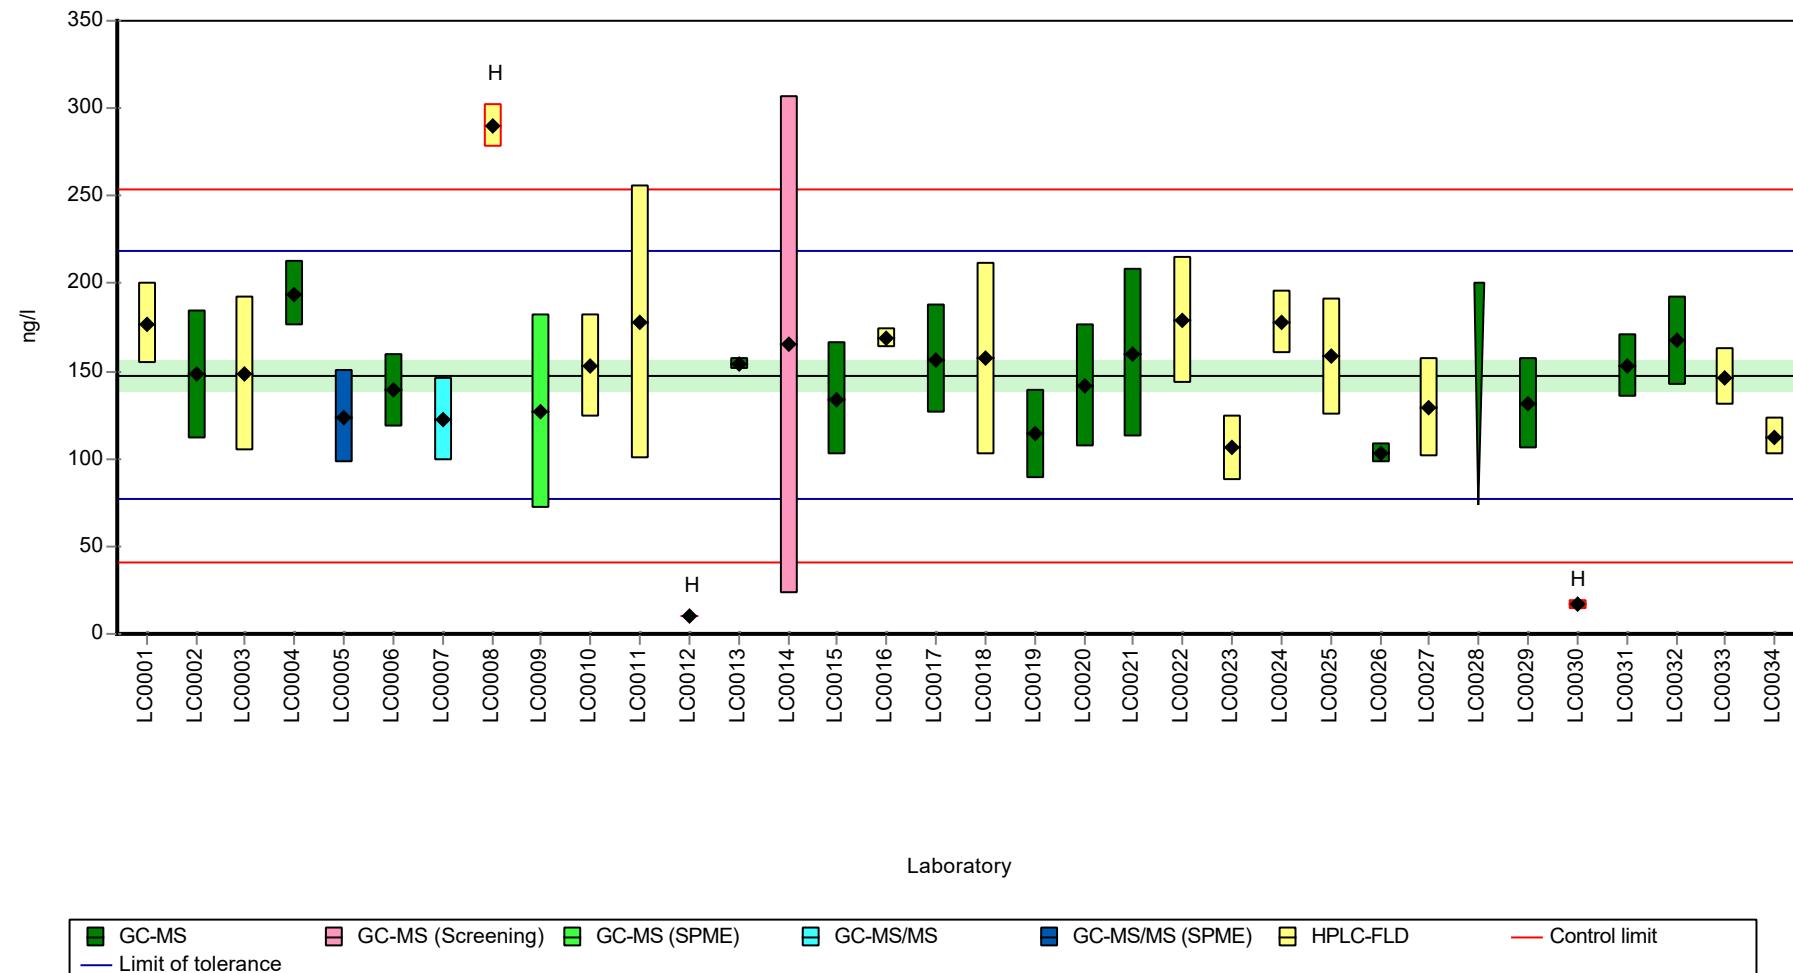


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]pyrene

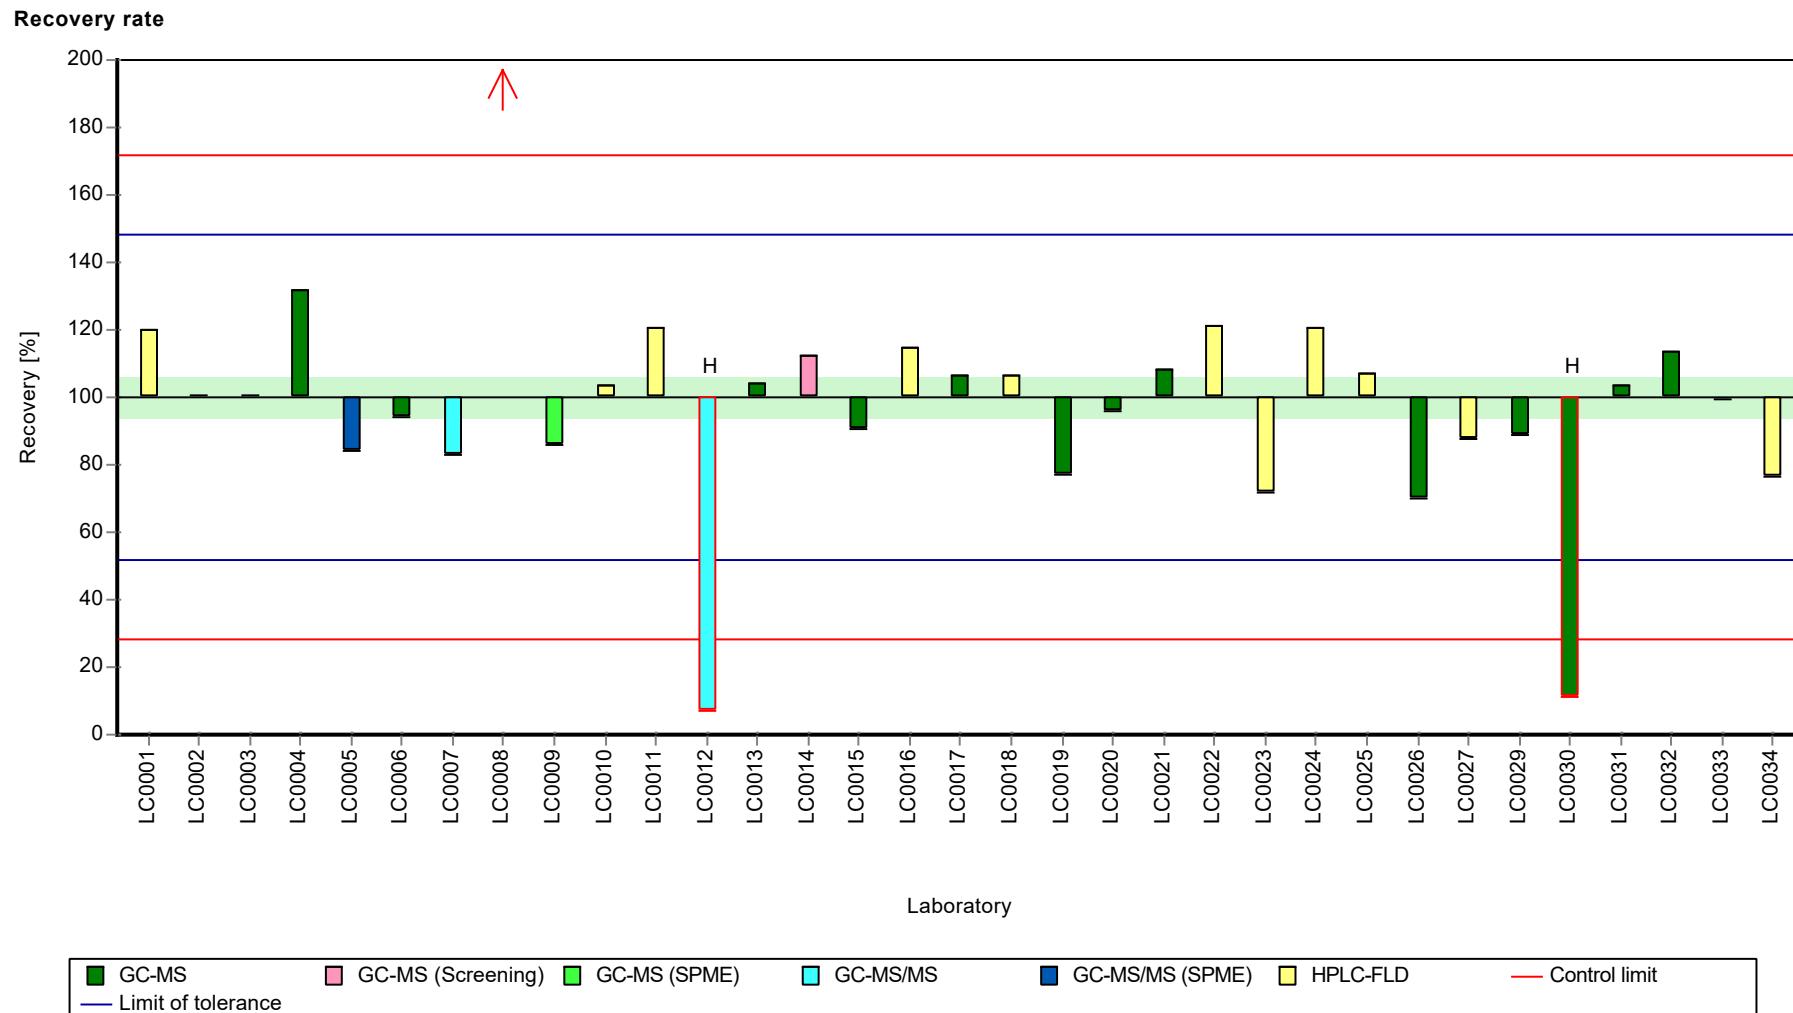

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[a]pyrene

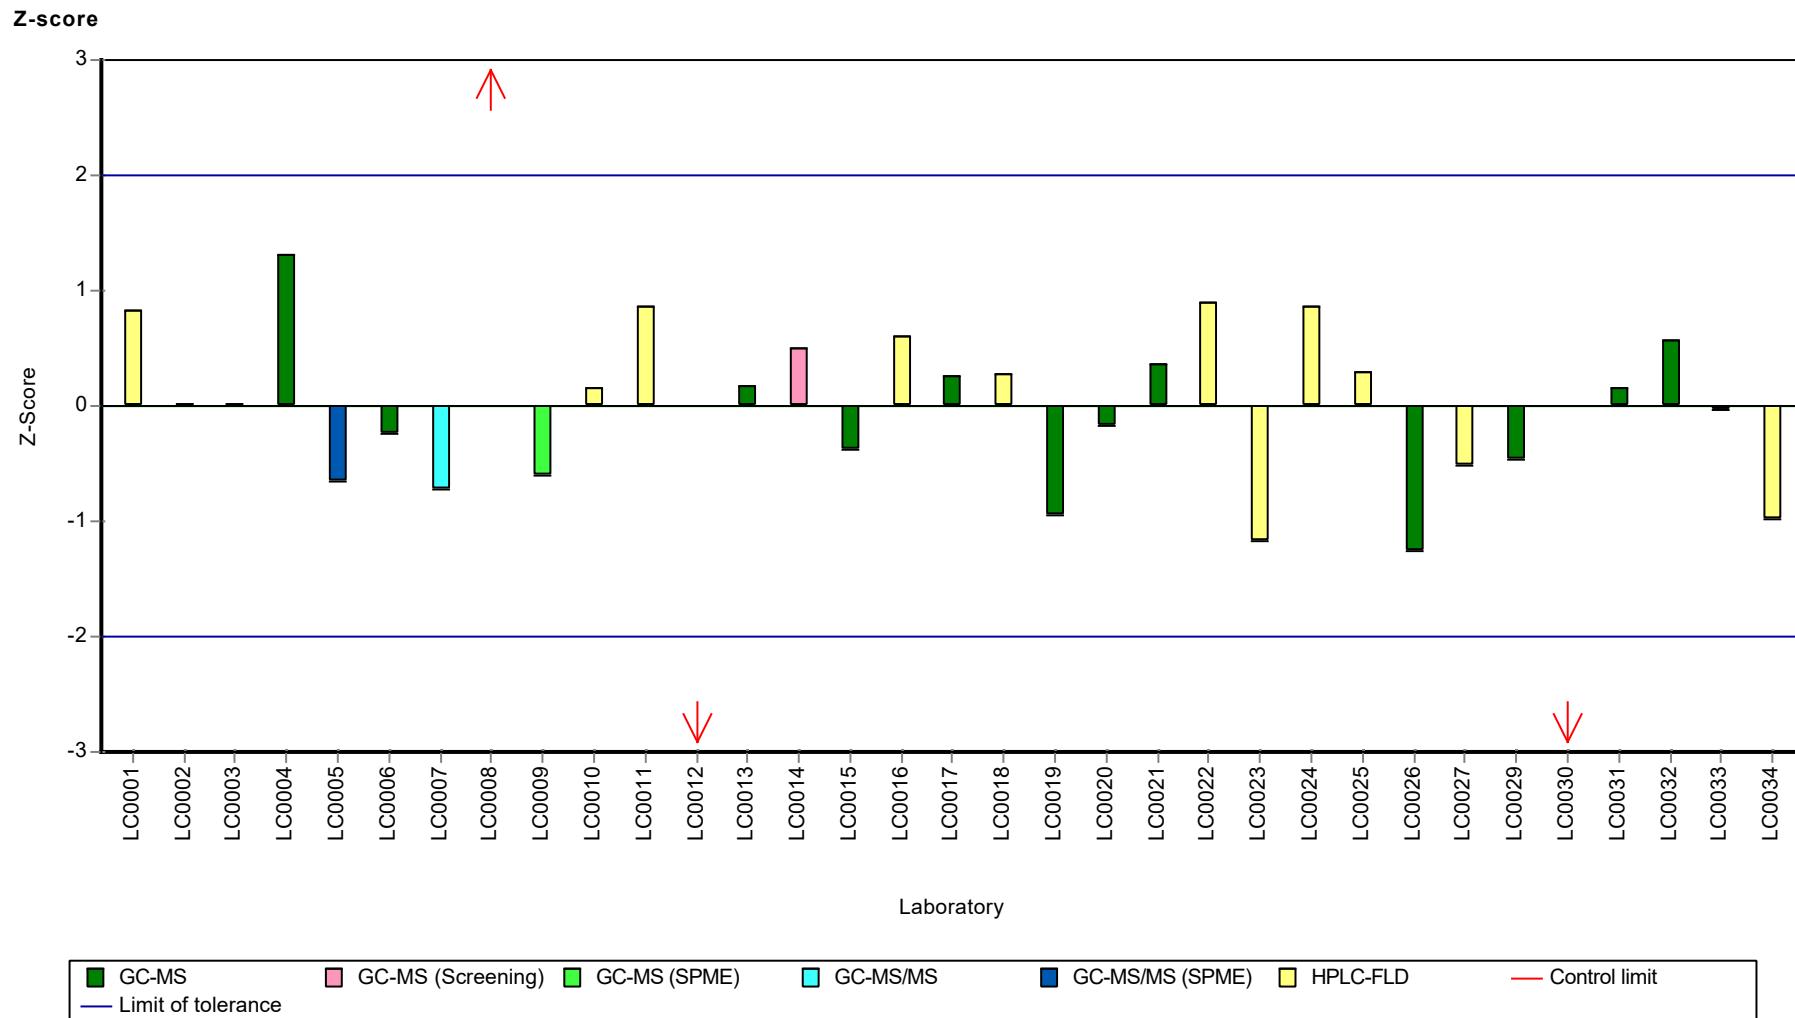

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

Parameter oriented report

P24 A

Benzo[b]fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 23.8 ± 1.52
 Criterion 4.05 (17 %)
 Minimum - Maximum 16.1 - 32.3
 Control test value ± U (k=2) 27.7 ± 6.93

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	27	3.5	113	0.79	
LC0002	23	5.8	96.7	-0.2	
LC0003	23.8	7.13	100	0	
LC0004	31.06	3	131	1.8	
LC0005	21.2	4.7	89.1	-0.64	
LC0006	29.06	4.359	122	1.3	
LC0007	21	4	88.2	-0.69	
LC0008	23.9	0.4	100	0.03	
LC0009	21.03	9.25	88.4	-0.68	
LC0010	25.3	4.53	106	0.37	
LC0011	32.31	14.218	136	2.1	
LC0012	1.33	0.55	5.6	-5.55	H
LC0013	25.26	0.19	106	0.36	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	19	5	79.8	-1.19	
LC0016	26.2	1.04	110	0.59	
LC0017	25.5	5.1	107	0.42	
LC0018	22.6	7.91	95	-0.3	
LC0019	16.07	3.54	67.5	-1.91	
LC0020	19.2	7.3	80.7	-1.14	
LC0021	26.3	7.89	111	0.62	
LC0022	28.7	5.7	121	1.21	
LC0023	25.03	5.1	105	0.3	
LC0024	24.8	2.5	104	0.25	
LC0025	22.1	4.64	92.9	-0.42	
LC0026	16.2	1.09	68.1	-1.88	
LC0027	21	4.6	88.2	-0.69	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	17.3	3.5	72.7	-1.61	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	27.3	3.9	115	0.87	
LC0032	24.27	4.395	102	0.12	
LC0033	28.6	5.4	120	1.19	
LC0034	19.8	1.38	83.2	-0.99	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	23.1 ± 3.09	23.8 ± 2.27 ng/l
Minimum	1.33	16.1 ng/l
Maximum	32.3	32.3 ng/l
Standard deviation	5.74	4.15 ng/l
rel. standard deviation	24.9	17.4 %
n	31	30 -


Graphical presentation of results

Results

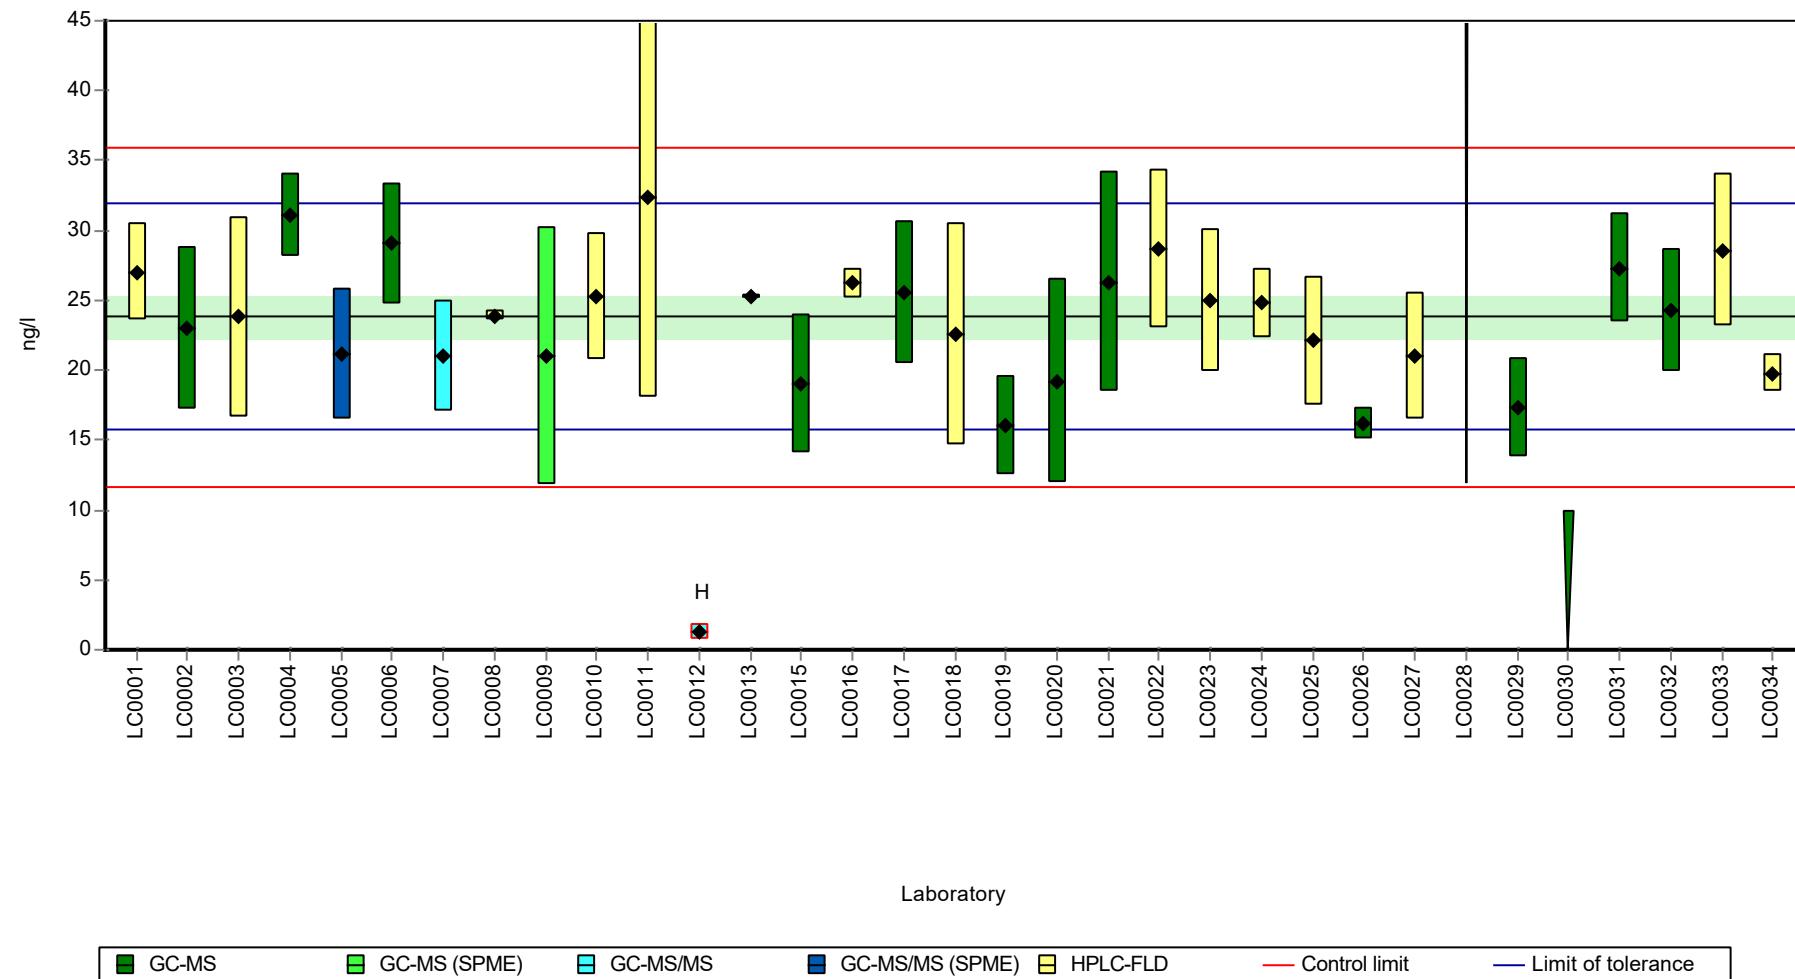


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

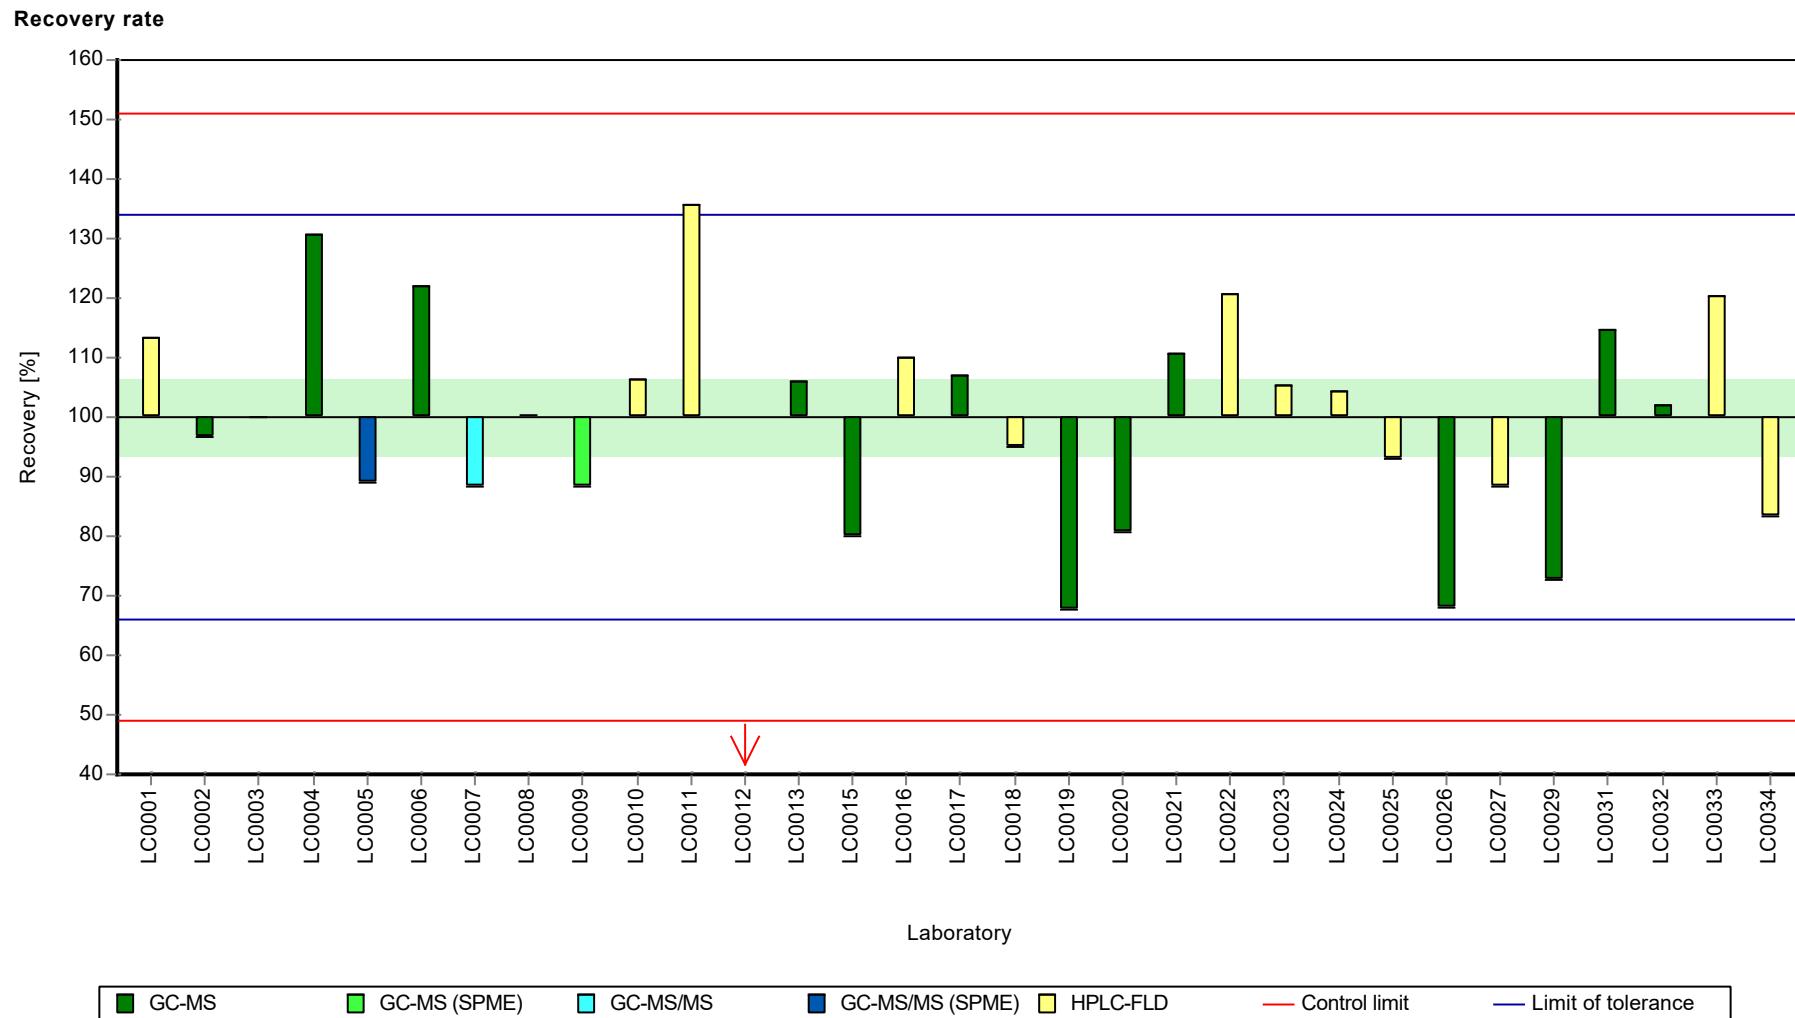

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

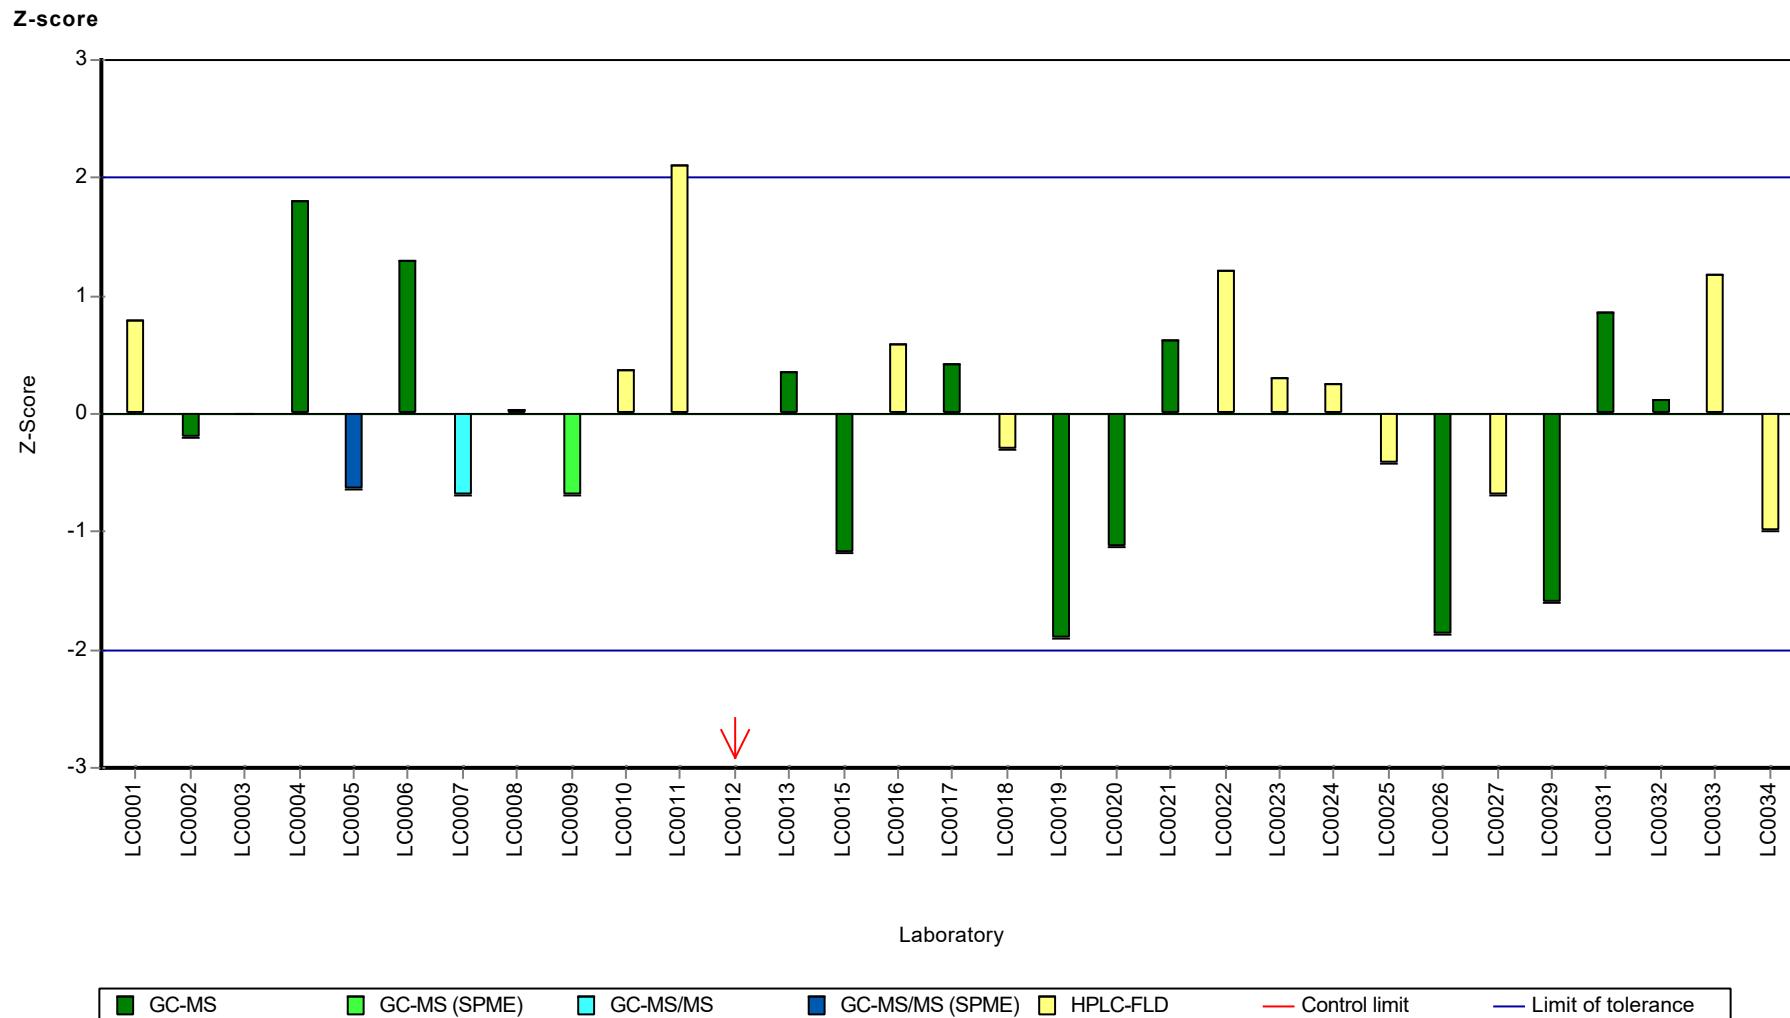

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

Parameter oriented report

P24 B

Benzo[b]fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 137 ± 8.16
 Criterion 23.3 (17 %)
 Minimum - Maximum 86.8 - 192
 Control test value ± U (k=2) 148.0 ± 37.1

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	152	20	111	0.64	
LC0002	125	31	91.2	-0.52	
LC0003	138	41.4	101	0.04	
LC0004	191.75	19	140	2.35	
LC0005	118	26	86.1	-0.82	
LC0006	139.85	20.978	102	0.12	
LC0007	136	27	99.3	-0.04	
LC0008	272	12	199	5.8	H
LC0009	116.7	51.3	85.2	-0.87	
LC0010	139	25	101	0.09	
LC0011	169.17	74.433	123	1.38	
LC0012	12.0203	0.55	8.8	-5.37	H
LC0013	145.3	1.67	106	0.36	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	126	30	92	-0.47	
LC0016	154	4.17	112	0.73	
LC0017	133.2	26.6	97.2	-0.16	
LC0018	141	49.4	103	0.17	
LC0019	130.57	28.73	95.3	-0.28	
LC0020	105.2	40	76.8	-1.37	
LC0021	154	46.2	112	0.73	
LC0022	166	33.2	121	1.24	
LC0023	86.83	8.2	63.4	-2.15	
LC0024	162.8	16.3	119	1.11	
LC0025	142.8	29.99	104	0.25	
LC0026	115	8.89	83.9	-0.94	
LC0027	121	27	88.3	-0.69	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	122	24	89	-0.64	
LC0030	16	3.2	11.7	-5.2	H
LC0031	151	22	110	0.6	
LC0032	153.49	27.78	112	0.71	
LC0033	131.3	24.9	95.8	-0.24	
LC0034	106.2	7.38	77.5	-1.32	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	134 ± 23.6	137 ± 12.2 ng/l
Minimum	12	86.8 ng/l
Maximum	272	192 ng/l
Standard deviation	44.6	22 ng/l
rel. standard deviation	33.4	16 %
n	32	29 -


Graphical presentation of results

Results

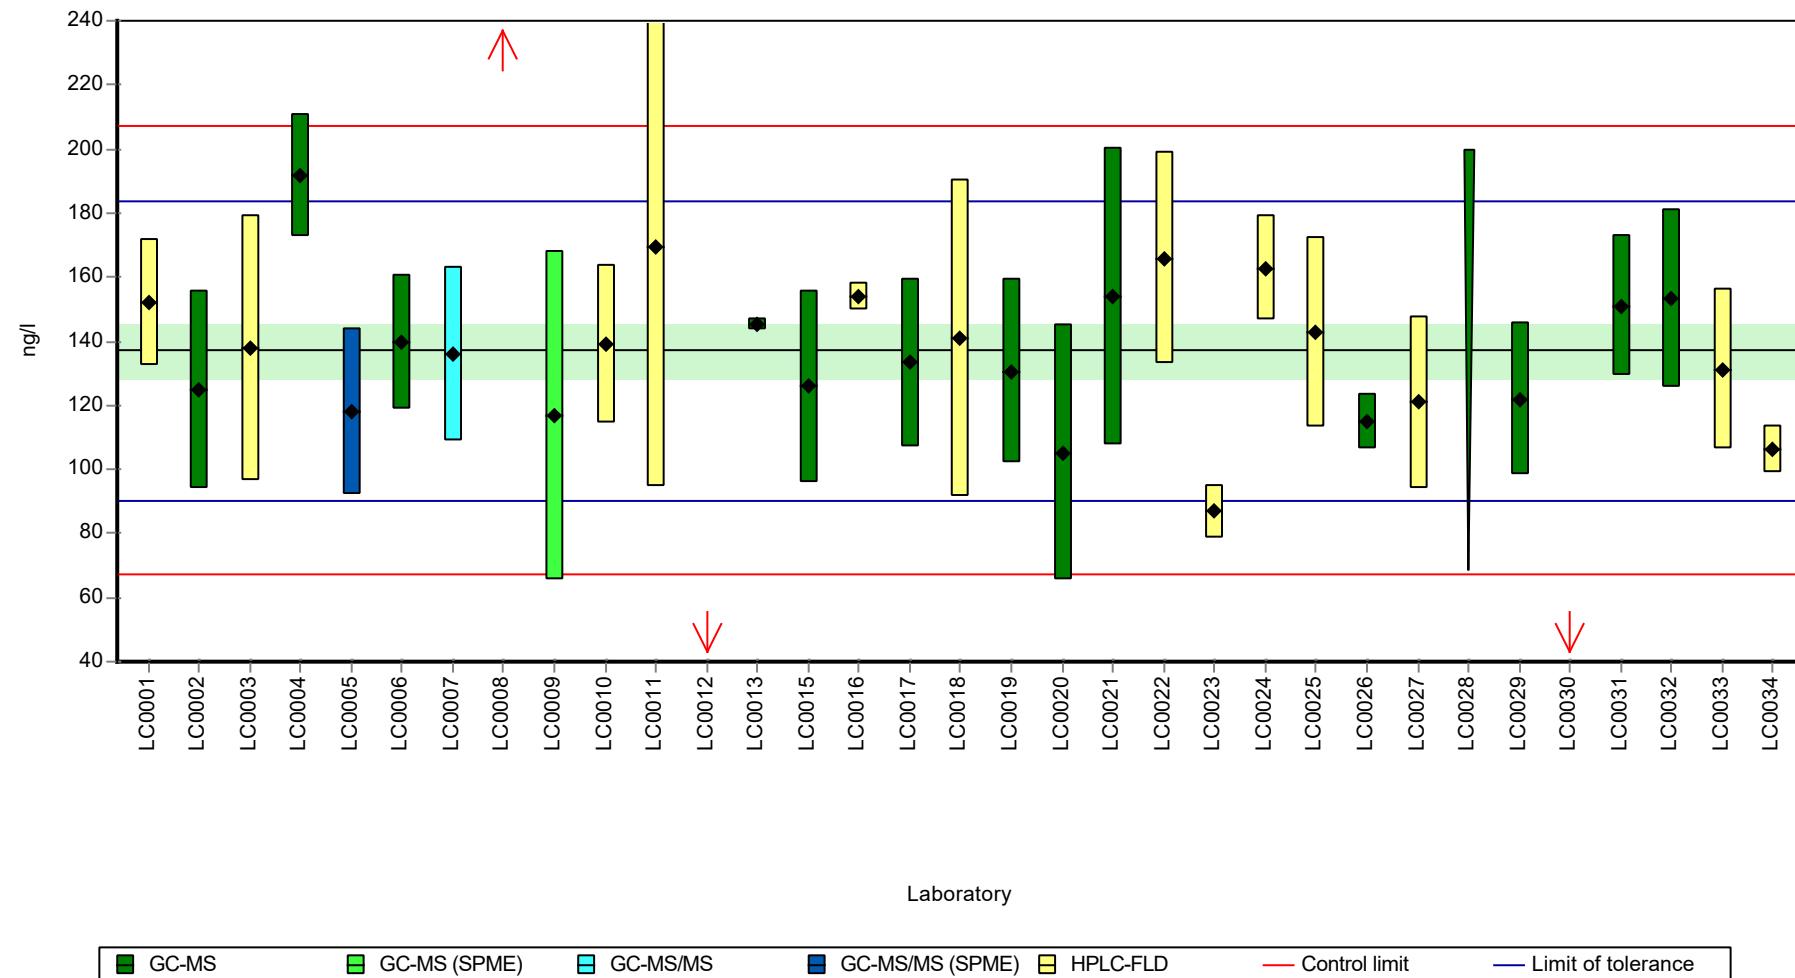


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

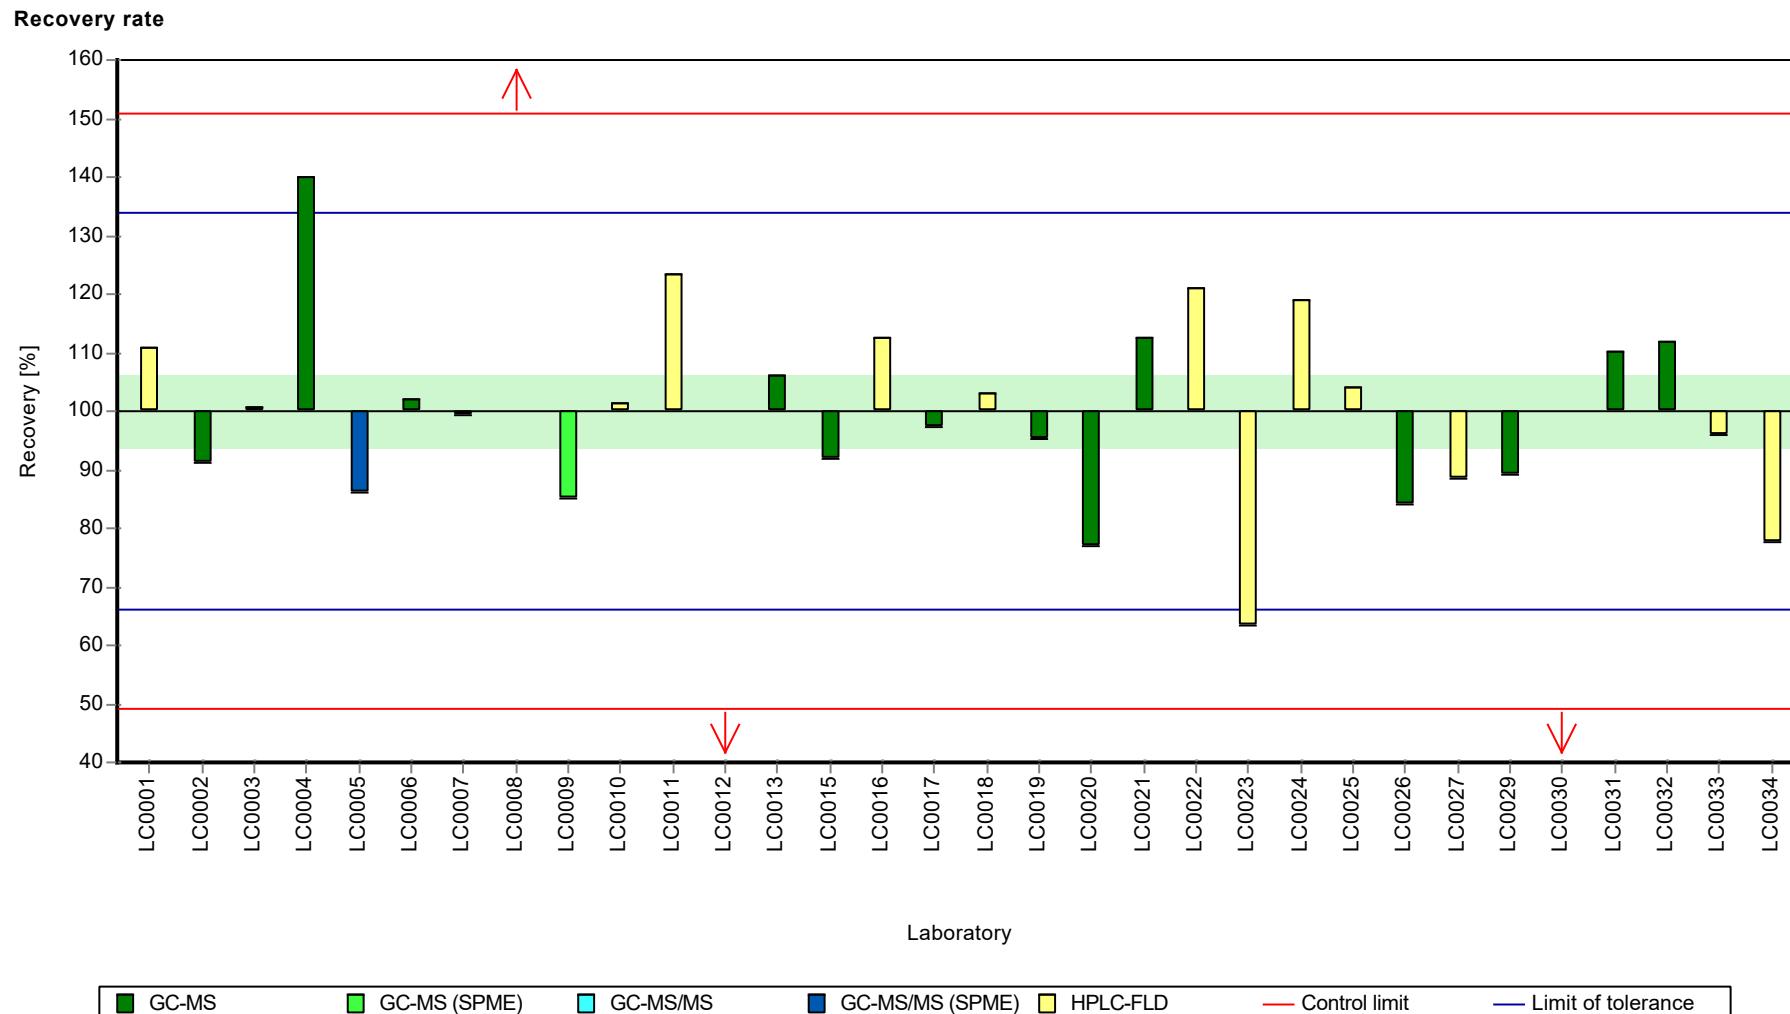

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[b]fluoranthene

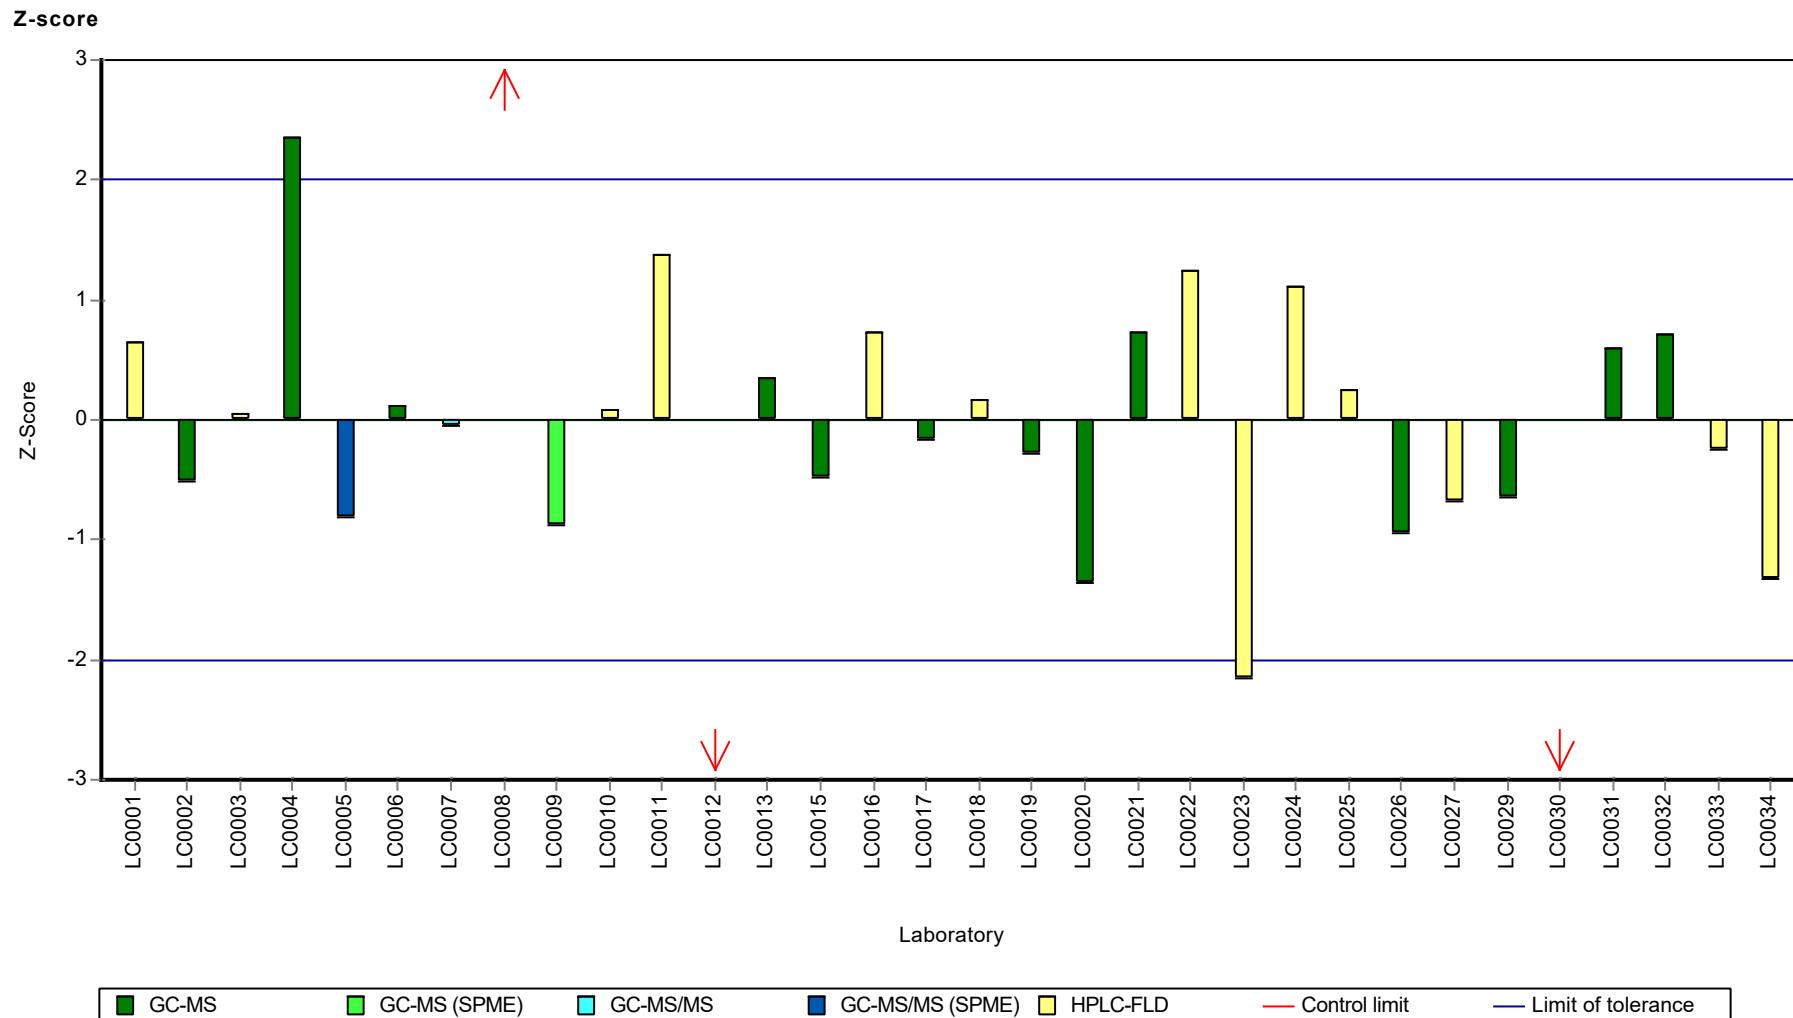

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

Parameter oriented report

P24 A

Benzo[g,h,i]perylene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 23.2 \pm 1.75
 Criterion 7.43 (32 %)
 Minimum - Maximum 11.2 - 32
 Control test value \pm U (k=2) 27.9 \pm 9.75

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	27.8	3.6	120	0.62	
LC0002	23.6	5.9	102	0.05	
LC0003	25.8	7.74	111	0.35	
LC0004	23.96	2	103	0.1	
LC0005	18.9	4.2	81.4	-0.58	
LC0006	28.93	4.34	125	0.77	
LC0007	18	4	77.5	-0.7	
LC0008	24.8	0.68	107	0.21	
LC0009	18.48	8.13	79.6	-0.64	
LC0010	28.1	9.06	121	0.66	
LC0011	32	14.081	138	1.18	
LC0012	1.43	0.49	6.2	-2.93	H
LC0013	23.02	0.86	99.2	-0.03	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	17	4	73.2	-0.84	
LC0016	27.8	1.05	120	0.62	
LC0017	26.4	5.3	114	0.43	
LC0018	20.3	7.11	87.4	-0.39	
LC0019	11.21	2.24	48.3	-1.62	
LC0020	21.8	5.9	93.9	-0.19	
LC0021	23.3	6.99	100	0.01	
LC0022	29.8	6	128	0.89	
LC0023	22.74	5.1	98	-0.06	
LC0024	24.5	2.5	106	0.17	
LC0025	23.9	5.02	103	0.09	
LC0026	12.5	1.45	53.8	-1.44	
LC0027	21.9	4.8	94.3	-0.18	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	19	3.8	81.8	-0.57	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	
LC0031	25.6	4.8	110	0.32	
LC0032	27.39	3.245	118	0.56	
LC0033	24.9	2.3	107	0.23	
LC0034	23	0.96	99.1	-0.03	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	22.5 ± 3.3	23.2 ± 2.62 ng/l
Minimum	1.43	11.2 ng/l
Maximum	32	32 ng/l
Standard deviation	6.12	4.78 ng/l
rel. standard deviation	27.2	20.6 %
n	31	30 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene


Graphical presentation of results

Results

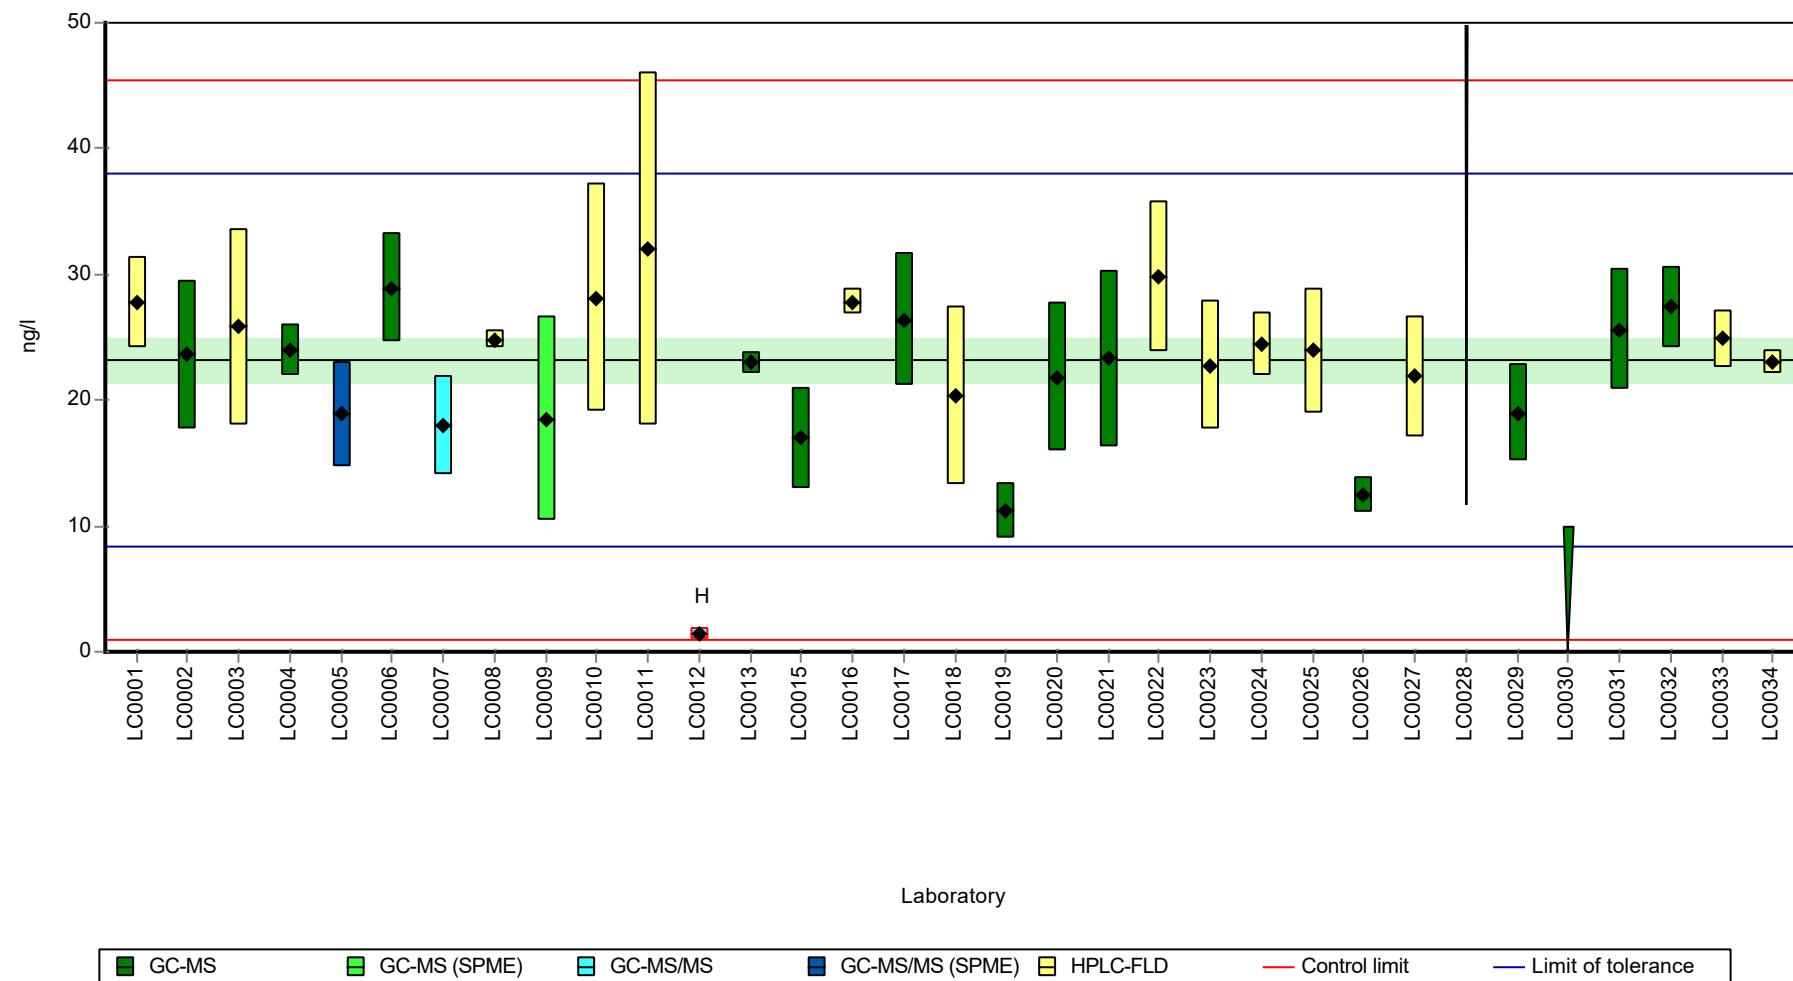


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

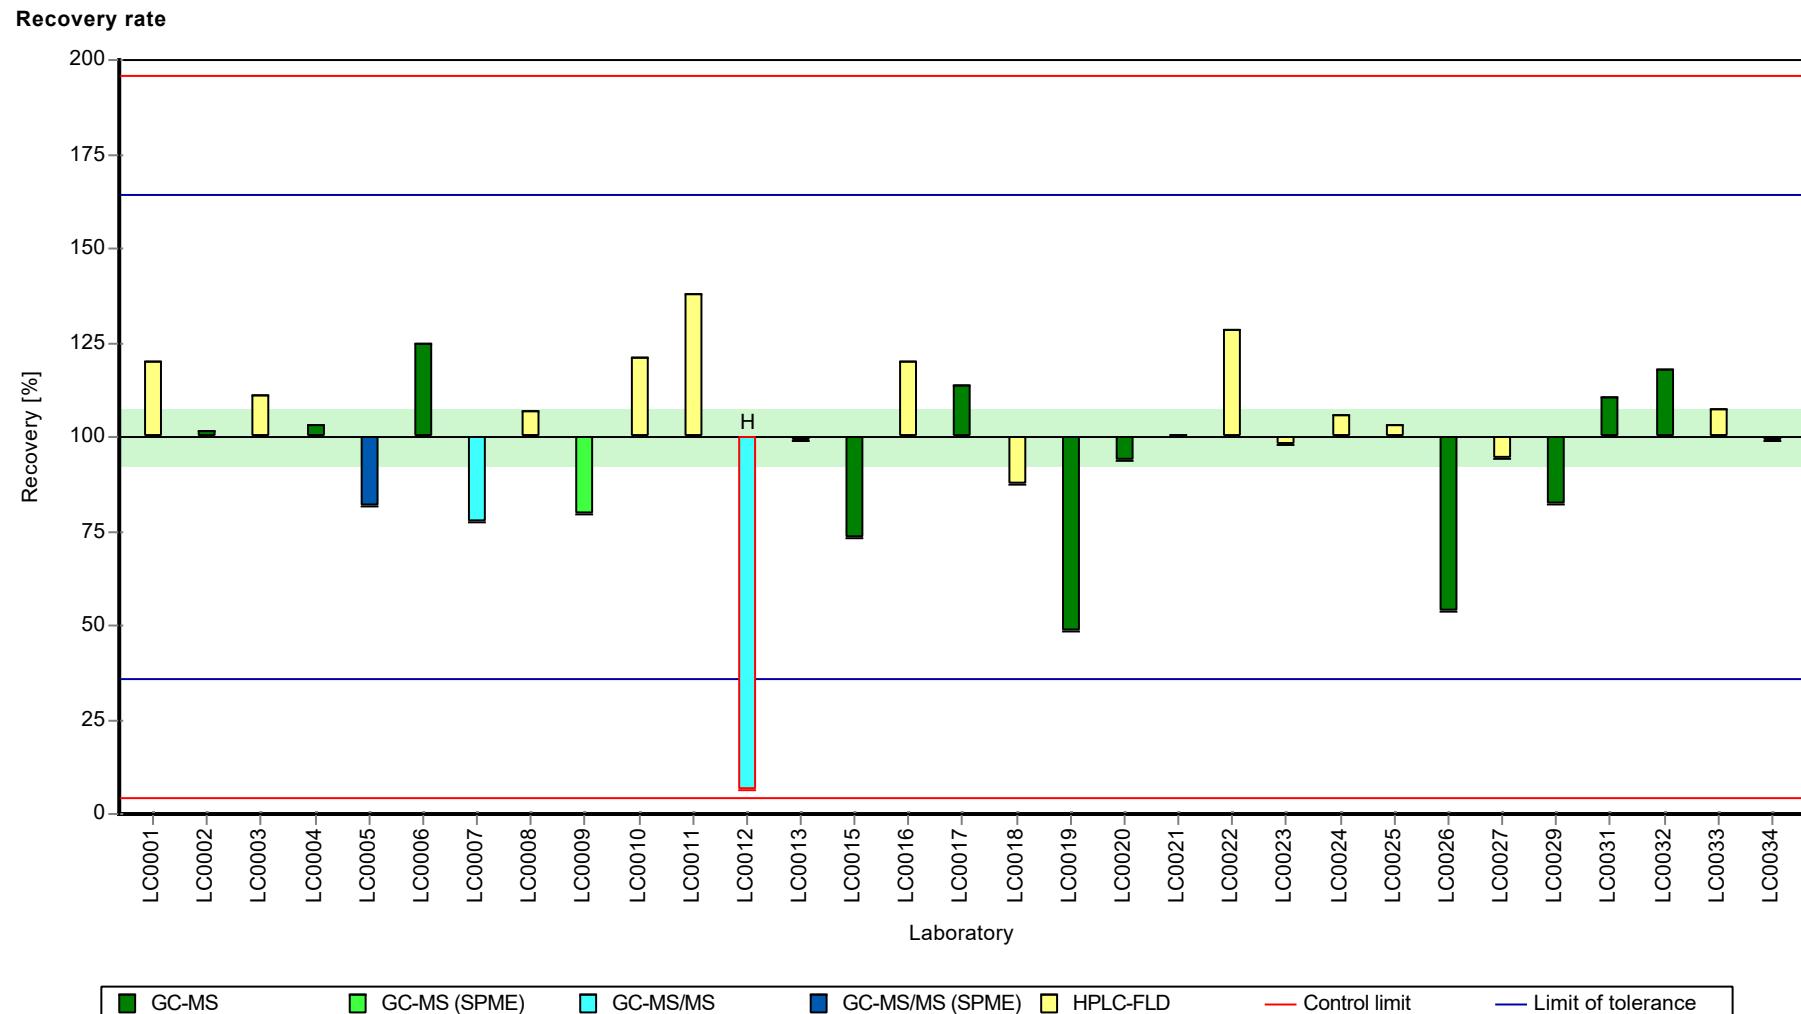

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

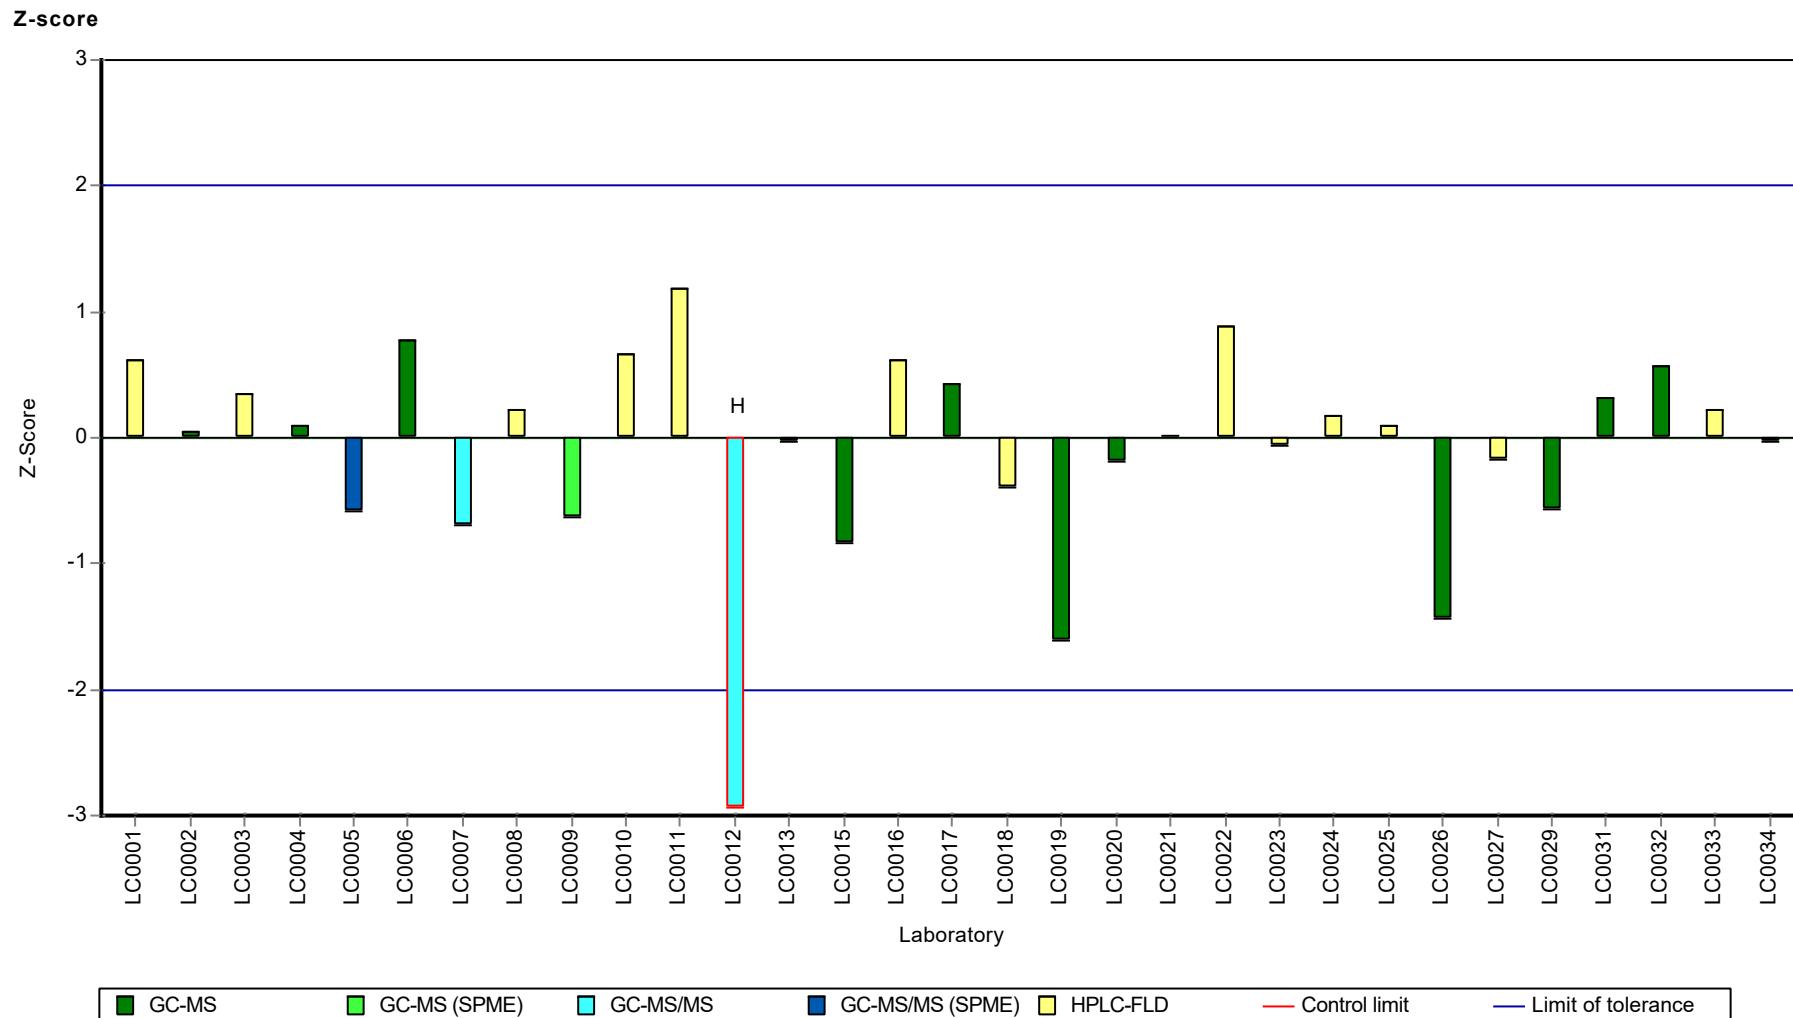

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

Parameter oriented report

P24 B

Benzo[g,h,i]perylene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 152 \pm 11.6
 Criterion 48.6 (32 %)
 Minimum - Maximum 71.5 - 201
 Control test value \pm U (k=2) 192.0 \pm 67.3

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	196	25	129	0.91	
LC0002	163	41	107	0.23	
LC0003	125	37.5	82.3	-0.55	
LC0004	198.79	20	131	0.97	
LC0005	133	29	87.6	-0.39	
LC0006	142.37	21.356	93.8	-0.19	
LC0007	130	26	85.6	-0.45	
LC0008	307	40	202	3.19	H
LC0009	132.9	58.5	87.5	-0.39	
LC0010	174	56.1	115	0.46	
LC0011	182.91	80.481	120	0.64	
LC0012	3.24	0.49	2.1	-3.06	H
LC0013	160	0.93	105	0.17	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	147	35	96.8	-0.1	
LC0016	189	4.29	124	0.76	
LC0017	173.6	34.7	114	0.45	
LC0018	136	47.6	89.6	-0.33	
LC0019	129.95	28.59	85.6	-0.45	
LC0020	126.3	34	83.2	-0.53	
LC0021	103	30.9	67.8	-1.01	
LC0022	201	40.2	132	1.01	
LC0023	156.1	16.4	103	0.09	
LC0024	191.4	19.1	126	0.81	
LC0025	117.4	24.65	77.3	-0.71	
LC0026	71.5	6.6	47.1	-1.65	
LC0027	146	32	96.2	-0.12	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	153	31	101	0.02	
LC0030	16.5	3.3	10.9	-2.79	H
LC0031	130	24	85.6	-0.45	
LC0032	167.25	19.82	110	0.32	
LC0033	137.3	13	90.4	-0.3	
LC0034	189.7	7.95	125	0.78	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	148 ± 28.8	152 ± 17.5 ng/l
Minimum	3.24	71.5 ng/l
Maximum	307	201 ng/l
Standard deviation	54.3	31.3 ng/l
rel. standard deviation	36.7	20.6 %
n	32	29 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene


Graphical presentation of results

Results

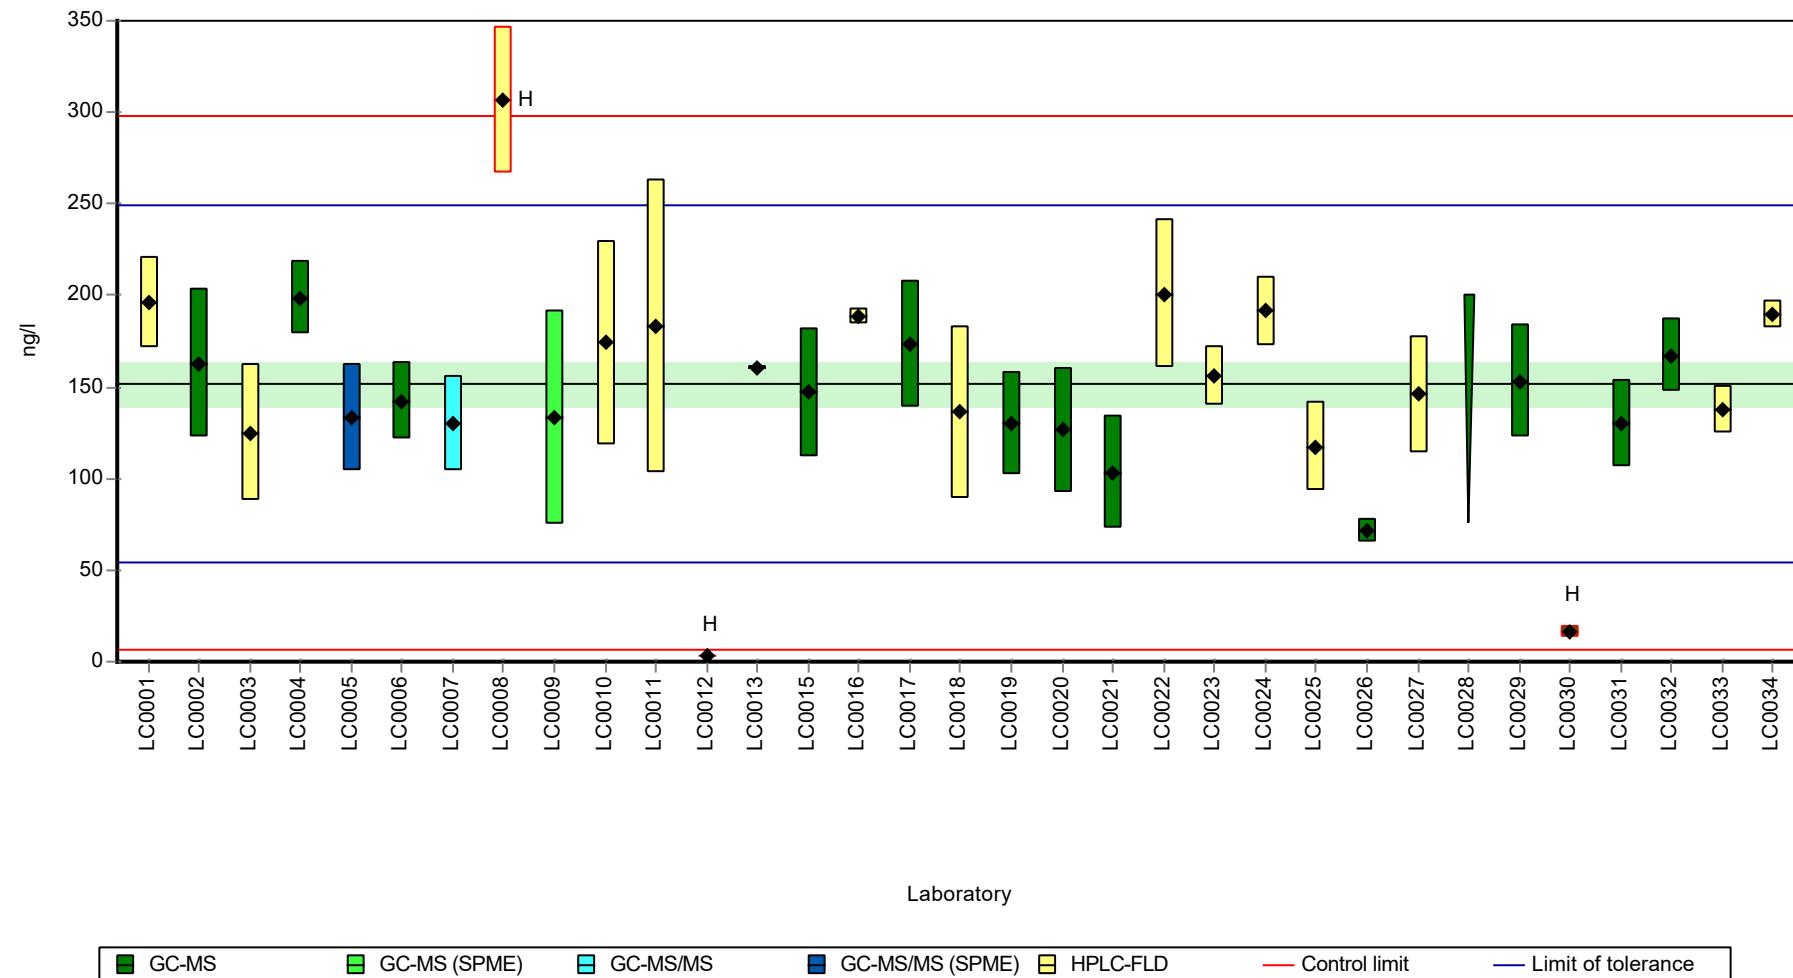


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

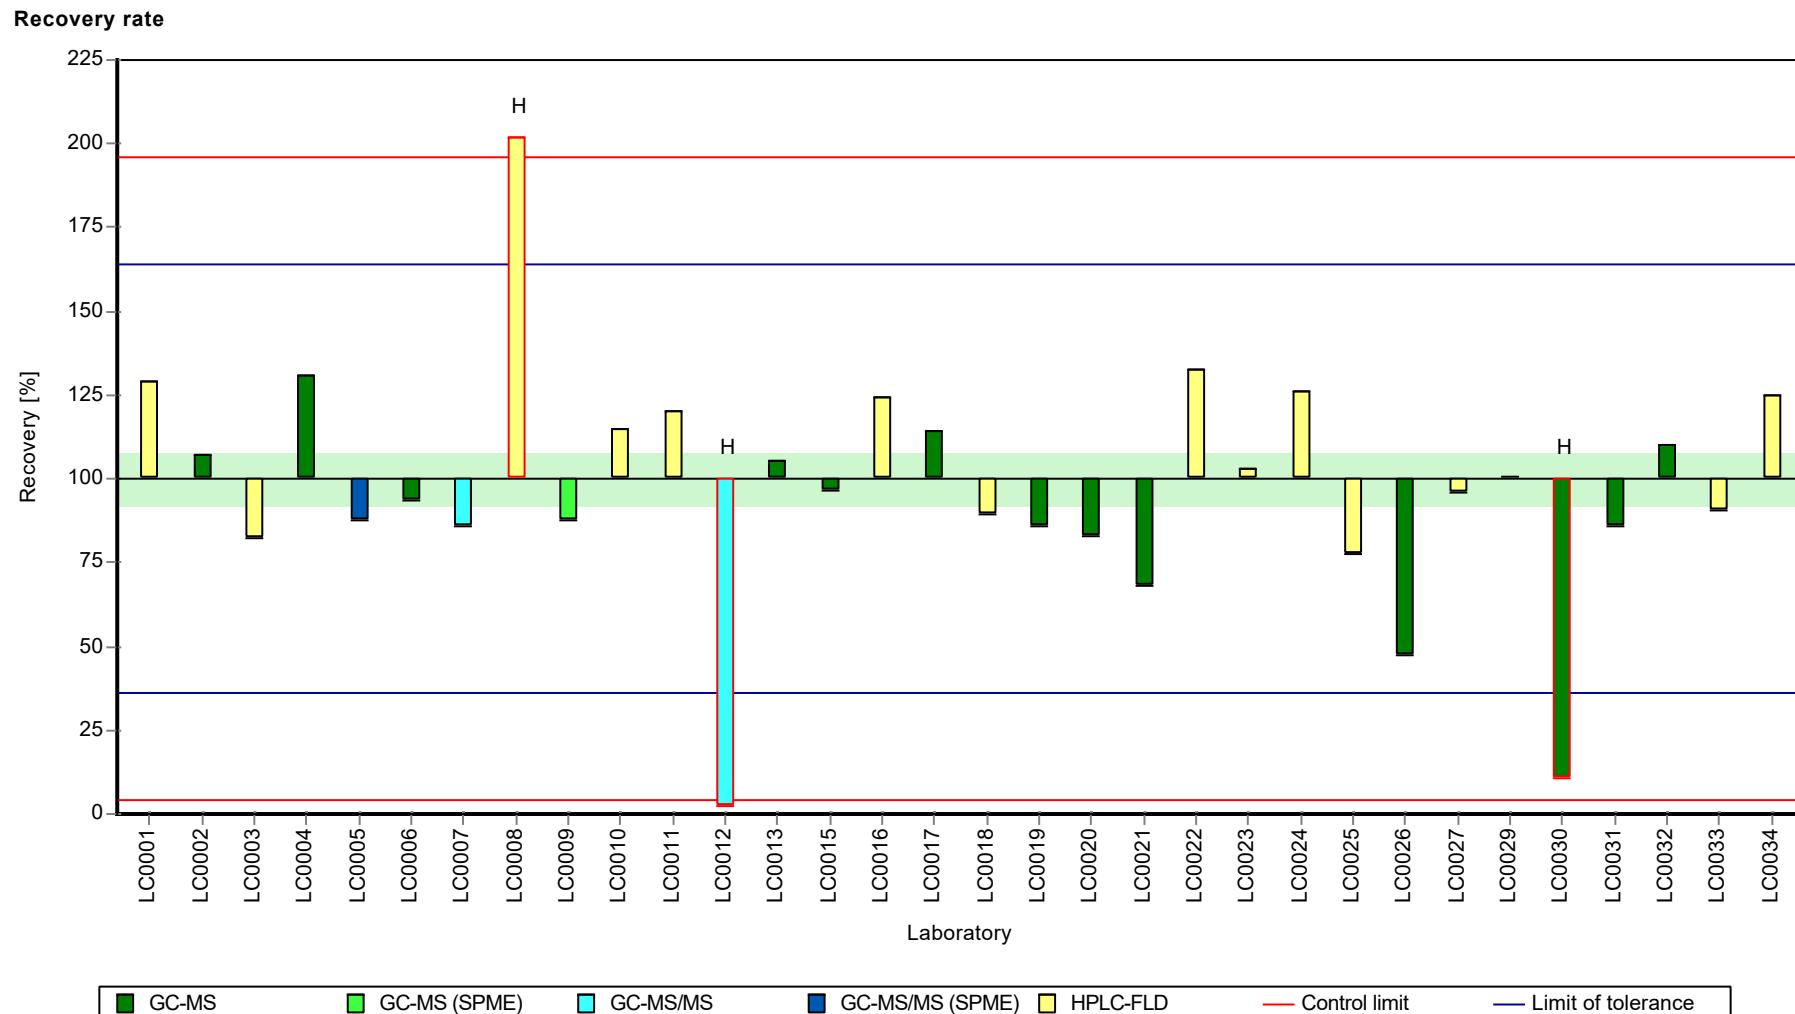

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[g,h,i]perylene

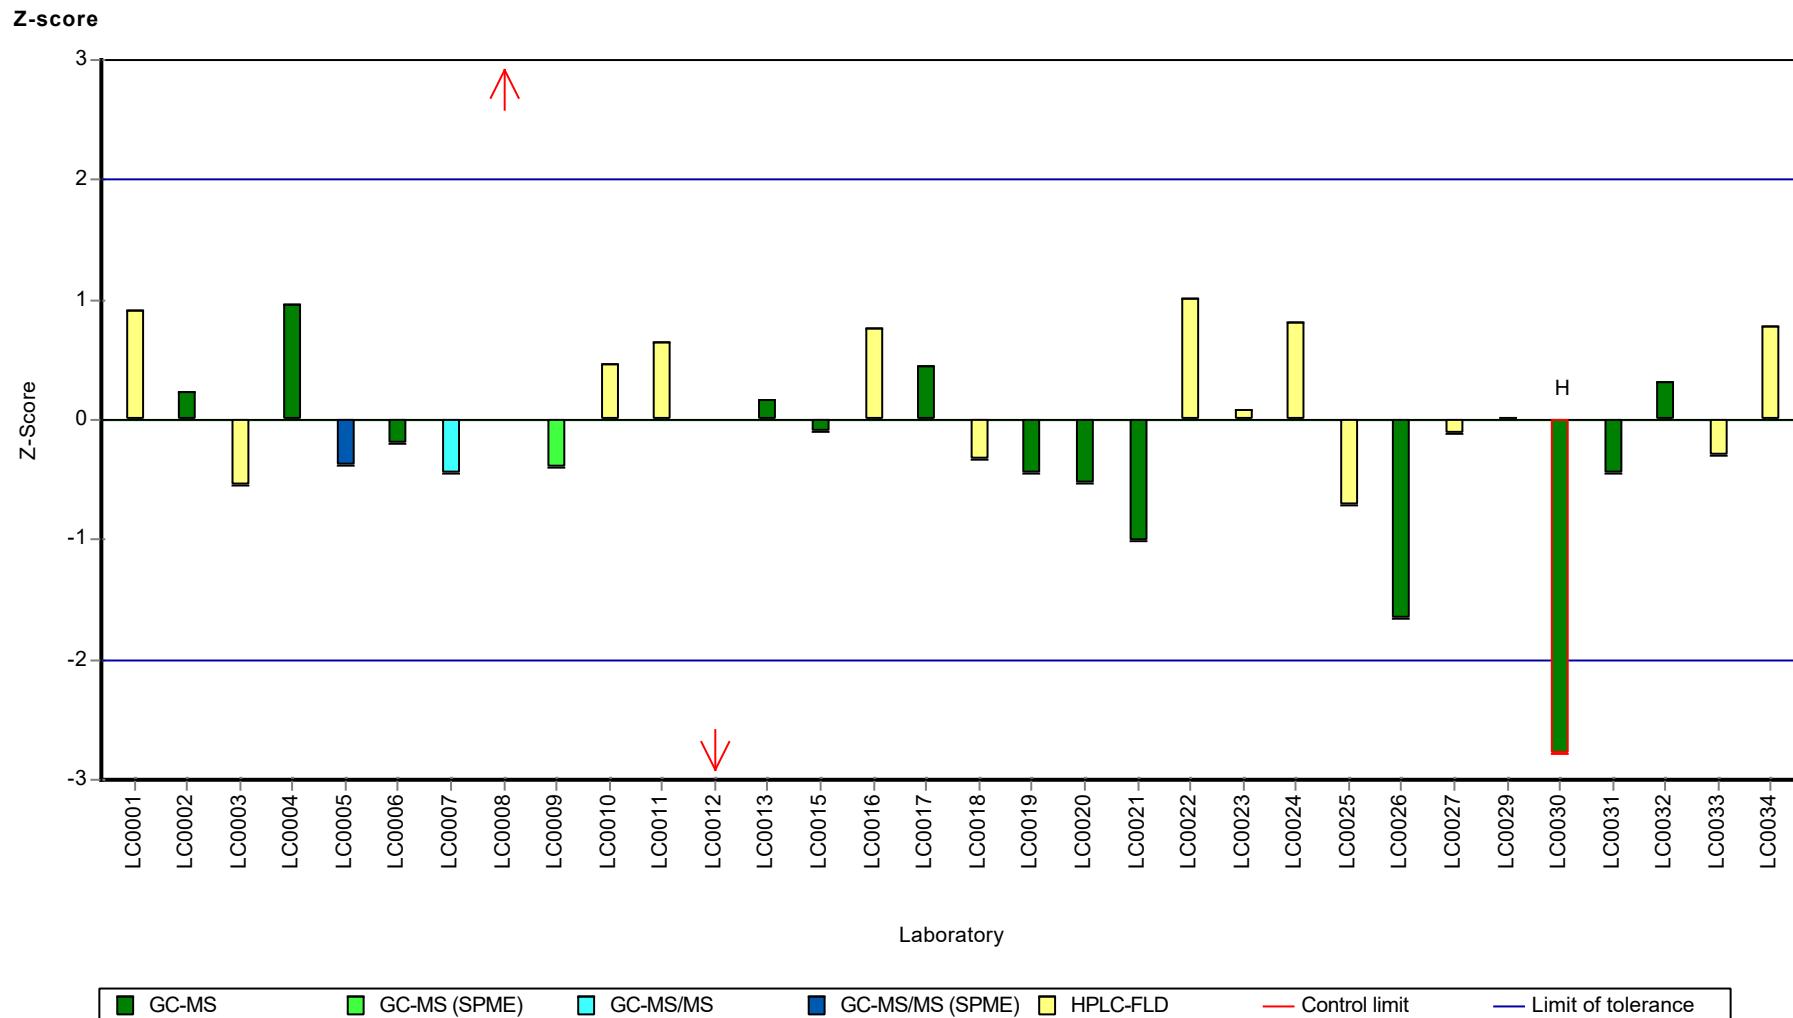

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

Parameter oriented report

P24 A

Benzo[k]fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 21.6 ± 1.11
 Criterion 5.61 (26 %)
 Minimum - Maximum 14.7 - 26.7
 Control test value ± U (k=2) 26.6 ± 7.99

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	23.9	3.1	111	0.41	
LC0002	20.5	5.1	95	-0.19	
LC0003	21.5	6.45	99.6	-0.01	
LC0004	23.4	2	108	0.32	
LC0005	18.9	4.2	87.6	-0.48	
LC0006	25.49	3.824	118	0.7	
LC0007	18	4	83.4	-0.64	
LC0008	22.3	0.51	103	0.13	
LC0009	18.3	8.05	84.8	-0.58	
LC0010	23.5	2.93	109	0.34	
LC0011	25	10.999	116	0.61	
LC0012	1.37	0.15	6.3	-3.6	H
LC0013	21.91	0.6	102	0.06	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	17	4	78.8	-0.82	
LC0016	23.4	1	108	0.32	
LC0017	24.2	4.8	112	0.47	
LC0018	20.4	7.14	94.5	-0.21	
LC0019	8.34	1.83	38.6	-2.36	H
LC0020	19.5	4.5	90.4	-0.37	
LC0021	23.8	7.14	110	0.4	
LC0022	26.7	5.3	124	0.91	
LC0023	23.32	5.3	108	0.31	
LC0024	22.5	2.3	104	0.16	
LC0025	21.2	4.45	98.2	-0.07	
LC0026	14.7	2.35	68.1	-1.23	
LC0027	19.3	4.3	89.4	-0.41	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	15.8	3.2	73.2	-1.03	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	24.7	3.2	114	0.56	
LC0032	24.17	2.04	112	0.46	
LC0033	22.7	2.3	105	0.2	
LC0034	19.7	1.34	91.3	-0.33	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	20.5 ± 2.78	21.6 ± 1.67 ng/l
Minimum	1.37	14.7 ng/l
Maximum	26.7	26.7 ng/l
Standard deviation	5.16	2.99 ng/l
rel. standard deviation	25.2	13.9 %
n	31	29 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[k]fluoranthene


Graphical presentation of results

Results

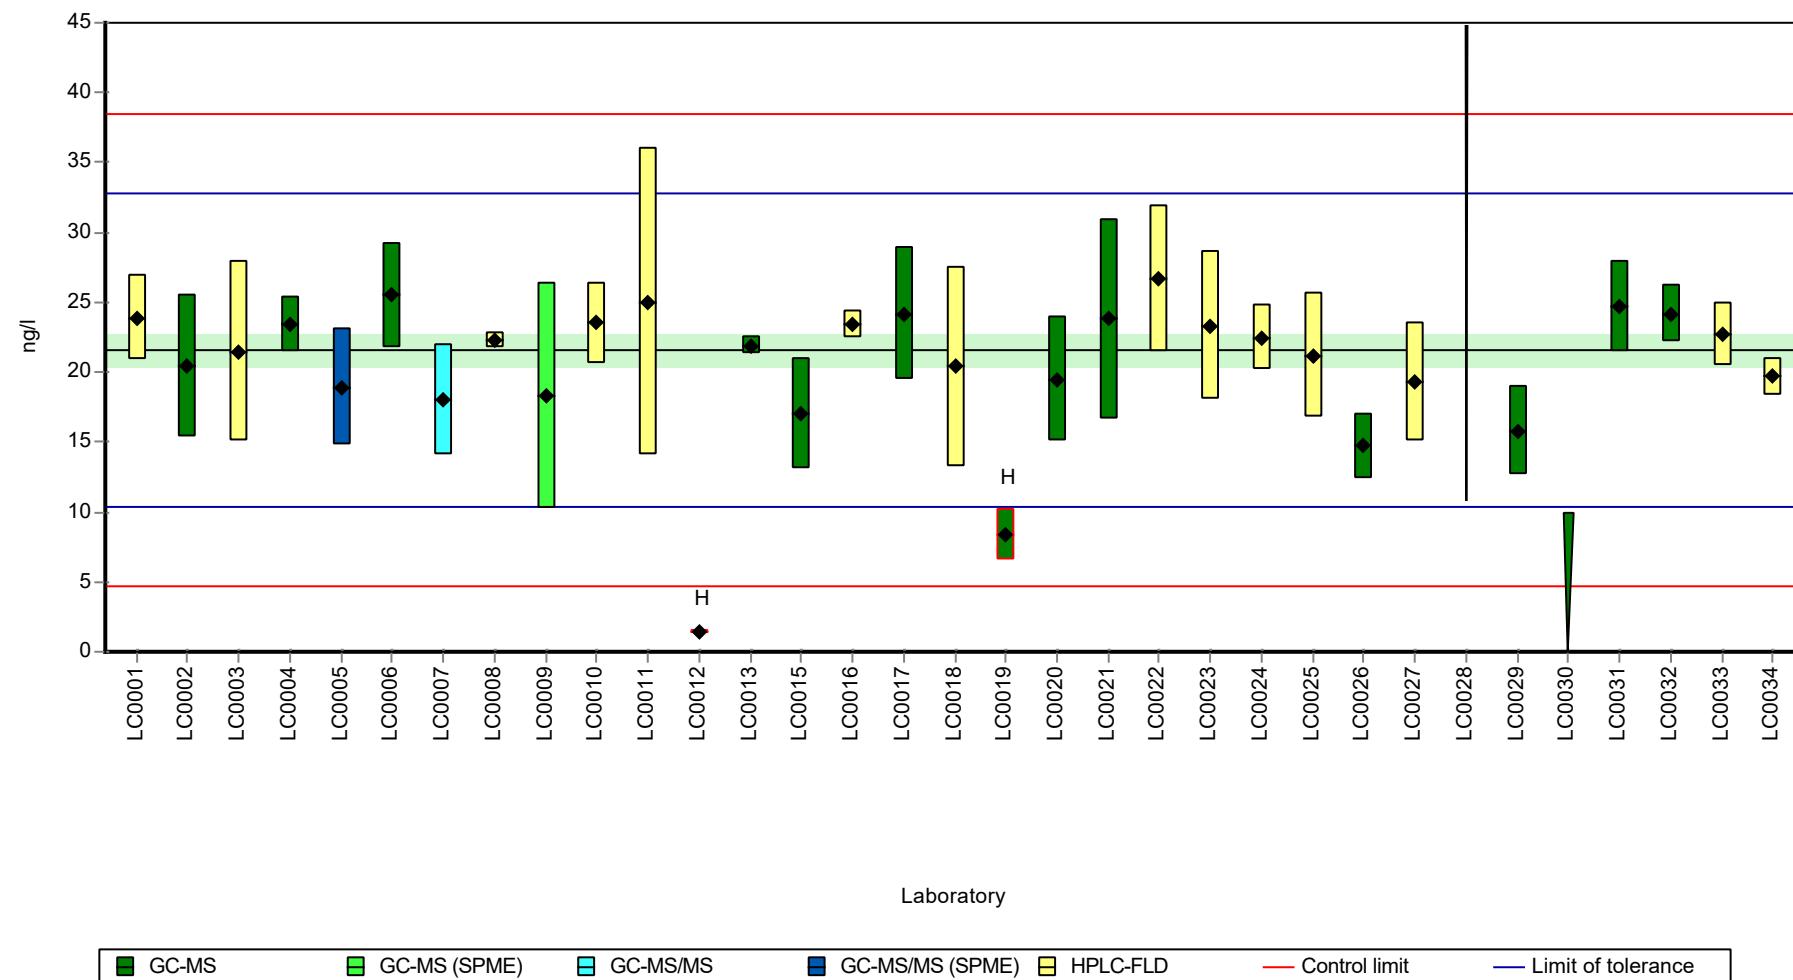


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

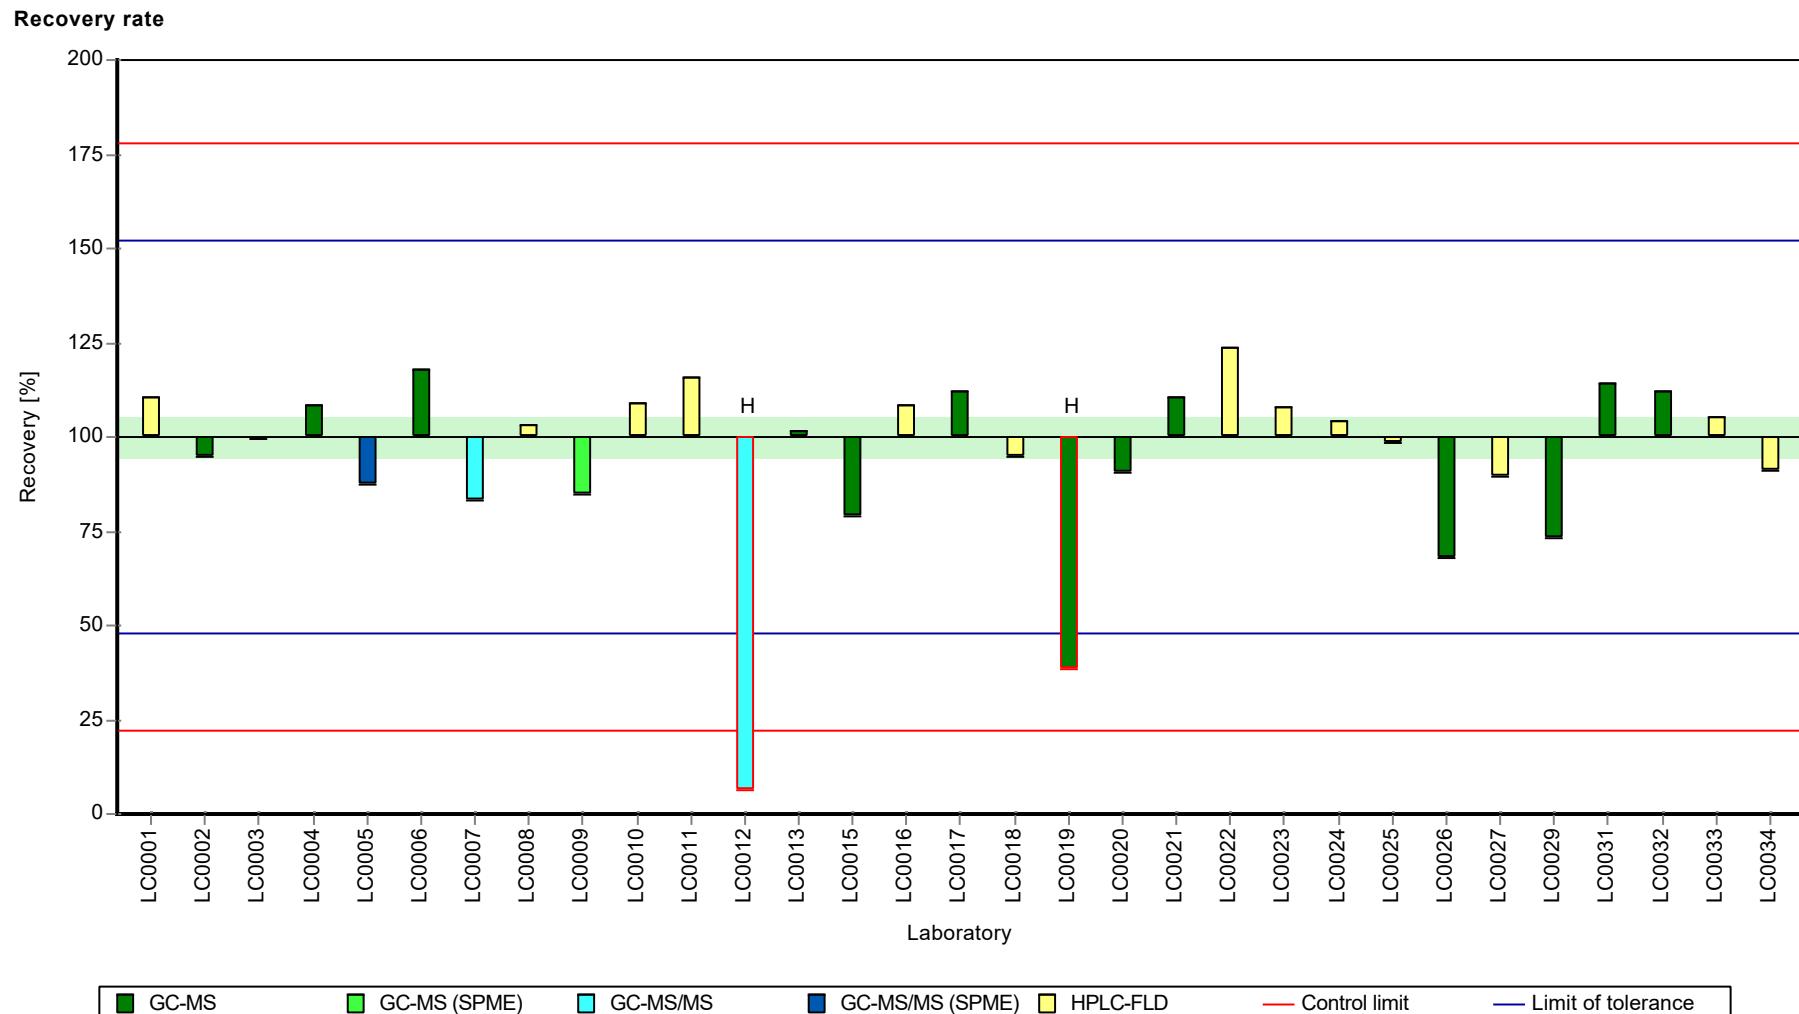

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

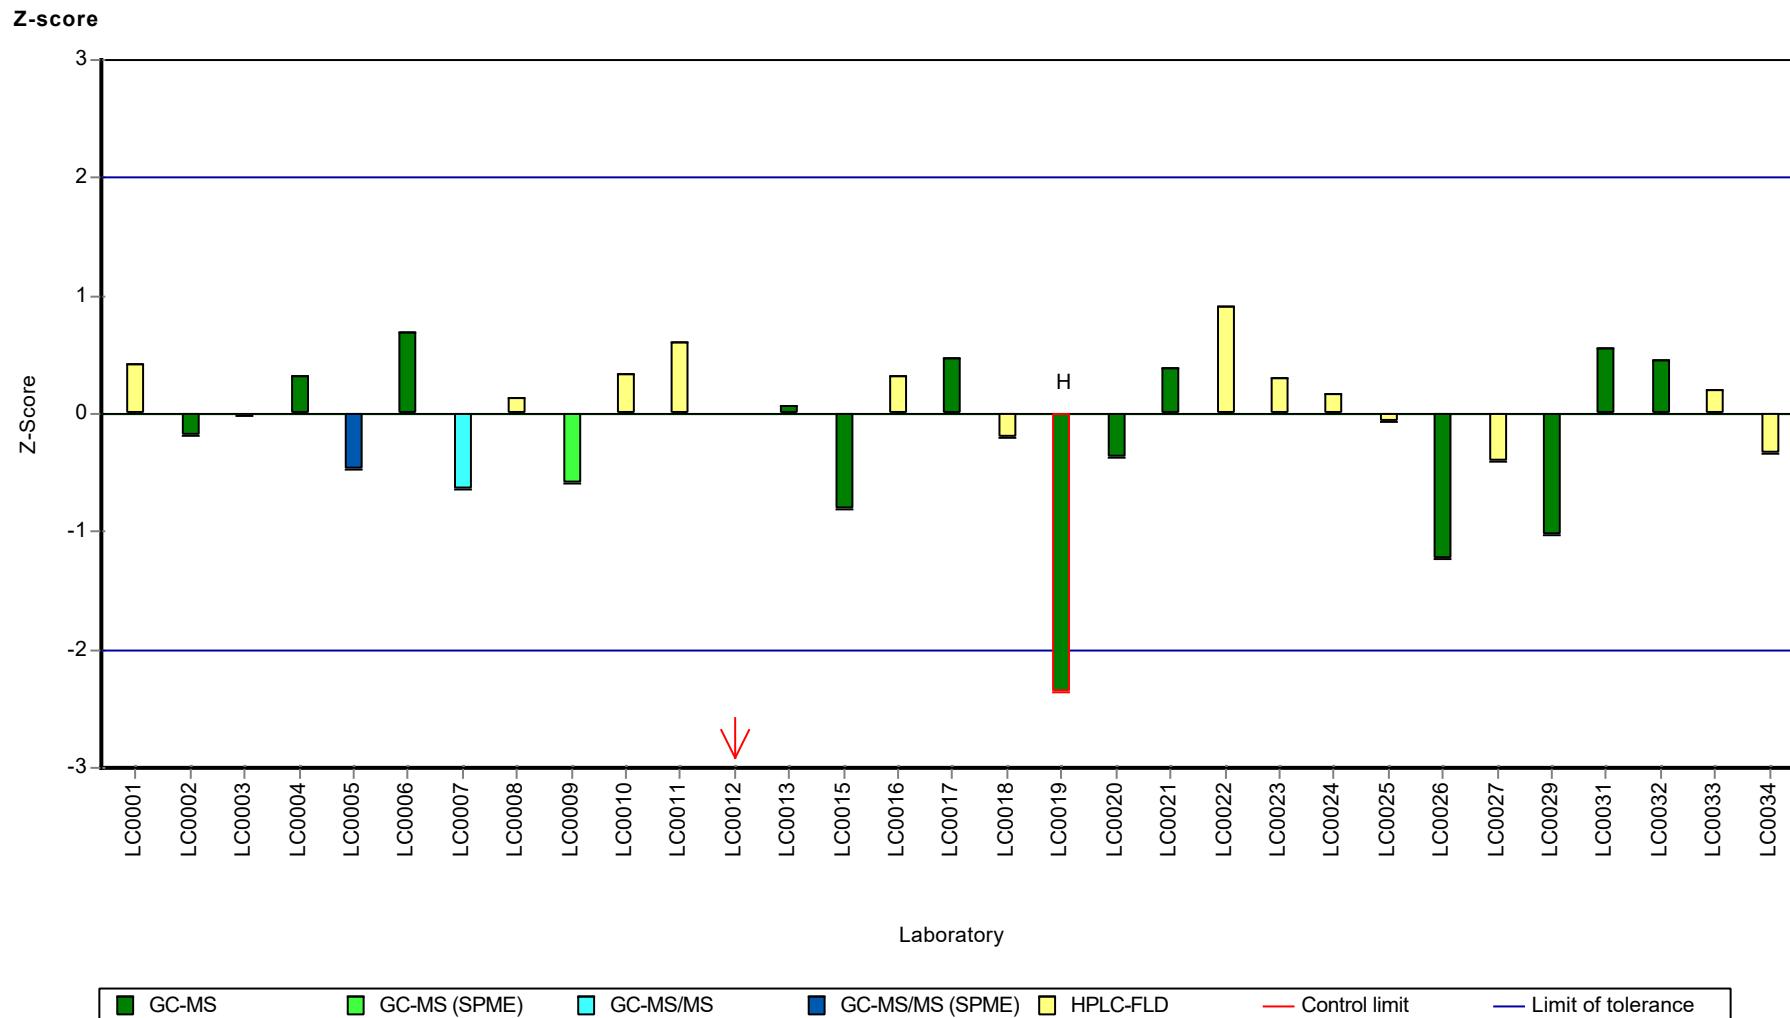

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

Parameter oriented report

P24 B

Benzo[k]fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 153 ± 8.4
 Criterion 39.9 (26 %)
 Minimum - Maximum 97.5 - 189
 Control test value ± U (k=2) 170.0 ± 51

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	175	23	114	0.54	
LC0002	138	35	90	-0.38	
LC0003	152	45.6	99.2	-0.03	
LC0004	184.26	18	120	0.78	
LC0005	137	30	89.4	-0.41	
LC0006	143.74	21.561	93.8	-0.24	
LC0007	128	26	83.5	-0.63	
LC0008	316	15	206	4.08	H
LC0009	135.3	59.5	88.3	-0.45	
LC0010	161	20.1	105	0.19	
LC0011	187.59	82.541	122	0.86	
LC0012	13.4306	0.15	8.8	-3.51	H
LC0013	156.9	0.69	102	0.09	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	145	35	94.6	-0.21	
LC0016	170	4.04	111	0.42	
LC0017	160.1	32	104	0.17	
LC0018	150	52.5	97.9	-0.08	
LC0019	136.59	30.05	89.1	-0.42	
LC0020	174.9	40	114	0.54	
LC0021	162	48.7	106	0.22	
LC0022	189	37.8	123	0.9	
LC0023	97.52	14.3	63.6	-1.4	
LC0024	182.6	18.3	119	0.74	
LC0025	163.3	34.29	107	0.25	
LC0026	110	7	71.8	-1.09	
LC0027	135	30	88.1	-0.46	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	140	28	91.3	-0.33	
LC0030	18	3.6	11.7	-3.39	H
LC0031	171	22	112	0.44	
LC0032	176.66	14.93	115	0.59	
LC0033	142.4	14.5	92.9	-0.27	
LC0034	140.3	9.57	91.5	-0.33	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	150 ± 26.6	153 ± 12.6 ng/l
Minimum	13.4	97.5 ng/l
Maximum	316	189 ng/l
Standard deviation	50.3	22.6 ng/l
rel. standard deviation	33.6	14.8 %
n	32	29 -


Graphical presentation of results

Results

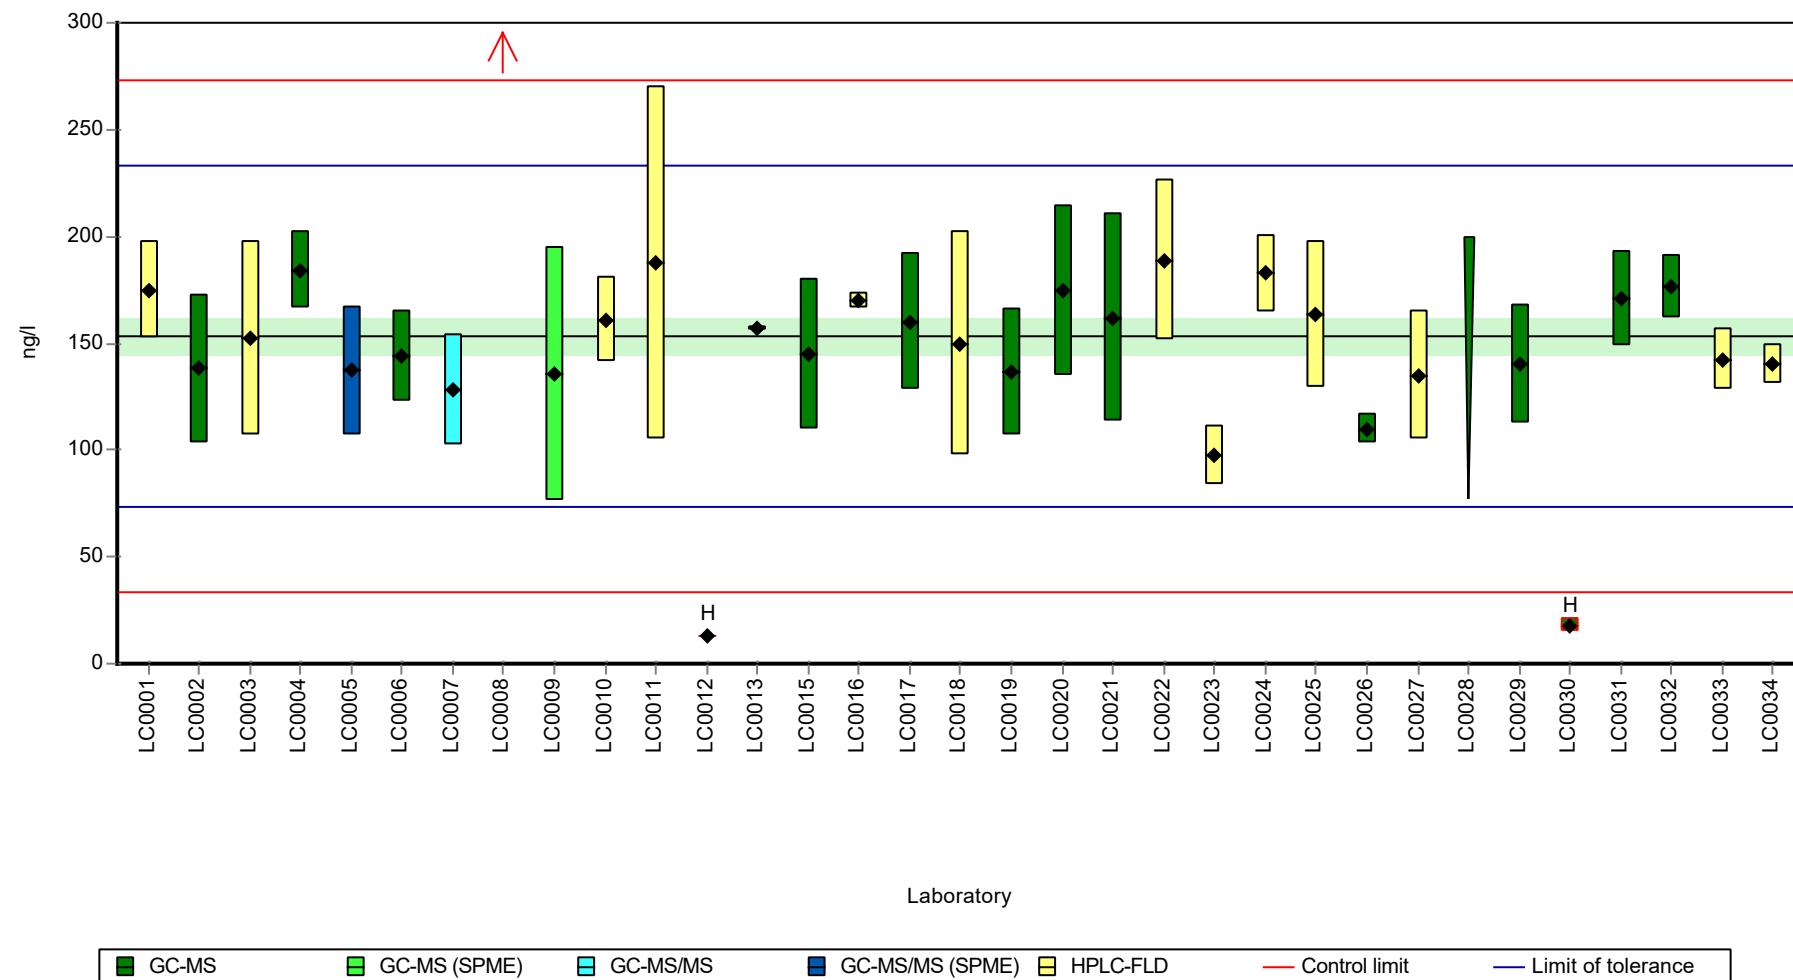


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

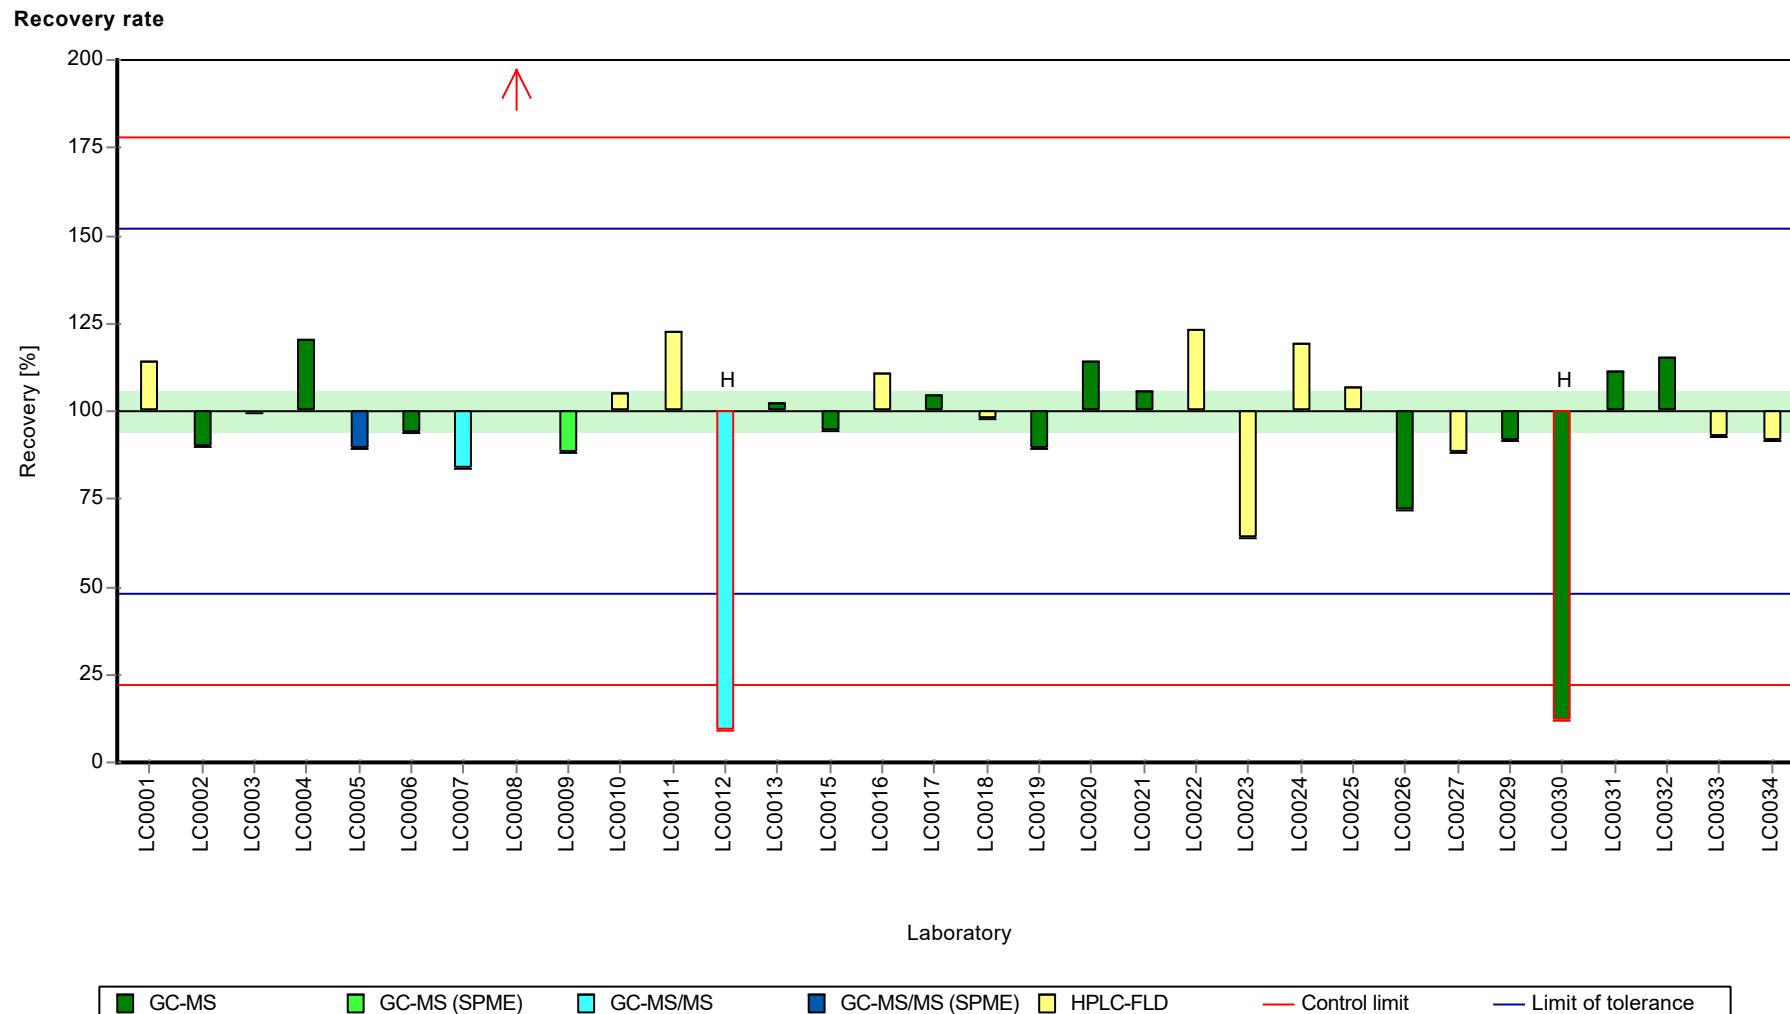

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Benzo[k]fluoranthene

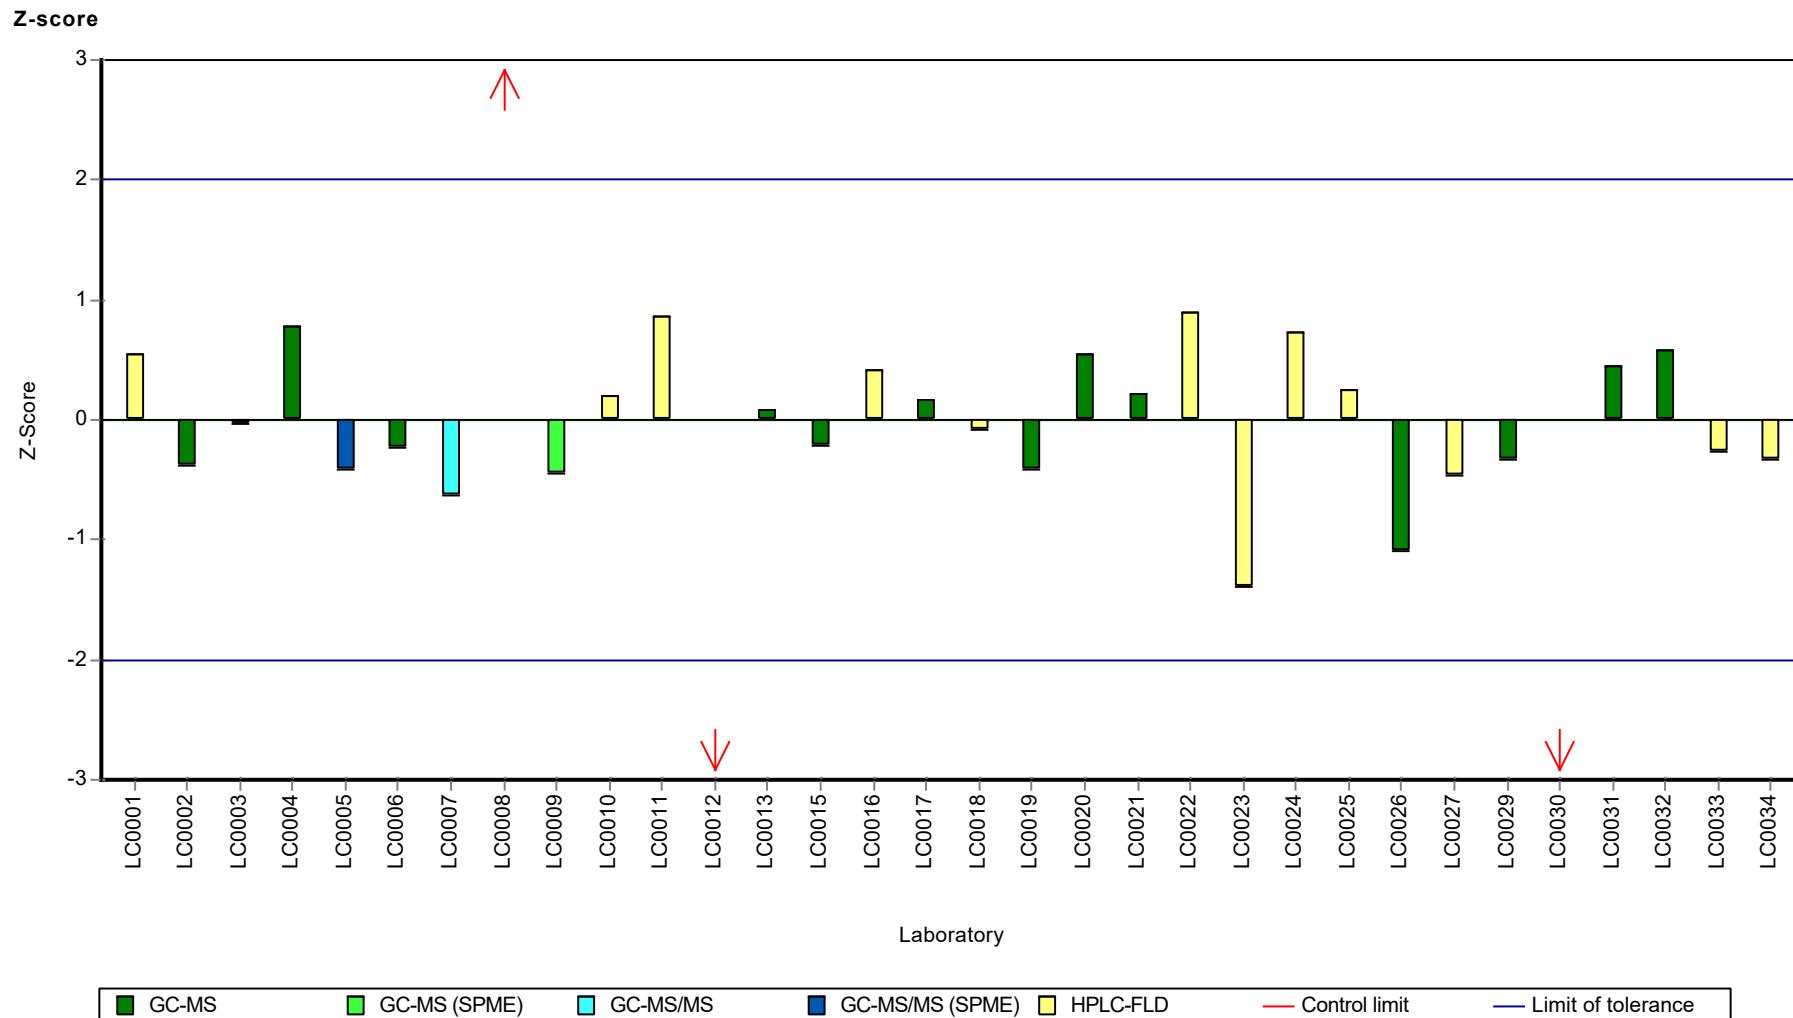

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Chrysene

Parameter oriented report

P24A

Chrysene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 26.9 ± 1.19
 Criterion 5.91 (22 %)
 Minimum - Maximum 22.5 - 33.1
 Control test value ± U (k=2) 30.3 ± 7.56

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	28.4	3.7	106	0.26	
LC0002	25.8	5.2	96	-0.18	
LC0003	26.4	7.92	98.2	-0.08	
LC0004	26.55	2.5	98.8	-0.06	
LC0005	23.6	5.2	87.8	-0.55	
LC0006	28.34	4.251	105	0.25	
LC0007	23	5	85.6	-0.66	
LC0008	29	0.26	108	0.36	
LC0009	27.15	11.95	101	0.05	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	40.63	17.879	151	2.32	H
LC0012	41.93	1.24	156	2.54	H
LC0013	< 30 (LOQ)	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	23	6	85.6	-0.66	
LC0016	27.1	1.17	101	0.04	
LC0017	29	5.8	108	0.36	
LC0018	24.1	8.44	89.7	-0.47	
LC0019	-	-	-	-	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	32.3	6.5	120	0.92	
LC0023	30.14	5.4	112	0.55	
LC0024	27.3	2.7	102	0.07	
LC0025	25.8	5.42	96	-0.18	
LC0026	33.1	1.8	123	1.05	
LC0027	23.1	5.1	85.9	-0.64	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	16.6	3.3	61.8	-1.74	H
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	27.6	3.5	103	0.12	
LC0032	27.99	2.41	104	0.19	
LC0033	27	2.5	100	0.02	
LC0034	22.5	1.29	83.7	-0.74	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Chrysene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	27.6 ± 3.08	26.9 ± 1.78 ng/l
Minimum	16.6	22.5 ng/l
Maximum	41.9	33.1 ng/l
Standard deviation	5.24	2.85 ng/l
rel. standard deviation	19	10.6 %
n	26	23 -


Graphical presentation of results

Results

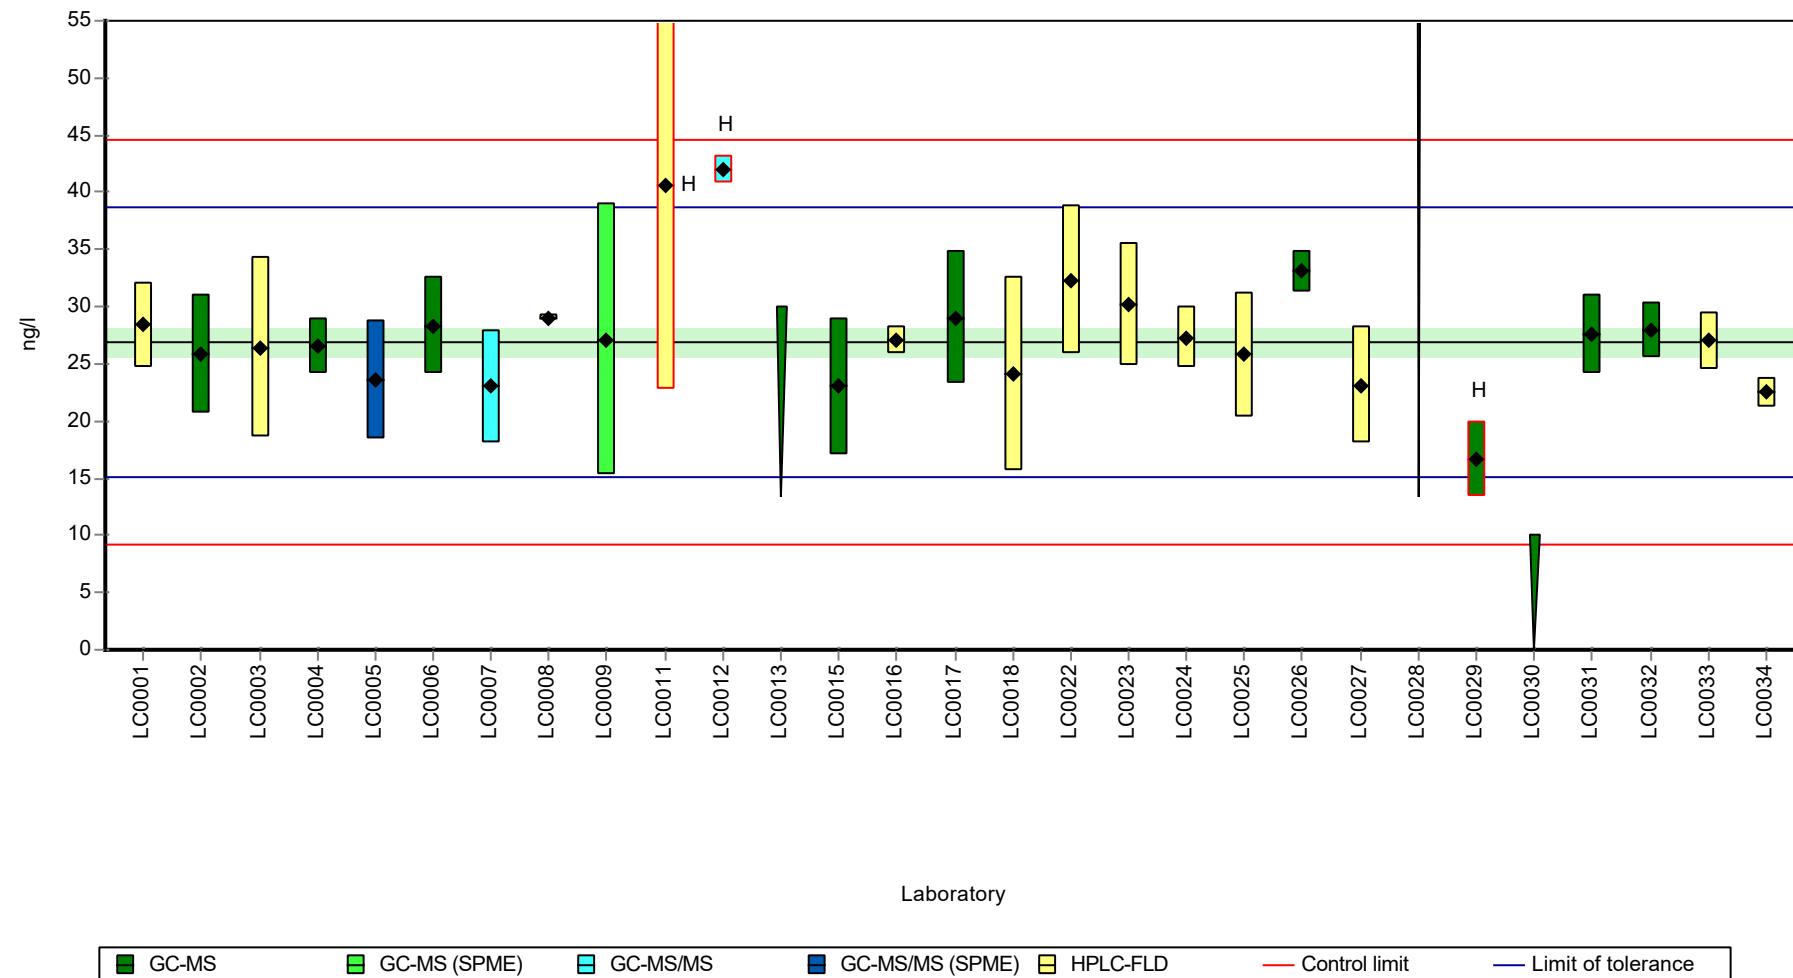


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Chrysene

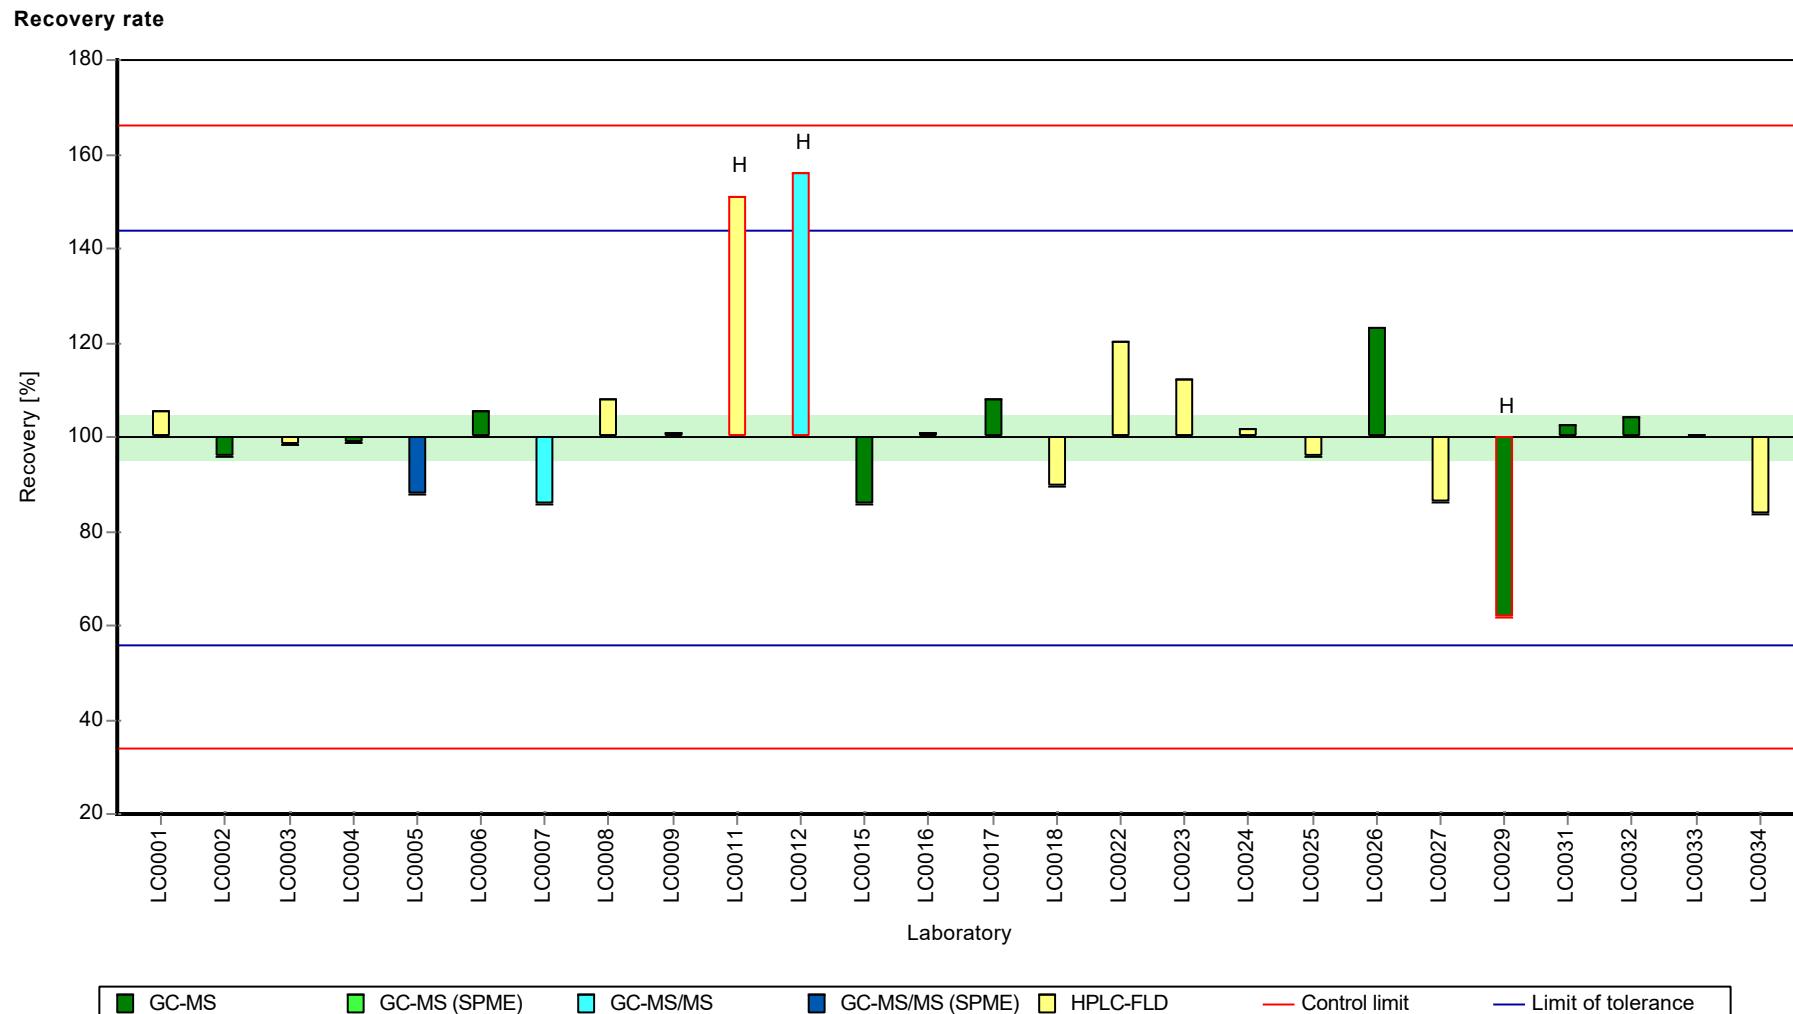

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Chrysene

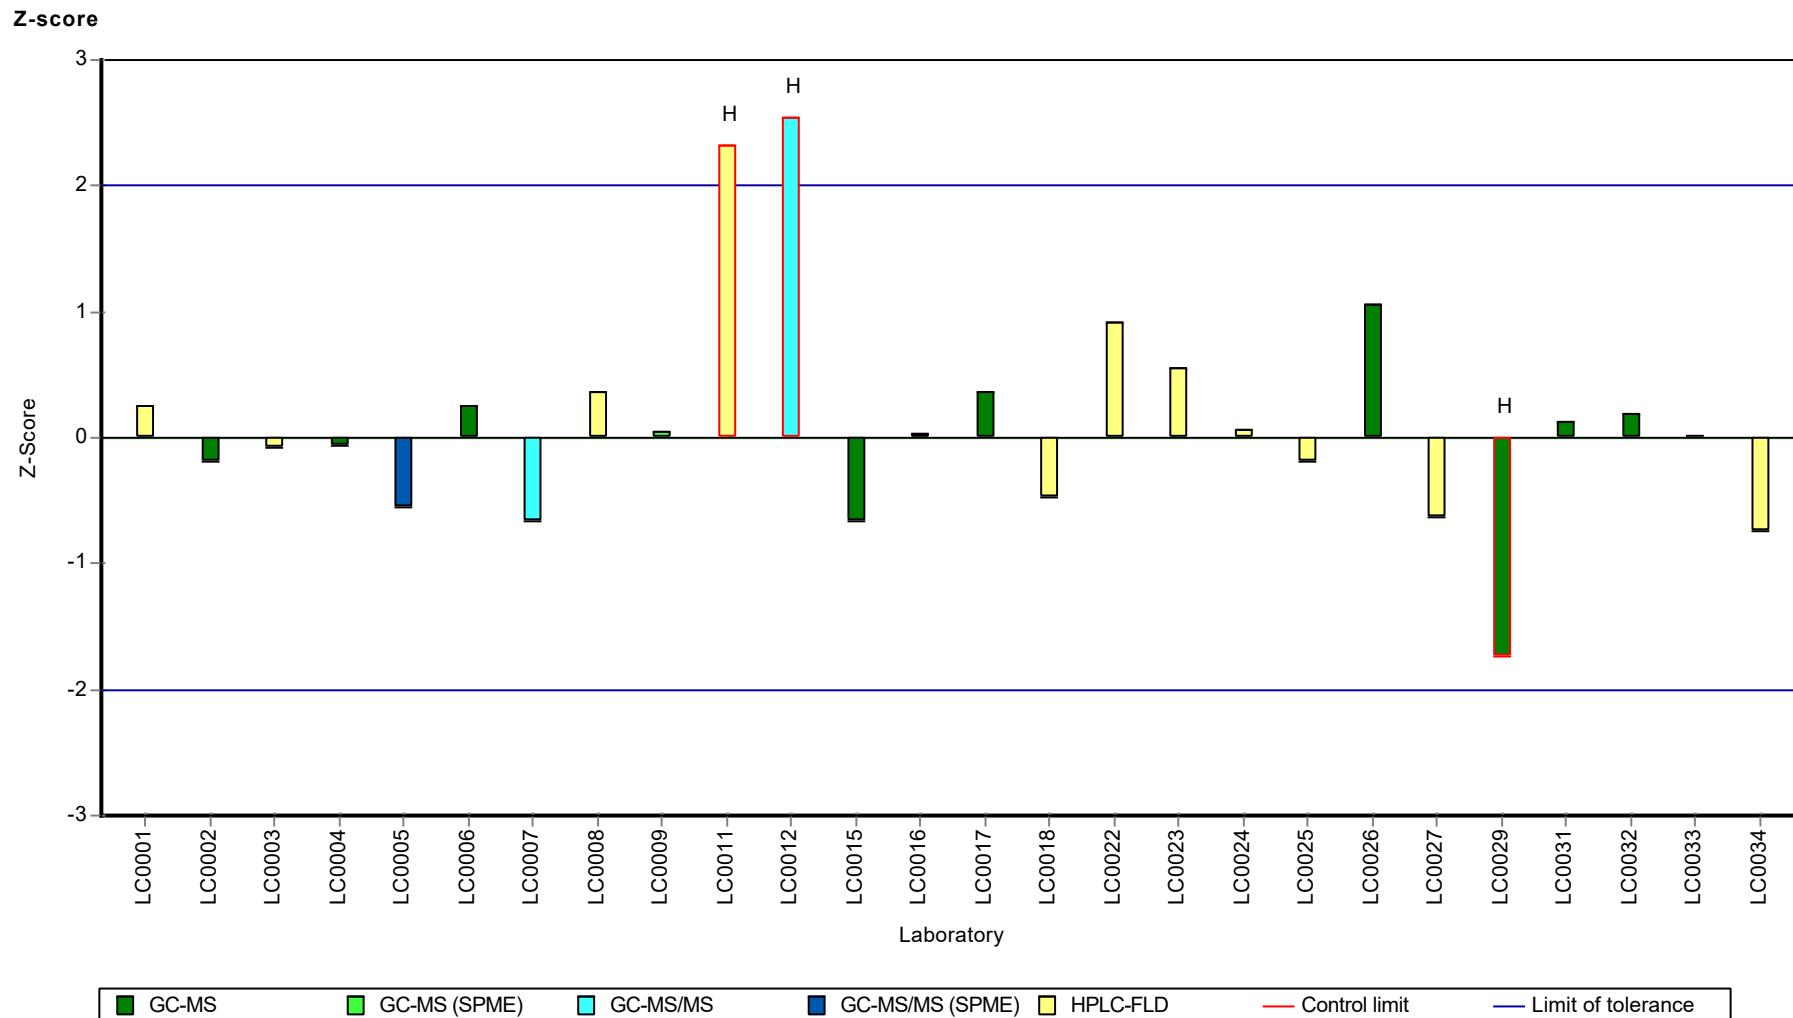

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Chrysene

Parameter oriented report

P24 B

Chrysene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 180 ± 7.8
 Criterion 39.7 (22 %)
 Minimum - Maximum 132 - 219
 Control test value ± U (k=2) 202.0 ± 50.5

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	193	25	107	0.32	
LC0002	172	34	95.4	-0.21	
LC0003	178	53.3	98.7	-0.06	
LC0004	204.55	20	113	0.61	
LC0005	167	37	92.6	-0.34	
LC0006	171.24	25.686	95	-0.23	
LC0007	169	34	93.7	-0.29	
LC0008	410	16	227	5.79	H
LC0009	191.5	84.3	106	0.28	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	218.9	96.314	121	0.97	
LC0012	291.73	0.15	162	2.81	H
LC0013	172.1	5.44	95.4	-0.21	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	179	43	99.3	-0.03	
LC0016	192	4.77	106	0.29	
LC0017	189.8	38	105	0.24	
LC0018	175	61.3	97.1	-0.13	
LC0019	-	-	-	-	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	208	41.6	115	0.7	
LC0023	167.4	15.6	92.8	-0.33	
LC0024	201	20.1	111	0.52	
LC0025	193.3	40.59	107	0.33	
LC0026	265	9	147	2.14	H
LC0027	156	34	86.5	-0.61	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	132	26	73.2	-1.22	
LC0030	20.5	4.1	11.4	-4.03	H
LC0031	185	23	103	0.12	
LC0032	188.26	16.19	104	0.2	
LC0033	160.3	14.7	88.9	-0.5	
LC0034	163	9.36	90.4	-0.44	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Chrysene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	190 ± 35.1	180 ± 11.7 ng/l
Minimum	20.5	132 ng/l
Maximum	410	219 ng/l
Standard deviation	62	19.1 ng/l
rel. standard deviation	32.7	10.6 %
n	28	24 -


Graphical presentation of results

Results

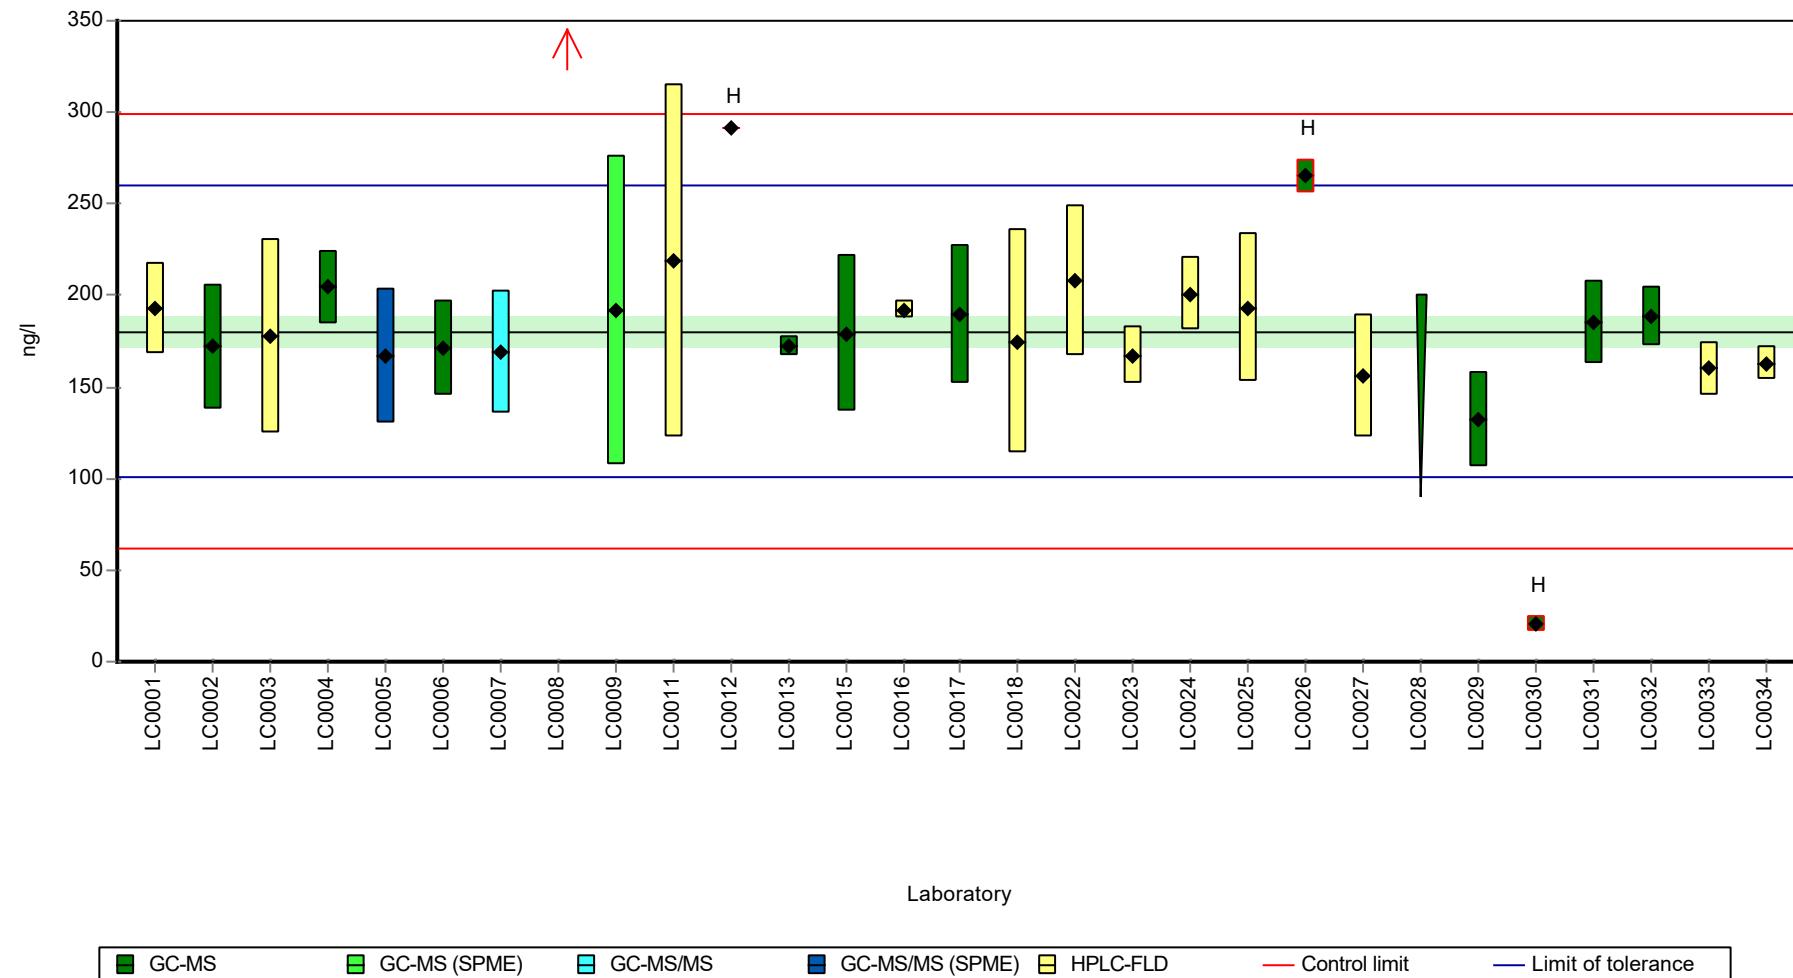


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Chrysene

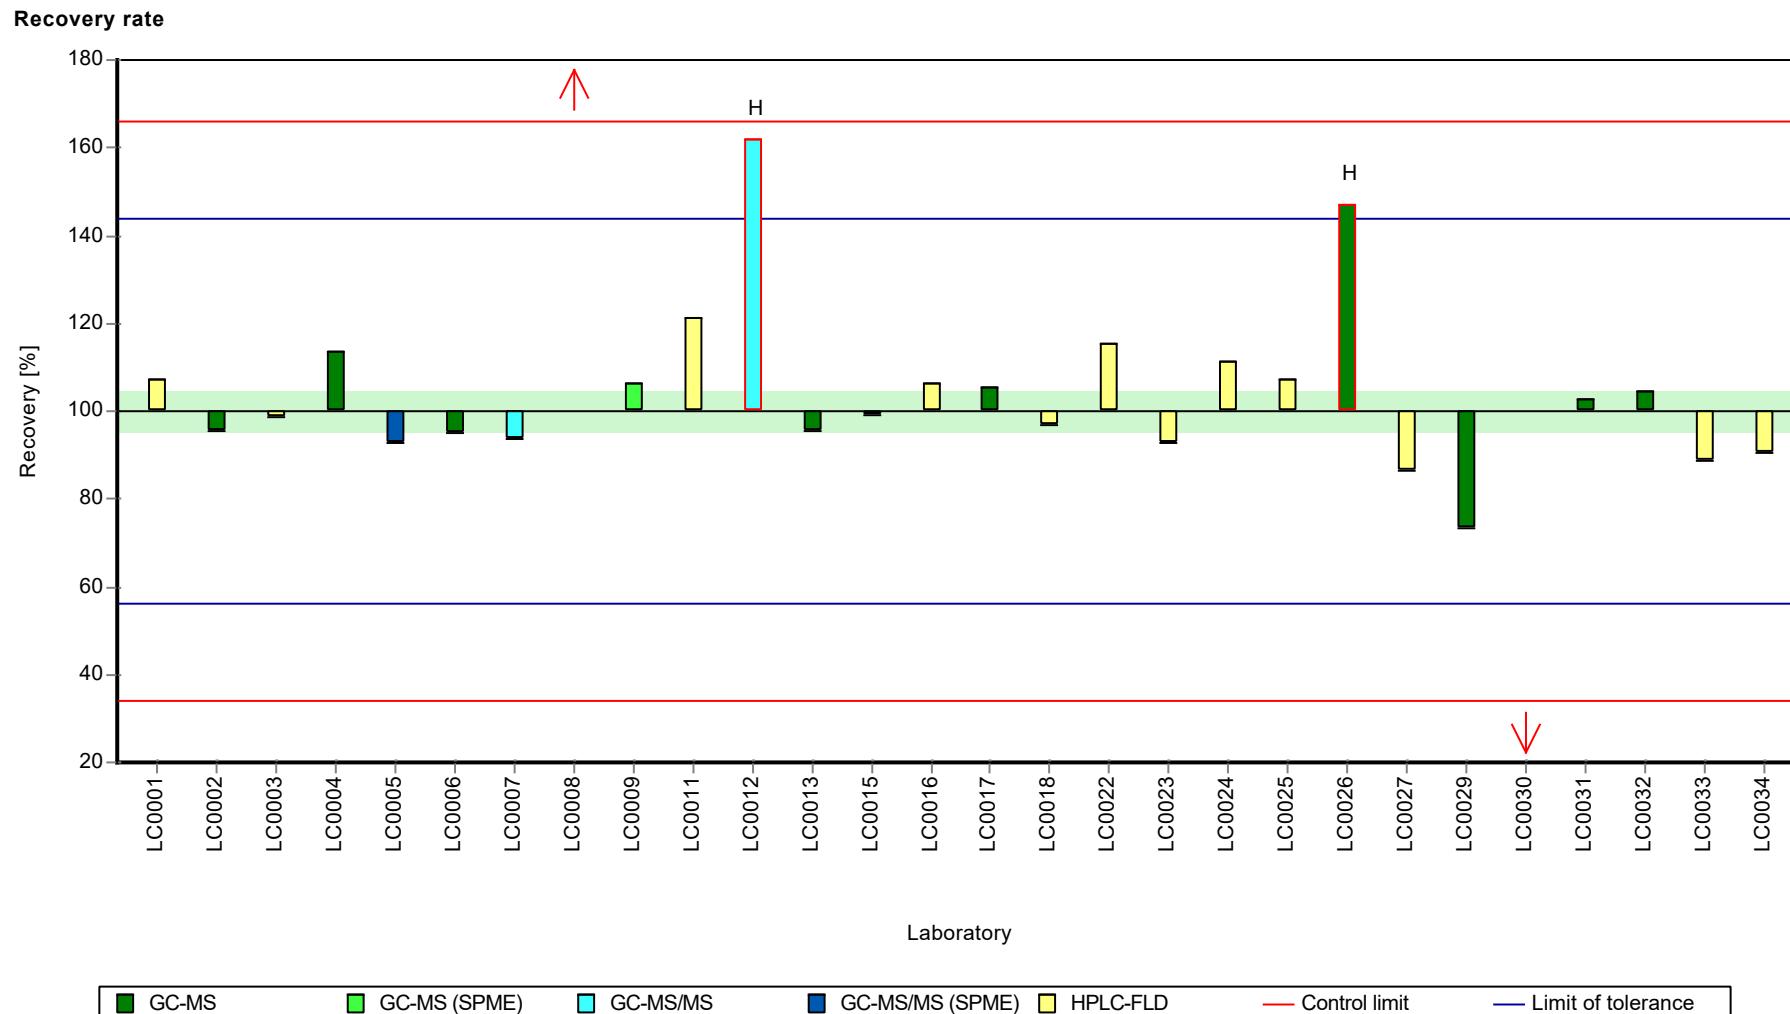

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Chrysene

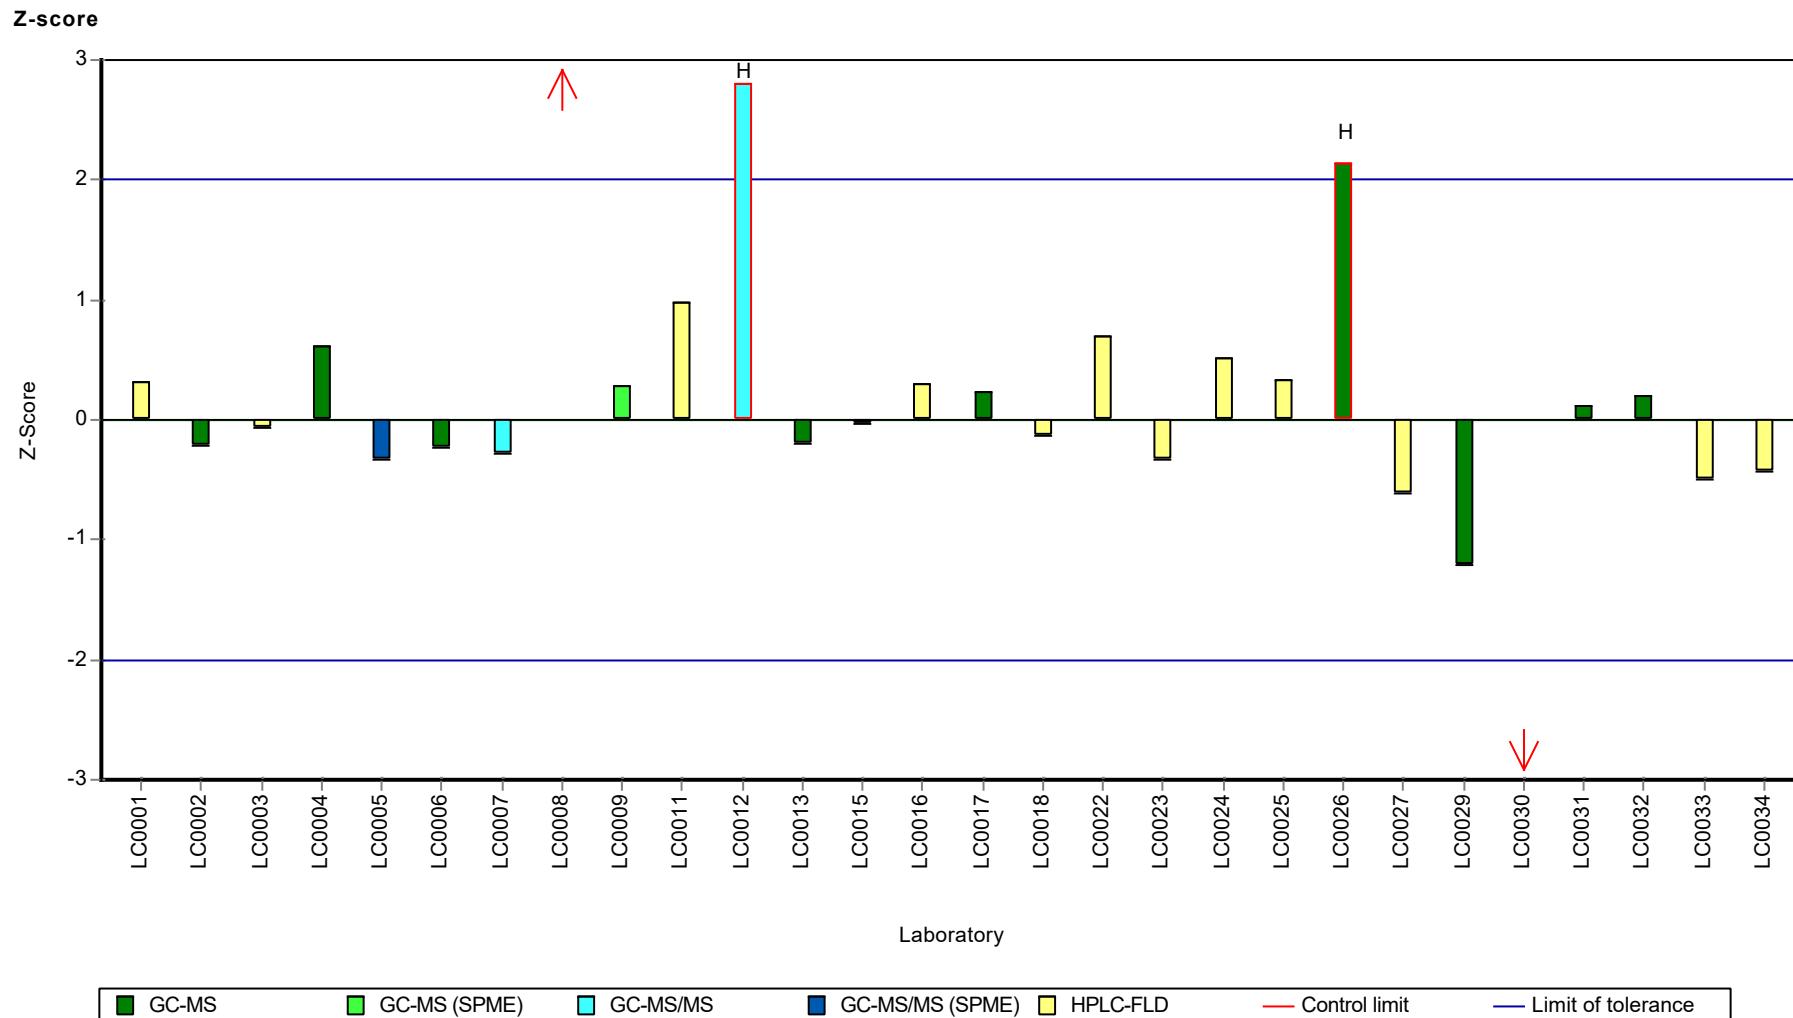

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

Parameter oriented report

P24A

Dibenzo[a,h]anthracene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 25.7 ± 1.57
 Criterion 7.7 (30 %)
 Minimum - Maximum 17 - 33.5
 Control test value ± U (k=2) 34.7 ± 12.1

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	27.7	3.6	108	0.26	
LC0002	24.5	6.1	95.5	-0.15	
LC0003	27.5	8.24	107	0.24	
LC0004	23.48	2	91.5	-0.28	
LC0005	30.5	6.7	119	0.63	
LC0006	27.2	4.08	106	0.2	
LC0007	17	3	66.2	-1.13	
LC0008	25.3	1	98.6	-0.05	
LC0009	29.55	13	115	0.51	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	33.5	14.739	131	1.02	
LC0012	1.67	0.25	6.5	-3.12	H
LC0013	25.32	1	98.7	-0.04	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	17	4	66.2	-1.13	
LC0016	28.3	0.89	110	0.34	
LC0017	26.6	5.3	104	0.12	
LC0018	23.7	8.3	92.4	-0.25	
LC0019	12.95	2.85	50.5	-1.65	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	30.6	6.1	119	0.64	
LC0023	23.98	4.8	93.4	-0.22	
LC0024	26.1	2.6	102	0.06	
LC0025	24.9	5.23	97	-0.1	
LC0026	10.1	0.5	39.4	-2.02	H
LC0027	23.2	5.1	90.4	-0.32	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	19.8	4	77.2	-0.76	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	25.9	6.1	101	0.03	
LC0032	30	3.585	117	0.56	
LC0033	25.7	4	100	0.01	
LC0034	24.2	2.21	94.3	-0.19	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	23.8 ± 3.86	25.7 ± 2.35 ng/l
Minimum	1.67	17 ng/l
Maximum	33.5	33.5 ng/l
Standard deviation	6.8	3.91 ng/l
rel. standard deviation	28.6	15.2 %
n	28	25 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene


Graphical presentation of results

Results

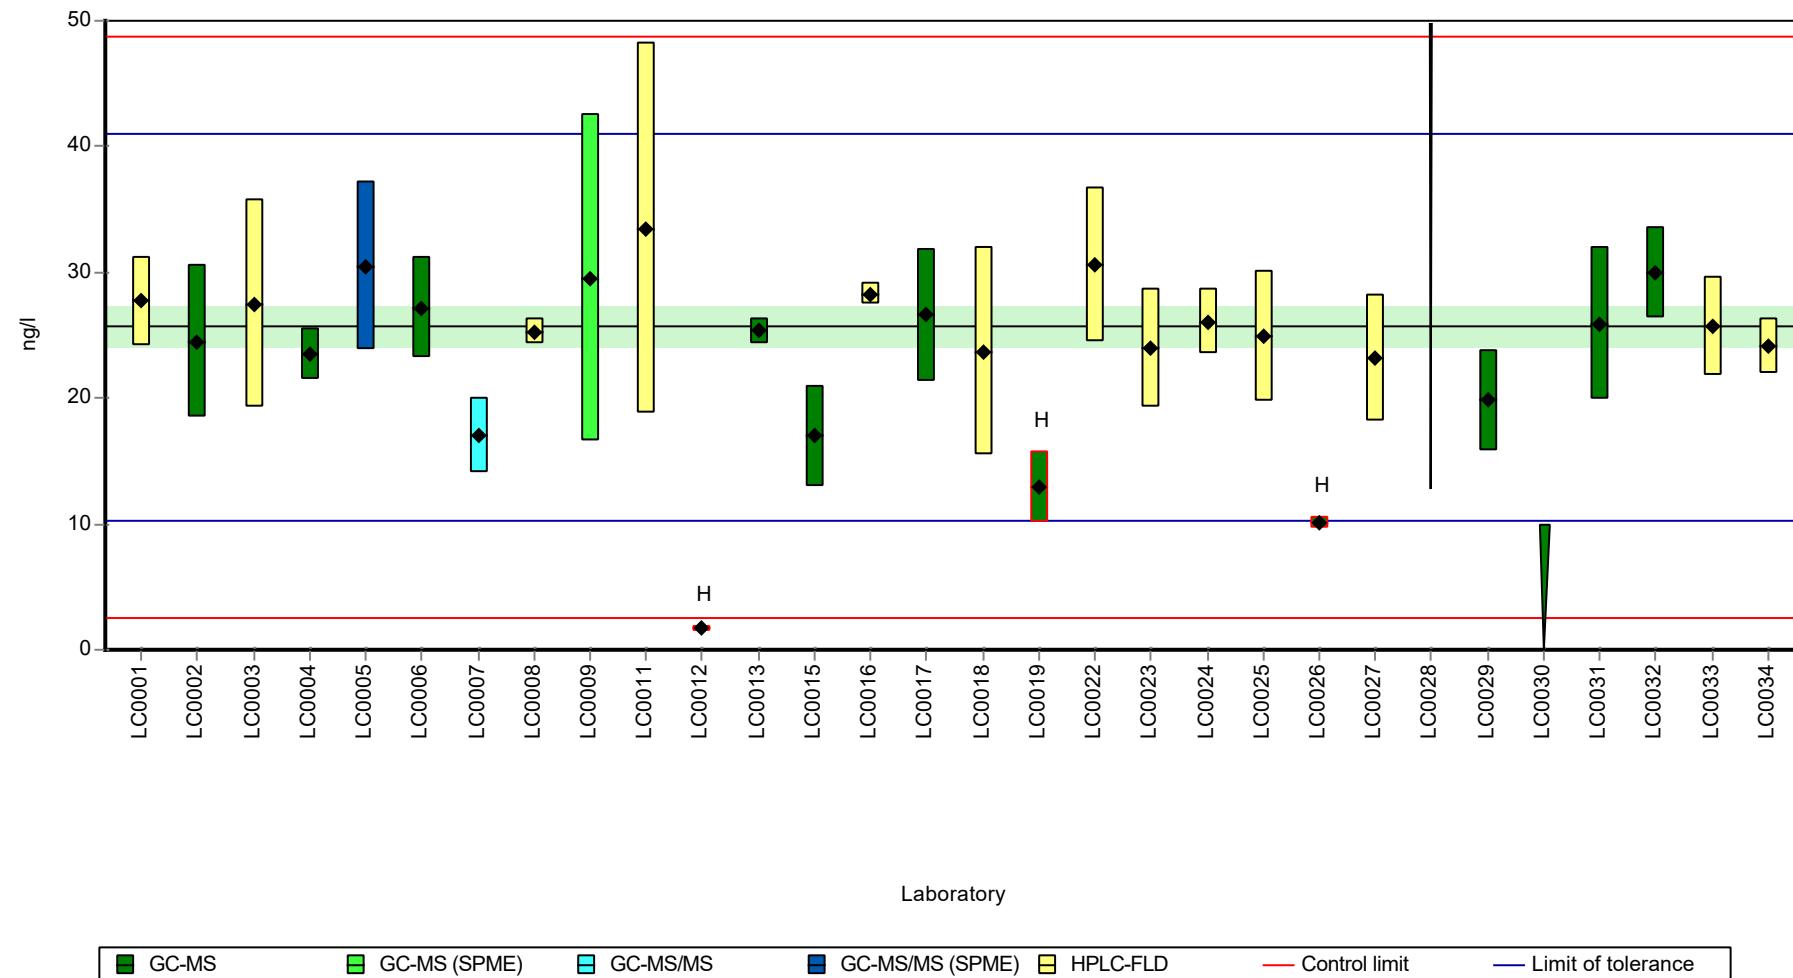


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

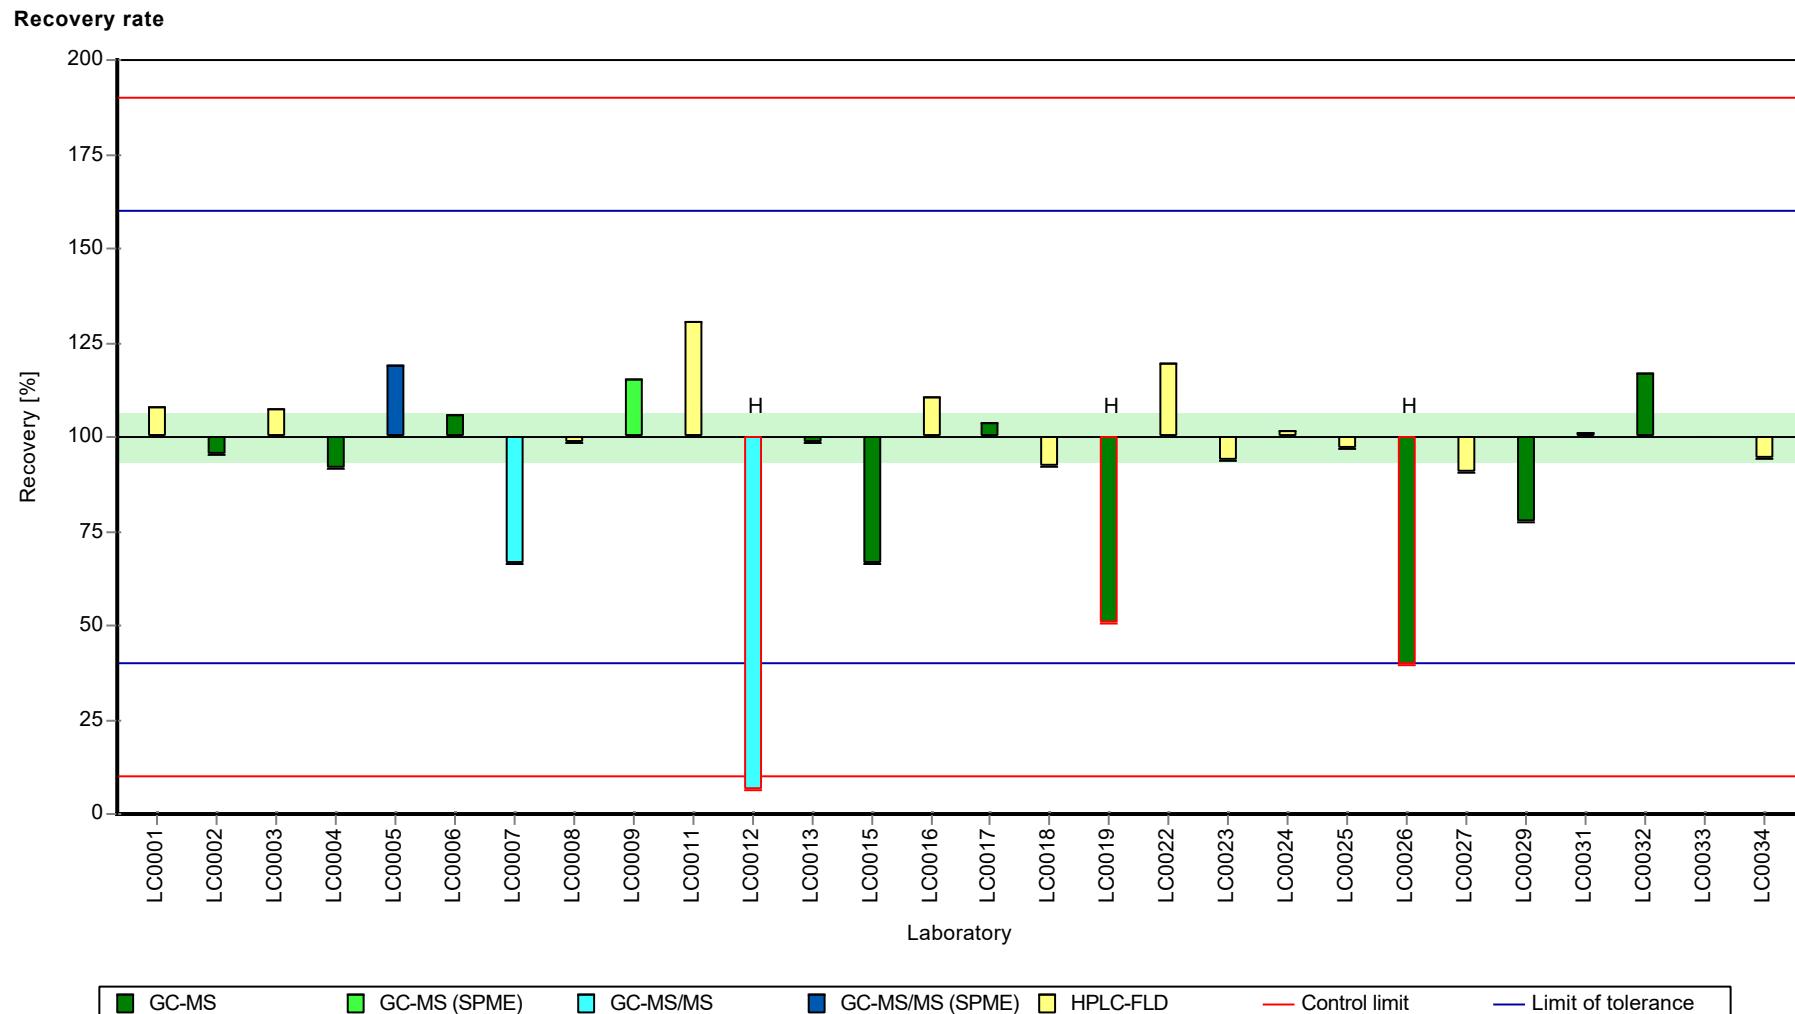

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

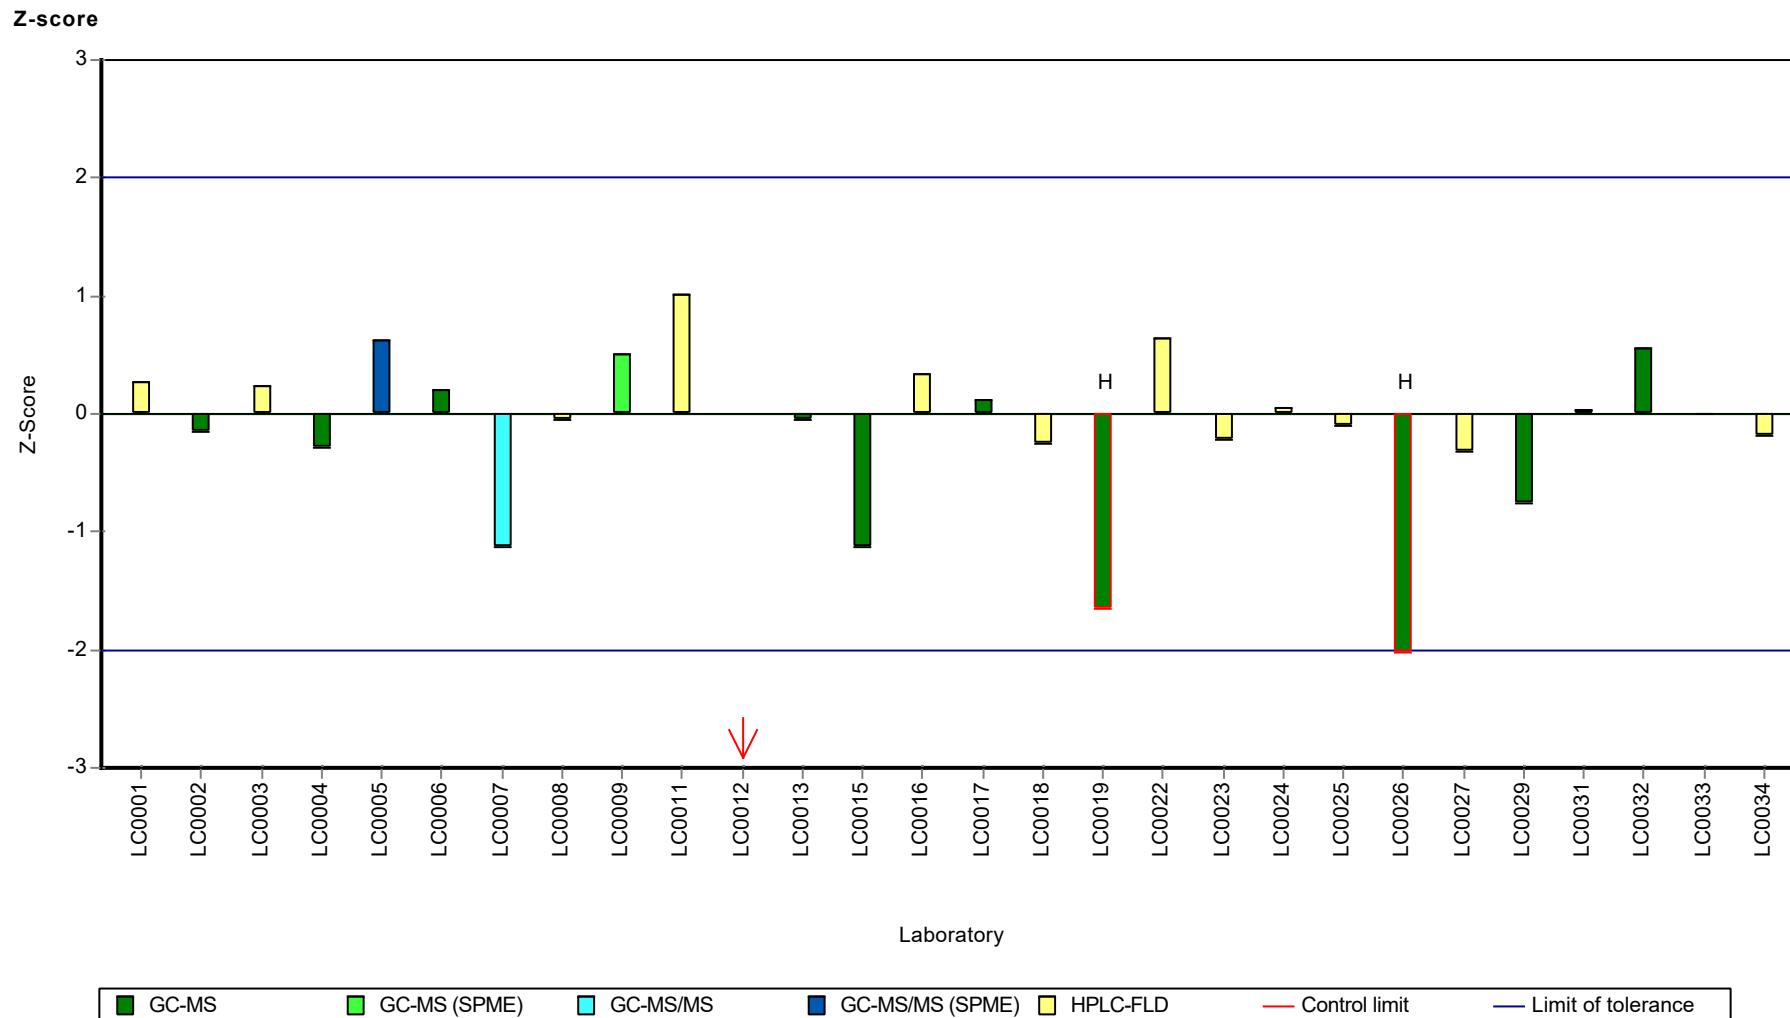

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

Parameter oriented report

P24 B

Dibenzo[a,h]anthracene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 131 ± 19.2
 Criterion 39.2 (30 %)
 Minimum - Maximum 3.19 - 239
 Control test value ± U (k=2) 180.0 ± 63.1

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	175	23	134	1.13	
LC0002	145	36	111	0.37	
LC0003	96.3	28.9	73.8	-0.87	
LC0004	182.96	18	140	1.34	
LC0005	165	36	126	0.88	
LC0006	123.76	18.564	94.8	-0.17	
LC0007	94	19	72	-0.93	
LC0008	239	40	183	2.77	
LC0009	170.7	75.1	131	1.02	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	159.32	70.102	122	0.73	
LC0012	3.1903	0.15	2.4	-3.25	
LC0013	152	1.47	116	0.55	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	116	28	88.8	-0.37	
LC0016	162	3.58	124	0.8	
LC0017	149.1	29.8	114	0.47	
LC0018	105	36.8	80.4	-0.65	
LC0019	93.22	20.51	71.4	-0.95	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	196	39.2	150	1.67	
LC0023	113.2	11.3	86.7	-0.44	
LC0024	167	16.7	128	0.93	
LC0025	87.4	18.35	66.9	-1.1	
LC0026	57.5	21.8	44	-1.87	
LC0027	129	28	98.8	-0.04	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	116	23	88.8	-0.37	
LC0030	11.5	2.3	8.8	-3.04	
LC0031	112	26	85.8	-0.47	
LC0032	174.04	20.8	133	1.11	
LC0033	115.8	17.8	88.7	-0.38	
LC0034	175.7	16.08	135	1.15	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	131 ± 28.9	131 ± 28.9 ng/l
Minimum	3.19	3.19 ng/l
Maximum	239	239 ng/l
Standard deviation	51.8	51.8 ng/l
rel. standard deviation	39.7	39.7 %
n	29	29 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene


Graphical presentation of results

Results

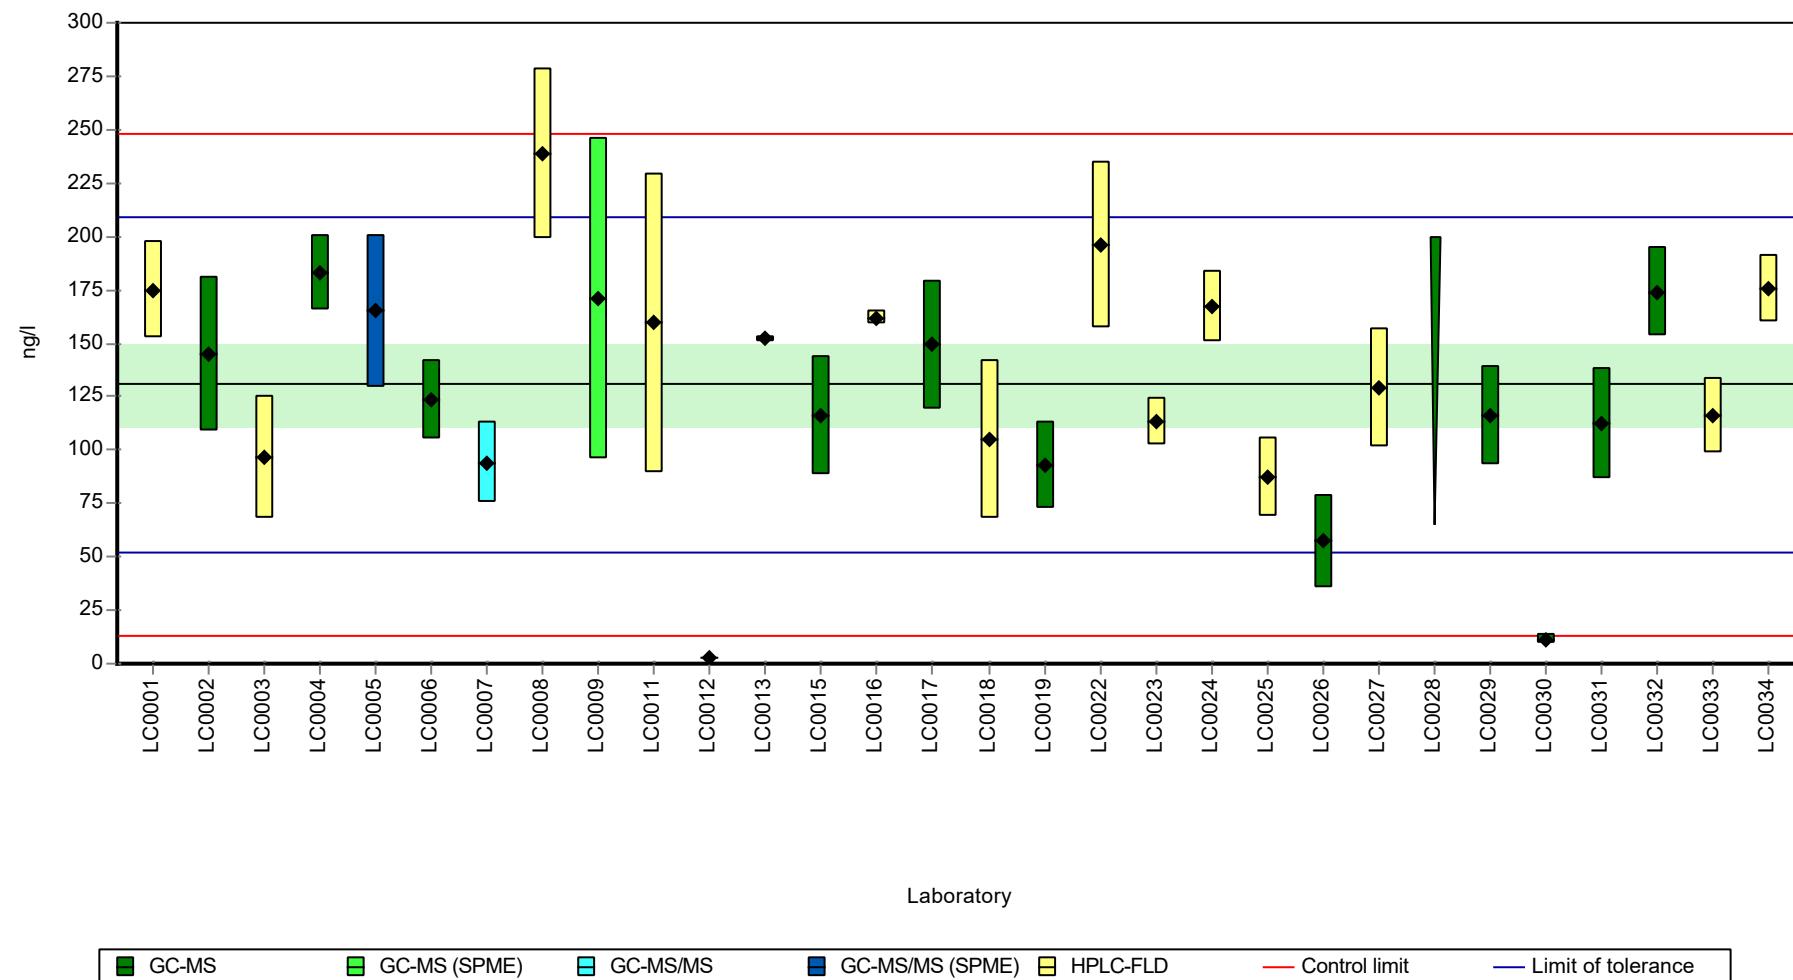


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

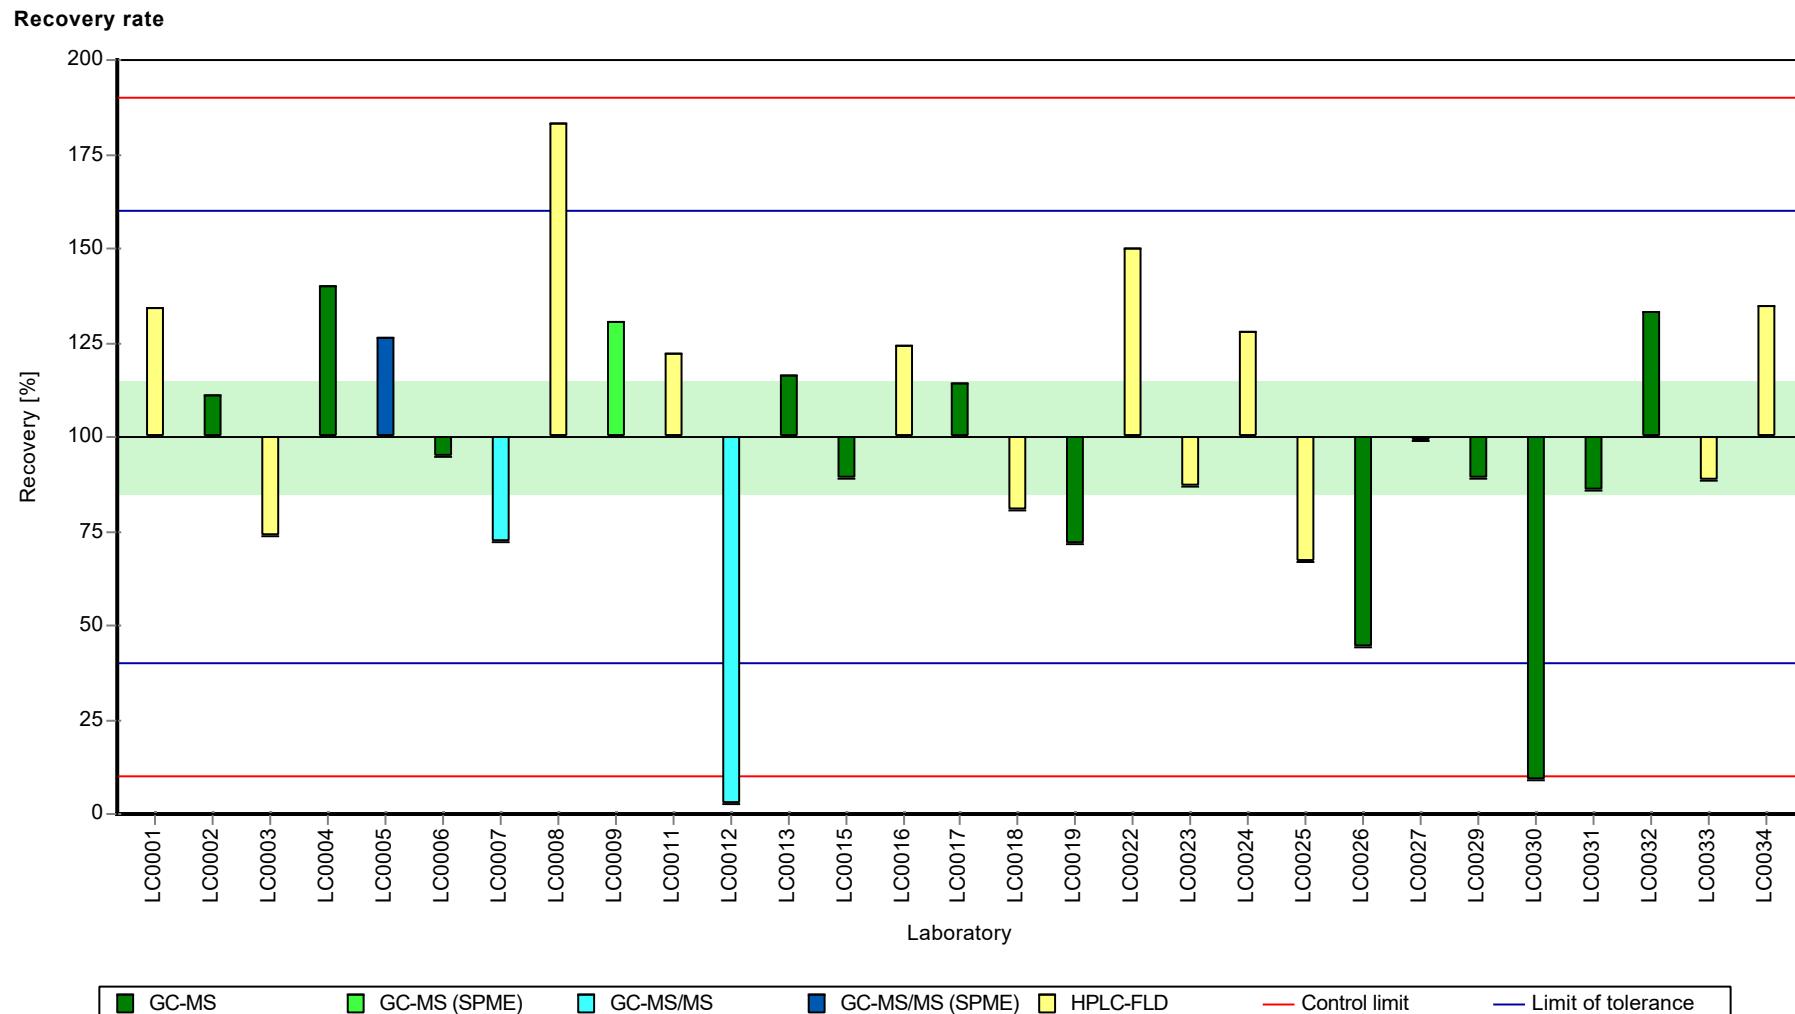

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Dibenzo[a,h]anthracene

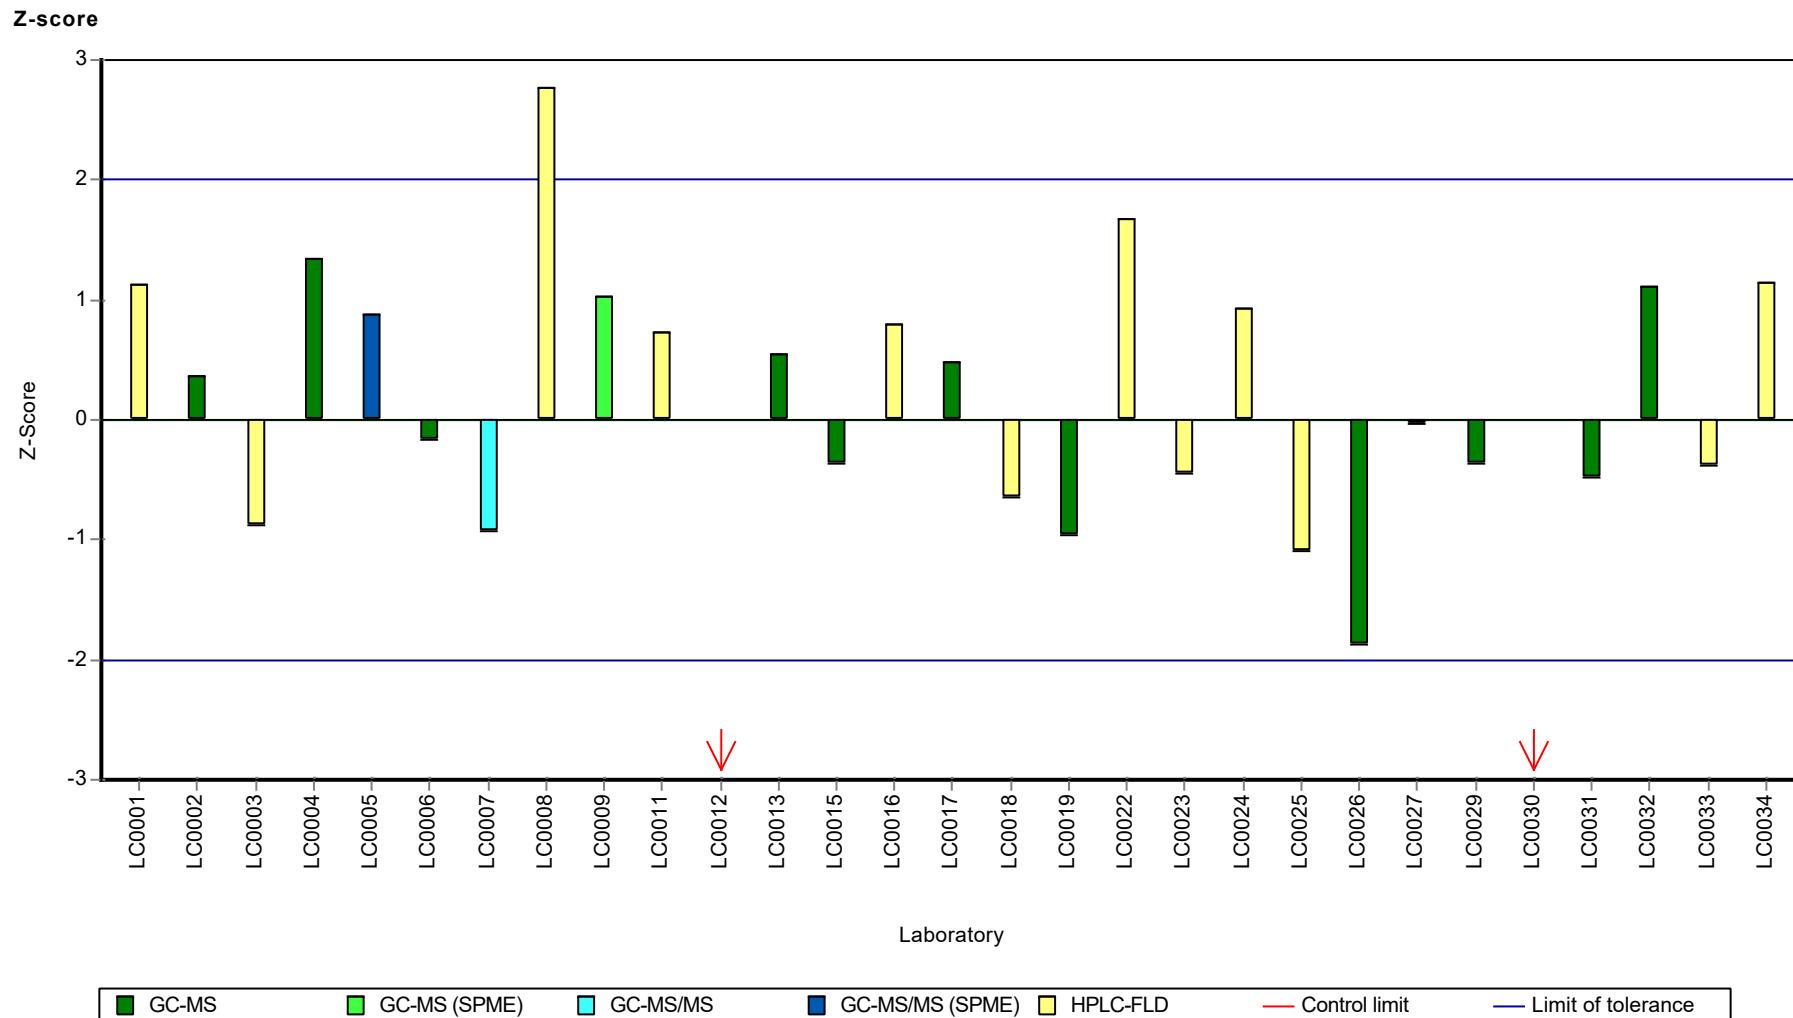

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Fluoranthene

Parameter oriented report

P24A

Fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 27.2 ± 1.49
 Criterion 4.9 (18 %)
 Minimum - Maximum 20.2 - 32.9
 Control test value ± U (k=2) 32.0 ± 8

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	29.6	3.8	109	0.48	
LC0002	26	5.2	95.5	-0.25	
LC0003	32.2	9.66	118	1.01	
LC0004	31.65	3	116	0.9	
LC0005	25.4	5.6	93.3	-0.37	
LC0006	31.25	4.688	115	0.82	
LC0007	27	5	99.1	-0.05	
LC0008	27.8	0.49	102	0.12	
LC0009	25.29	11.13	92.9	-0.4	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	47.15	20.744	173	4.06	H
LC0012	59.59	3.21	219	6.6	H
LC0013	28.81	1.06	106	0.32	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	24	6	88.1	-0.66	
LC0016	28.3	1.21	104	0.22	
LC0017	30.4	6.1	112	0.65	
LC0018	24.1	8.44	88.5	-0.64	
LC0019	8.11	1.78	29.8	-3.9	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	32.9	5	121	1.16	
LC0023	31.5	6.7	116	0.87	
LC0024	27.8	2.8	102	0.12	
LC0025	26.9	5.65	98.8	-0.07	
LC0026	22.5	2.2	82.6	-0.97	
LC0027	22.3	4.9	81.9	-1.01	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	20.2	4	74.2	-1.43	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	28.8	4	106	0.32	
LC0032	28.4	2.53	104	0.24	
LC0033	66.1	4.6	243	7.93	H
LC0034	20.5	1.54	75.3	-1.37	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Fluoranthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	29.8 ± 6.4	27.2 ± 2.23 ng/l
Minimum	8.11	20.2 ng/l
Maximum	66.1	32.9 ng/l
Standard deviation	11.3	3.64 ng/l
rel. standard deviation	37.9	13.4 %
n	28	24 -


Graphical presentation of results

Results

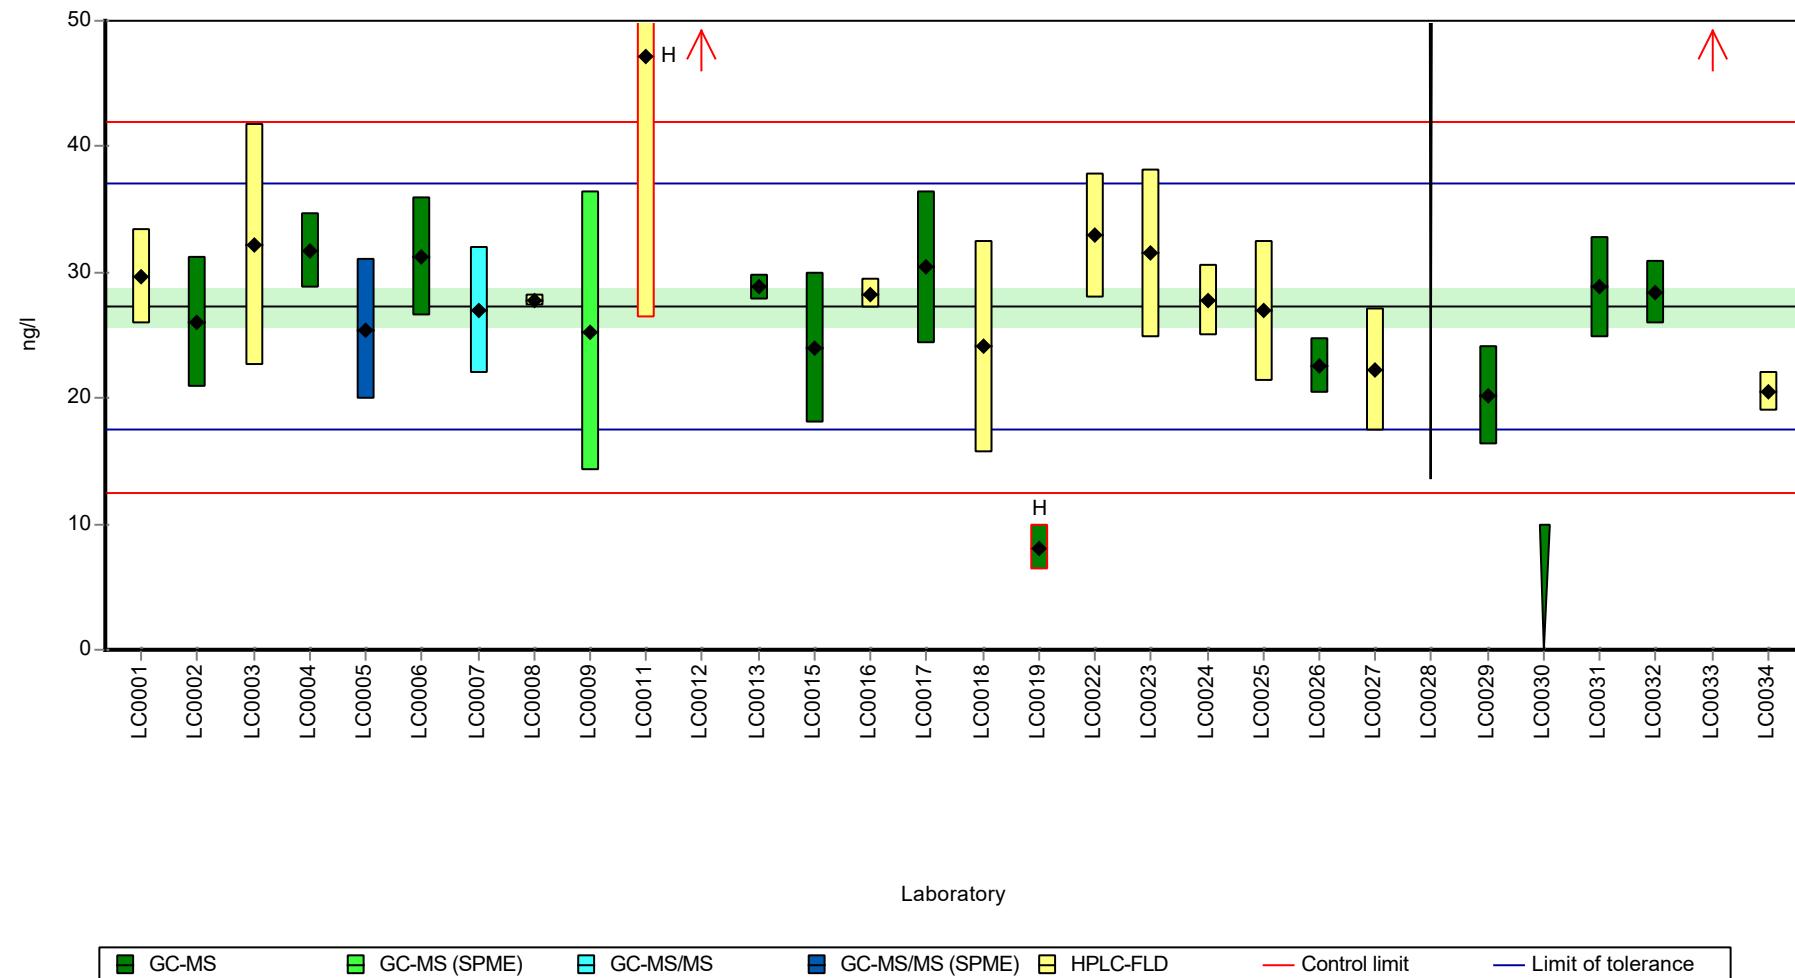


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Fluoranthene

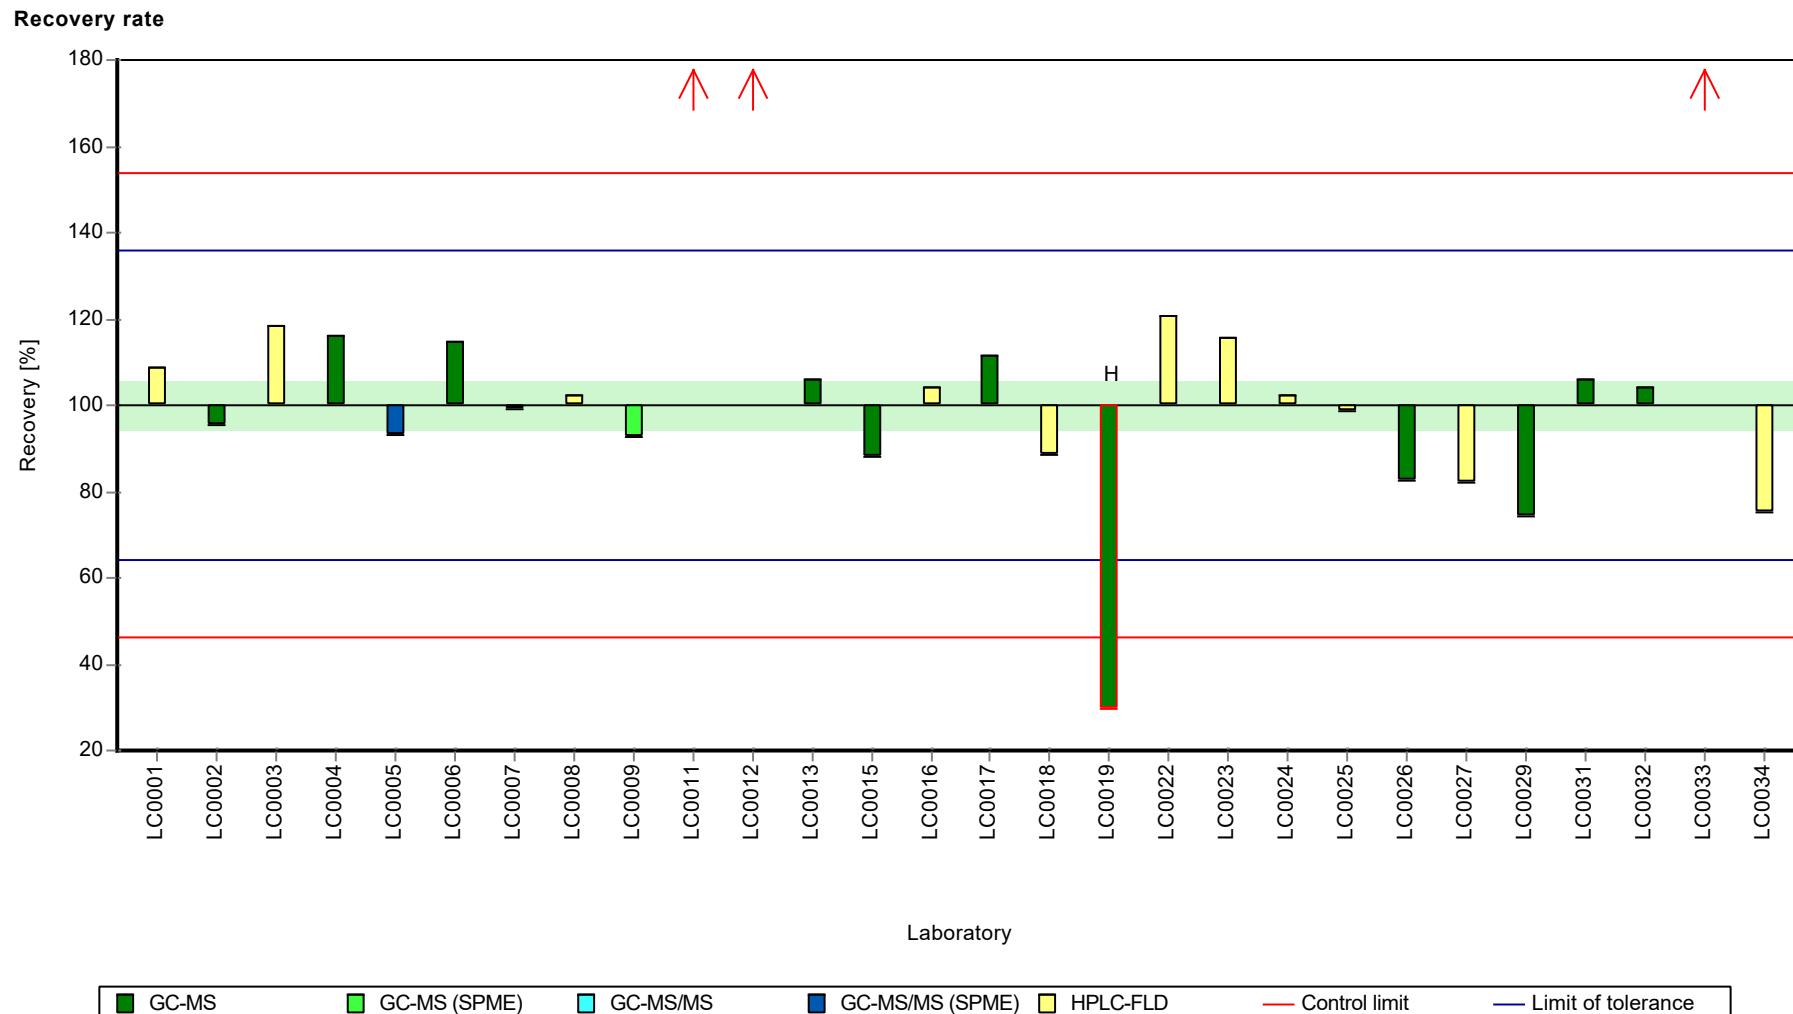

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Fluoranthene

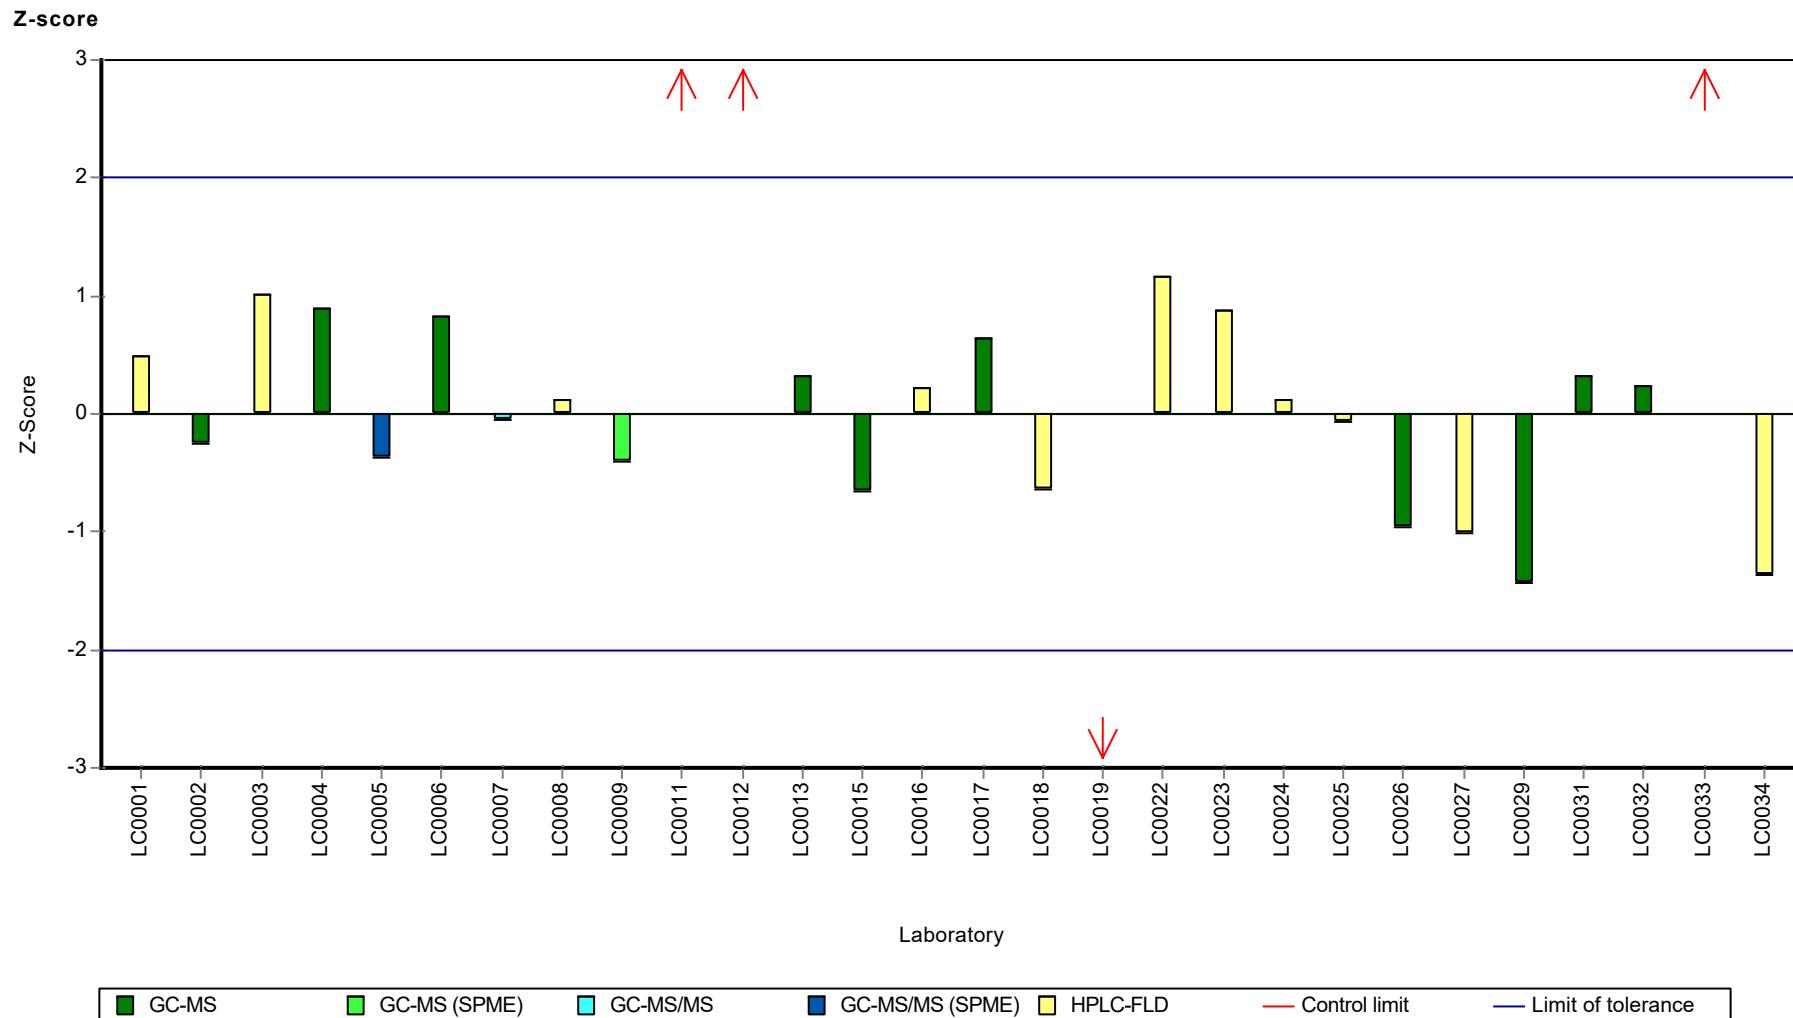

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Fluoranthene

Parameter oriented report

P24 B

Fluoranthene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 180 ± 8.62
 Criterion 32.3 (18 %)
 Minimum - Maximum 136 - 213
 Control test value ± U (k=2) 213.0 ± 53.3

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	194	25	108	0.44	
LC0002	176	35	98	-0.11	
LC0003	189	56.7	105	0.29	
LC0004	212.75	21	118	1.02	
LC0005	185	41	103	0.17	
LC0006	175.33	26.3	97.6	-0.13	
LC0007	177	35	98.5	-0.08	
LC0008	363	9.2	202	5.67	H
LC0009	178.5	78.5	99.4	-0.04	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	195.77	86.14	109	0.5	
LC0012	457.401	3.21	255	8.59	H
LC0013	181.4	4.04	101	0.05	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	183	44	102	0.1	
LC0016	194	5	108	0.44	
LC0017	182.5	36.5	102	0.09	
LC0018	178	62.3	99.1	-0.05	
LC0019	139.2	30.62	77.5	-1.25	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	205	30.8	114	0.78	
LC0023	135.7	13.9	75.5	-1.36	
LC0024	200.6	20.1	112	0.65	
LC0025	208.6	43.81	116	0.9	
LC0026	297	47.5	165	3.63	H
LC0027	150	33	83.5	-0.92	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	161	32	89.6	-0.58	
LC0030	21.5	4.3	12	-4.89	H
LC0031	196	27	109	0.51	
LC0032	194.29	17.29	108	0.45	
LC0033	157.2	11	87.5	-0.69	
LC0034	141	10.62	78.5	-1.19	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Fluoranthene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	194 ± 41.4	180 ± 12.9 ng/l
Minimum	21.5	136 ng/l
Maximum	457	213 ng/l
Standard deviation	74.3	21.5 ng/l
rel. standard deviation	38.3	12 %
n	29	25 -


Graphical presentation of results

Results

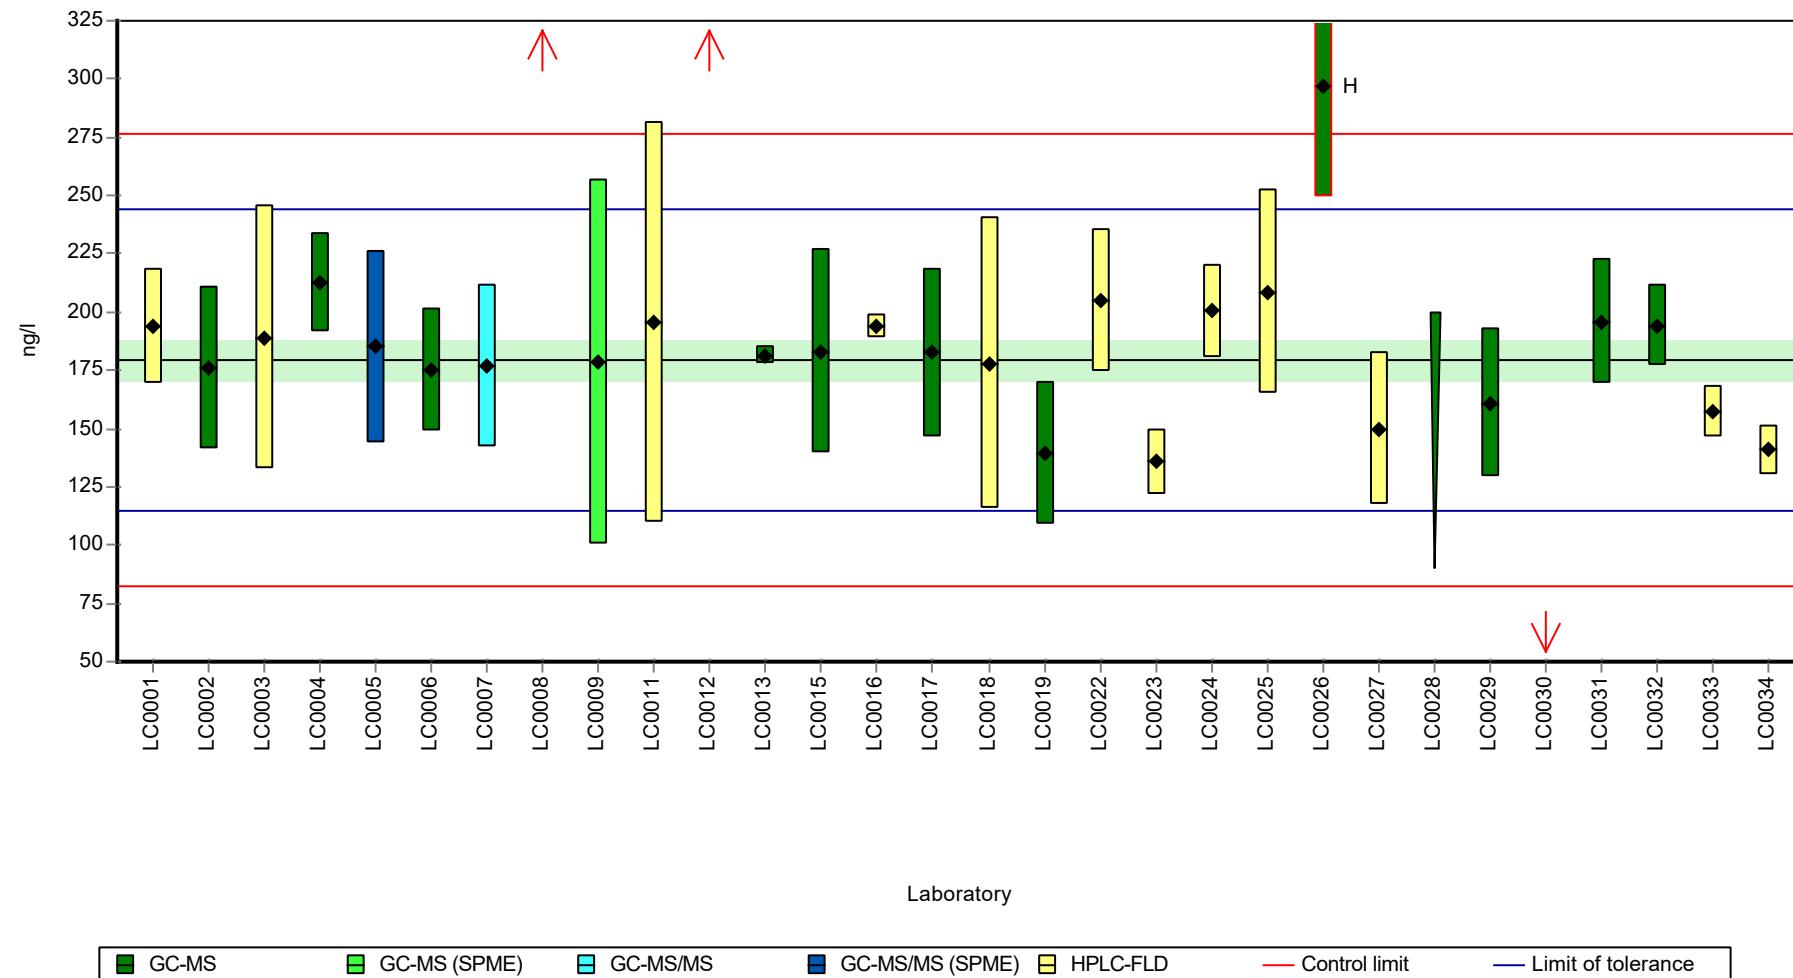


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Fluoranthene

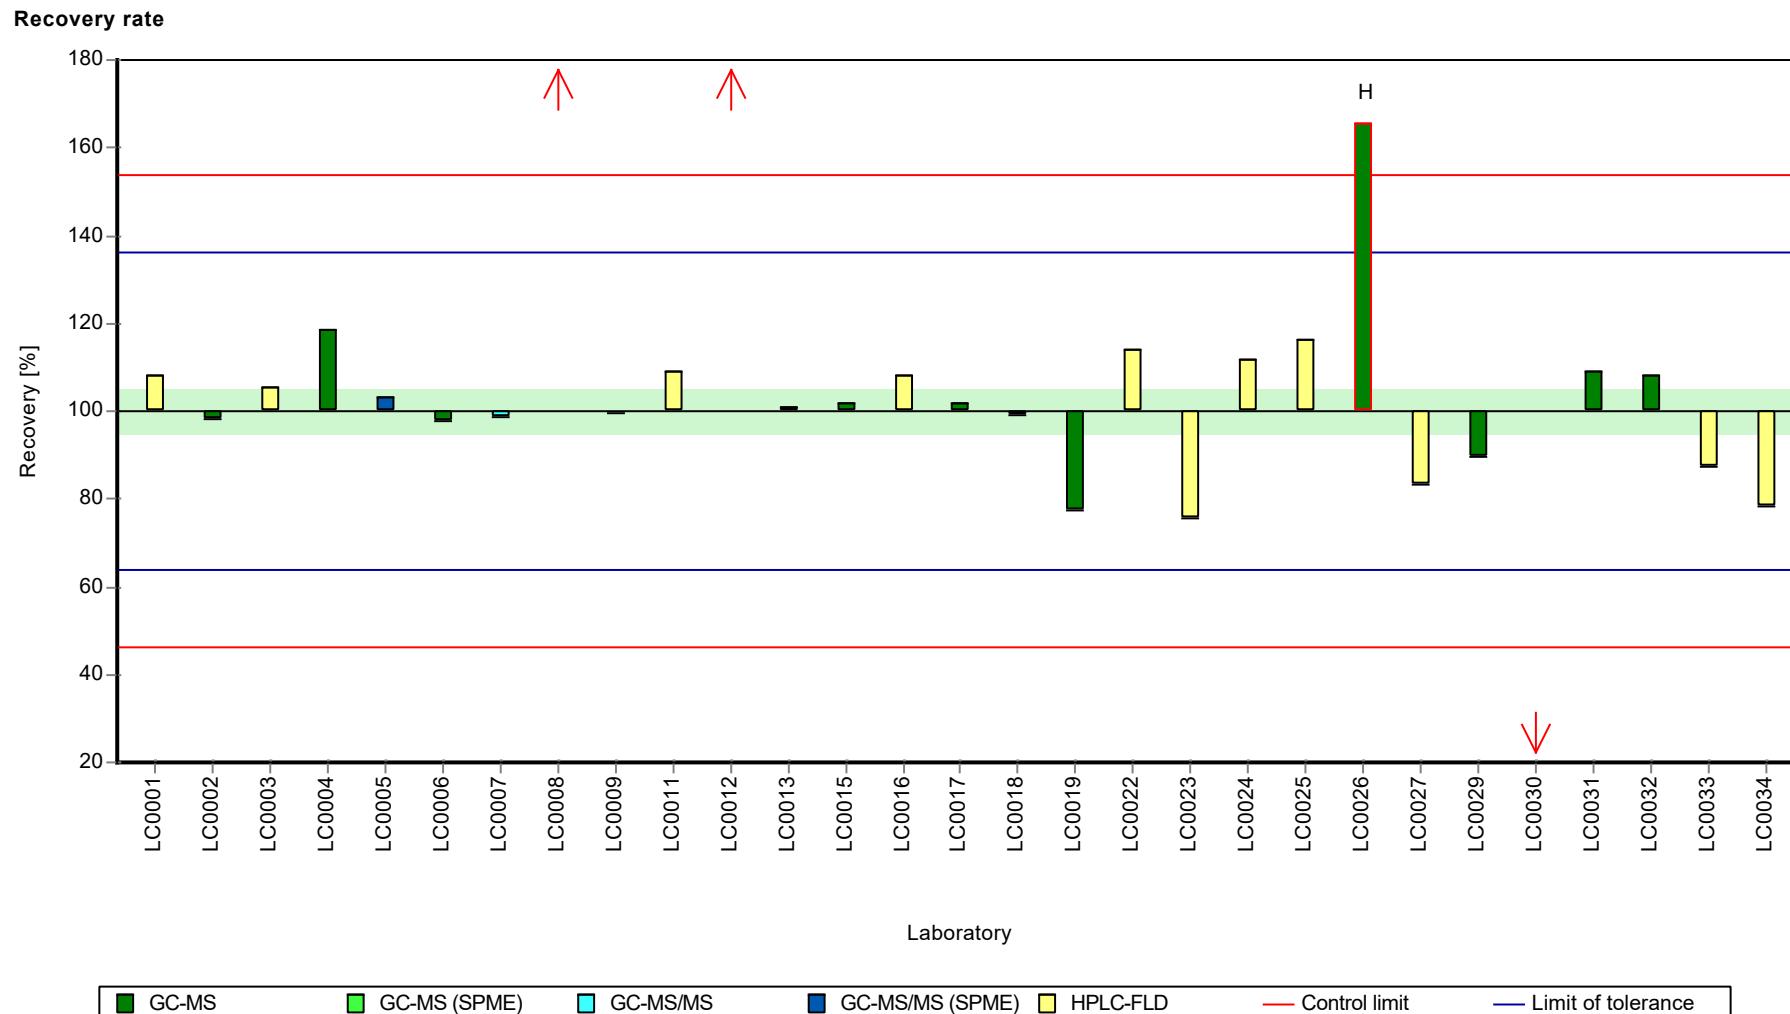

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Fluoranthene

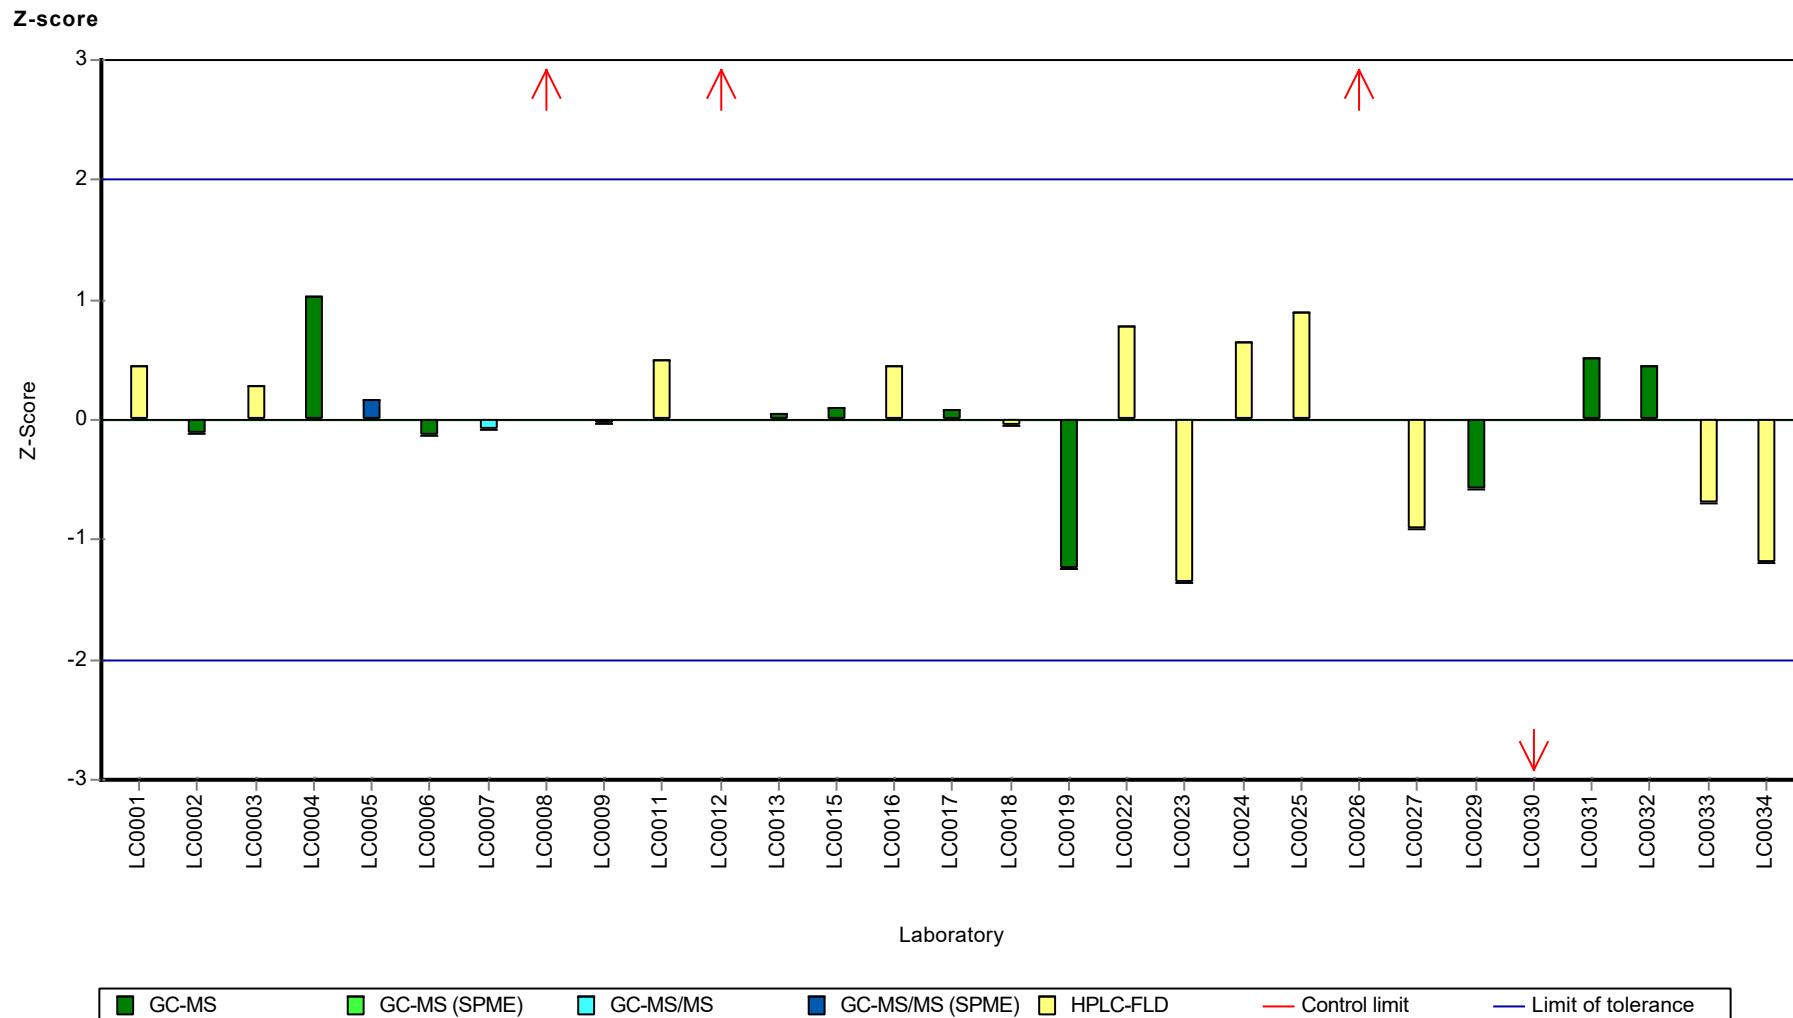

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Fluorene

Parameter oriented report

P24A

Fluorene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 27.4 ± 1.24
 Criterion 3.83 (14 %)
 Minimum - Maximum 19 - 32.2
 Control test value ± U (k=2) 32.6 ± 11.4

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	25.9	3.4	94.6	-0.38	
LC0002	27.2	5.4	99.4	-0.04	
LC0003	29.4	8.81	107	0.53	
LC0004	28.86	3	105	0.39	
LC0005	26.6	5.9	97.2	-0.2	
LC0006	32.22	4.833	118	1.27	
LC0007	19	4	69.4	-2.18	
LC0008	26.7	0.73	97.6	-0.17	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	30.75	13.529	112	0.88	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	26.99	0.49	98.6	-0.1	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	27	7	98.7	-0.1	
LC0016	27.5	1.42	100	0.03	
LC0017	29.5	5.9	108	0.56	
LC0018	25.5	8.93	93.2	-0.49	
LC0019	1.97	0.43	7.2	-6.63	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	31.2	6.2	114	1	
LC0023	23.12	5.7	84.5	-1.11	
LC0024	28.5	2.9	104	0.3	
LC0025	26.7	5.61	97.6	-0.17	
LC0026	30.9	1.43	113	0.92	
LC0027	24.3	5.4	88.8	-0.8	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	24.6	4.9	89.9	-0.72	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	30.6	4	112	0.84	
LC0032	29.46	2.505	108	0.55	
LC0033	54	7.4	197	6.95	H
LC0034	24.3	1.53	88.8	-0.8	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Fluorene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	27.4 ± 4.66	27.4 ± 1.86 ng/l
Minimum	1.97	19 ng/l
Maximum	54	32.2 ng/l
Standard deviation	7.91	3.03 ng/l
rel. standard deviation	28.9	11.1 %
n	26	24 -


Graphical presentation of results

Results

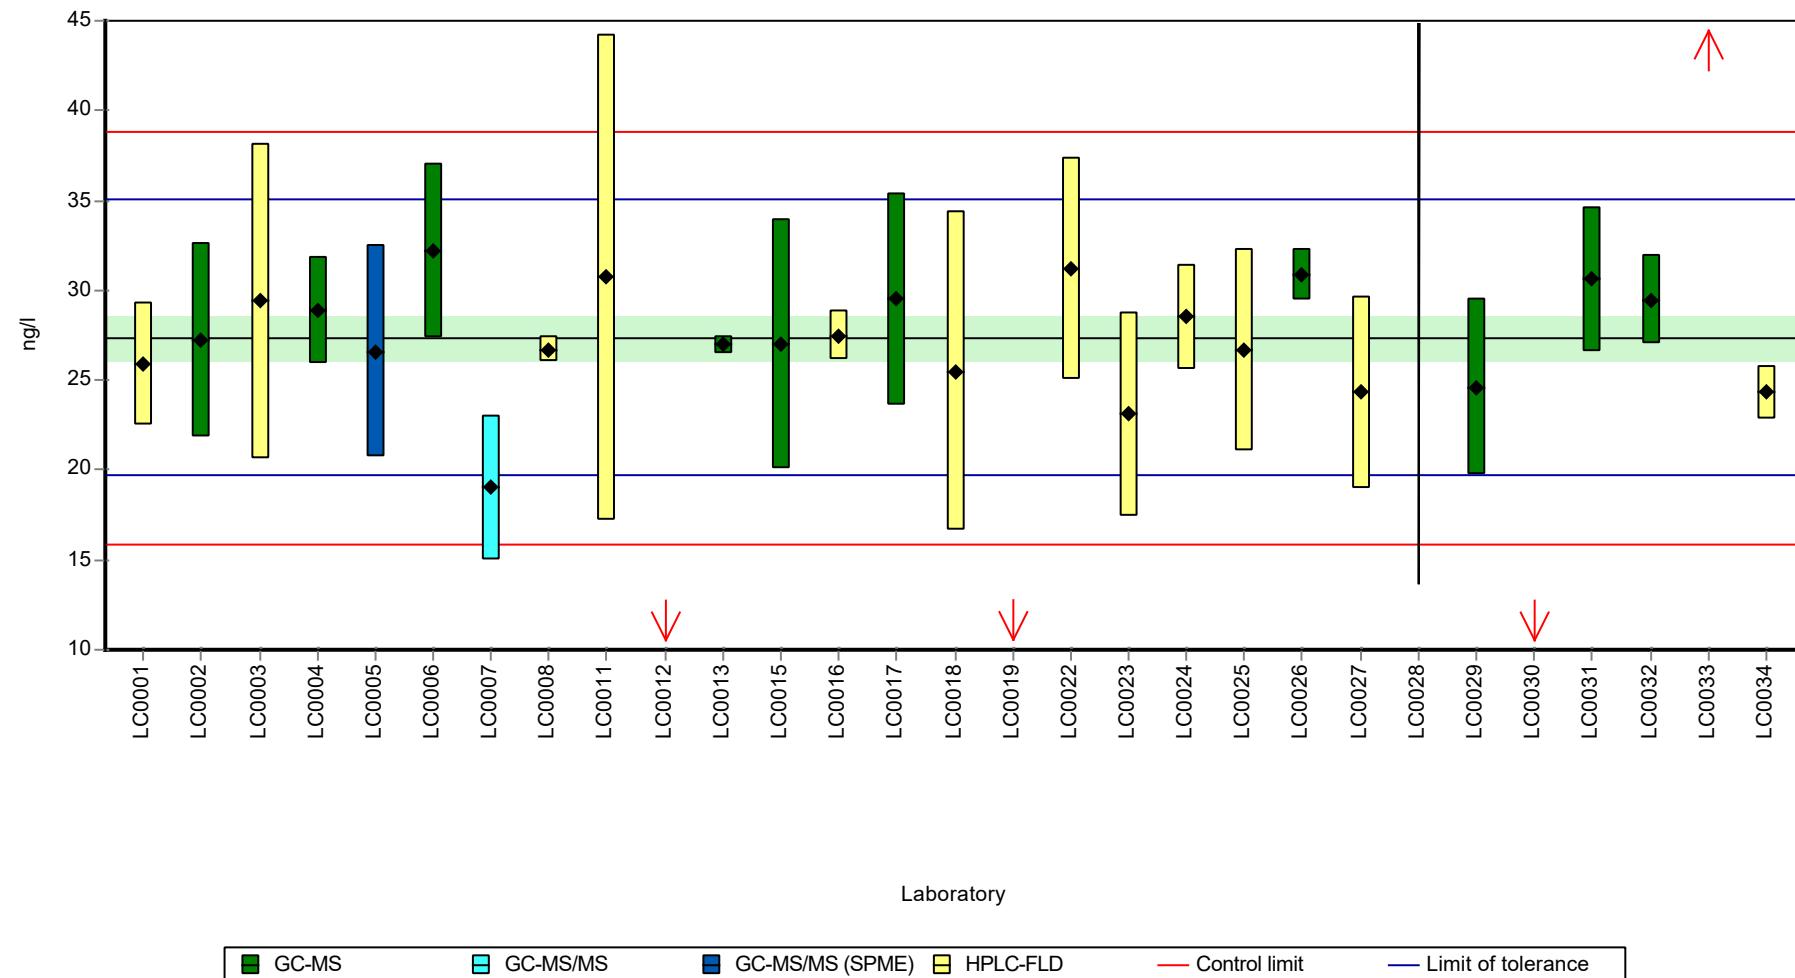


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Fluorene

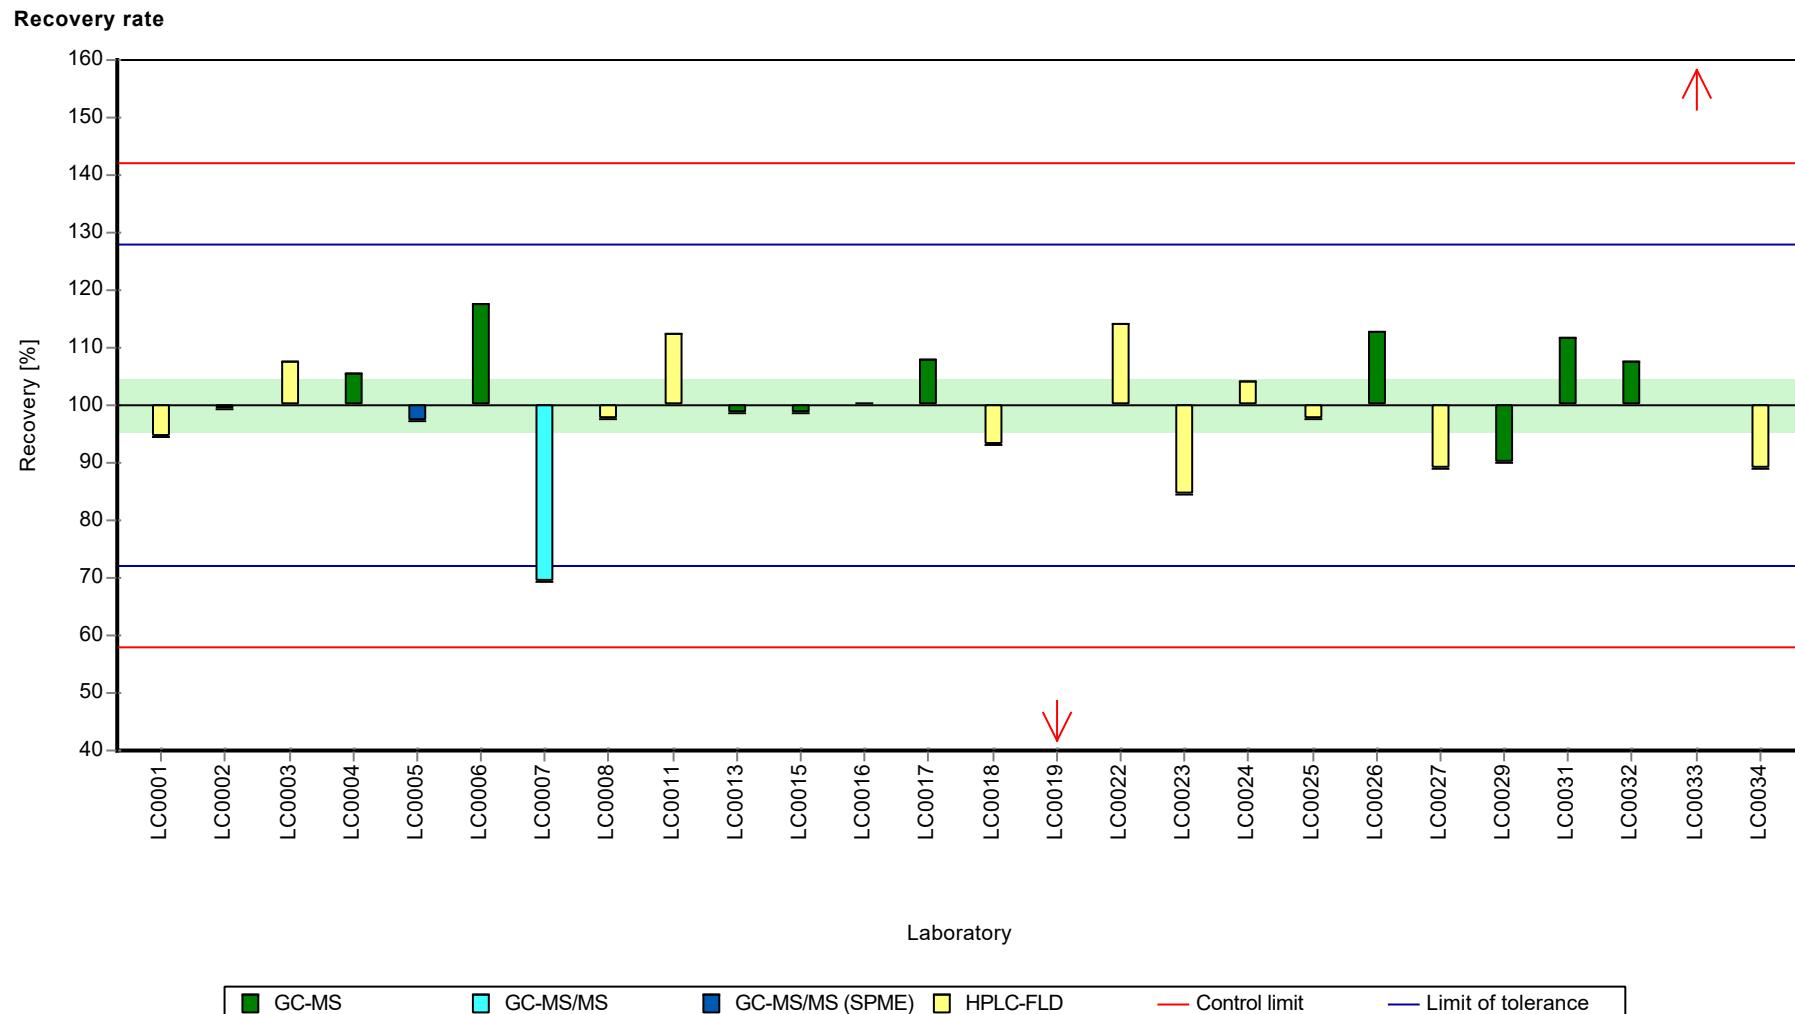

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Fluorene

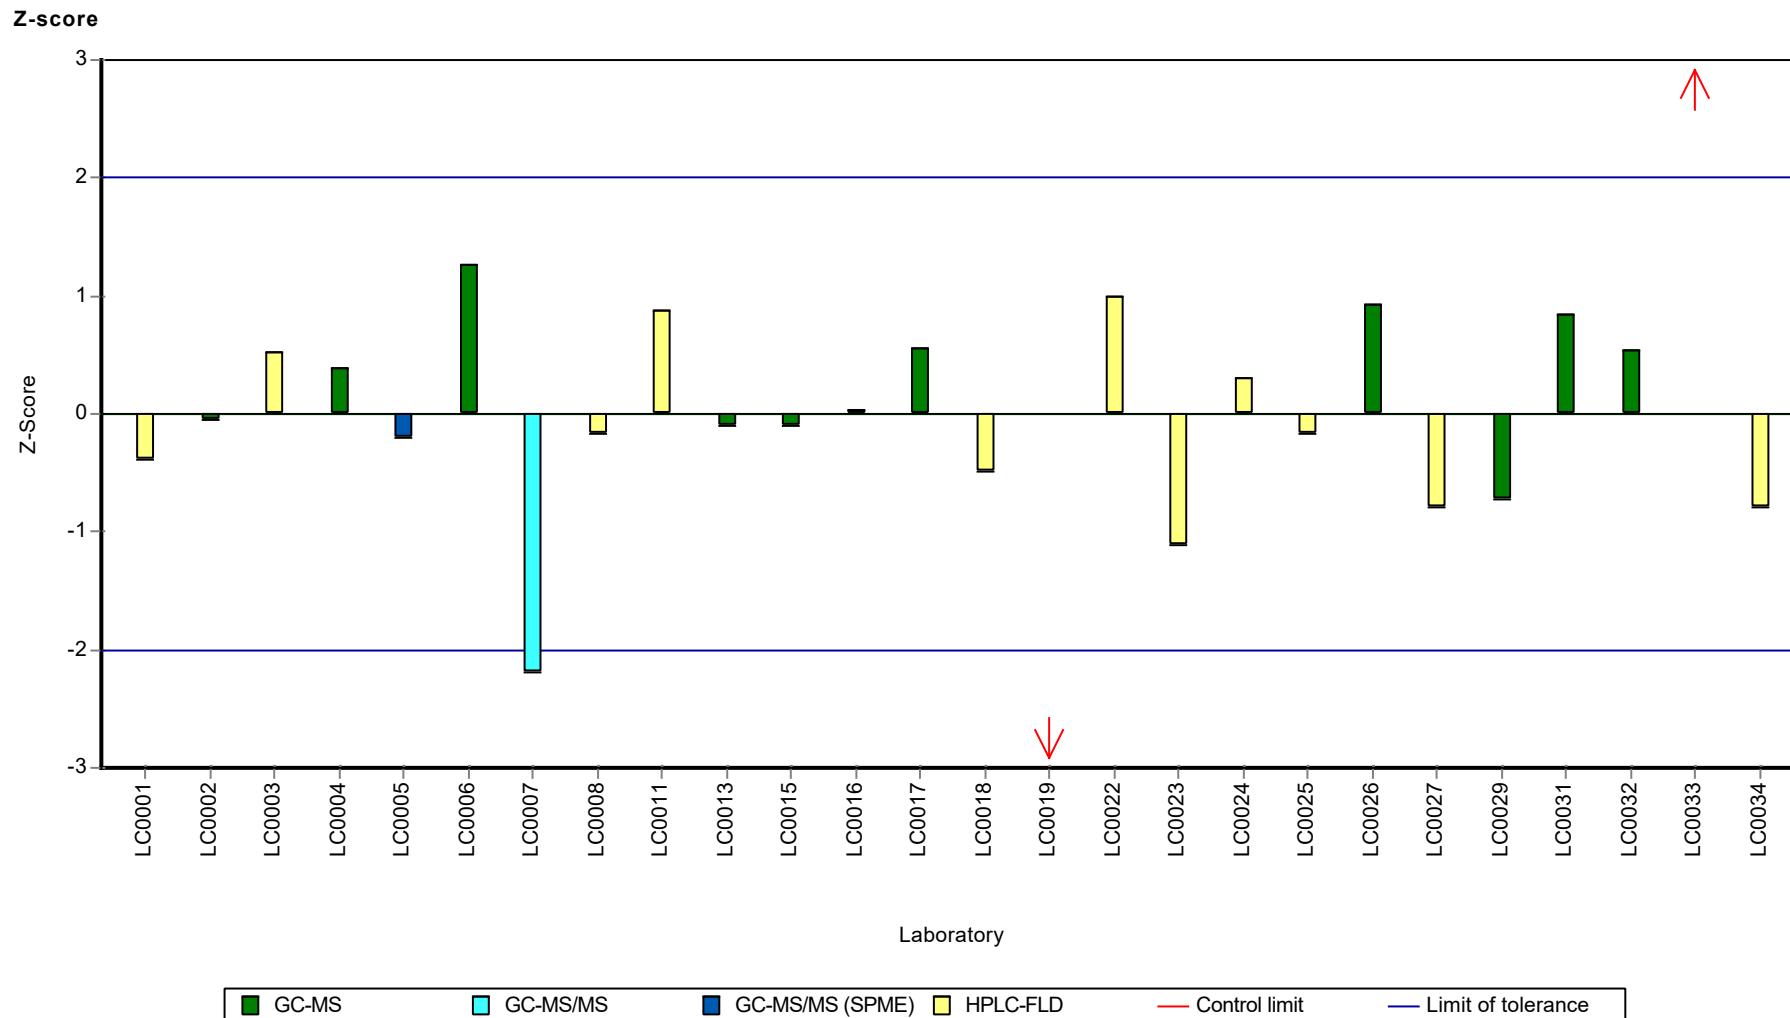

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Fluorene

Parameter oriented report

P24 B

Fluorene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 131 \pm 7.6
 Criterion 18.3 (14 %)
 Minimum - Maximum 83.3 - 172
 Control test value \pm U (k=2) 151.0 \pm 52.8

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	135	18	103	0.23	
LC0002	119	24	91	-0.64	
LC0003	131	39.2	100	0.01	
LC0004	141.26	14	108	0.57	
LC0005	130	29	99.4	-0.04	
LC0006	125.73	18.86	96.1	-0.28	
LC0007	140	28	107	0.5	
LC0008	239	8.9	183	5.91	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	157.42	69.265	120	1.45	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	119	2.2	91	-0.64	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	136	33	104	0.28	
LC0016	131	5.67	100	0.01	
LC0017	127.8	25.6	97.7	-0.16	
LC0018	118	41.3	90.2	-0.7	
LC0019	113.79	25.03	87	-0.93	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	140	28	107	0.5	
LC0023	83.25	12.9	63.6	-2.6	
LC0024	140.1	14	107	0.51	
LC0025	164.3	34.5	126	1.83	
LC0026	172	14.9	131	2.25	
LC0027	99.4	22	76	-1.71	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	144	29	110	0.72	
LC0030	13.5	2.7	10.3	-6.41	H
LC0031	139	18	106	0.45	
LC0032	132.31	11.245	101	0.08	
LC0033	115.4	15.8	88.2	-0.84	
LC0034	115.3	7.25	88.1	-0.85	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Fluorene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	130 ± 20.9	131 ± 11.4 ng/l
Minimum	13.5	83.3 ng/l
Maximum	239	172 ng/l
Standard deviation	36.2	19 ng/l
rel. standard deviation	27.8	14.5 %
n	27	25 -


Graphical presentation of results

Results

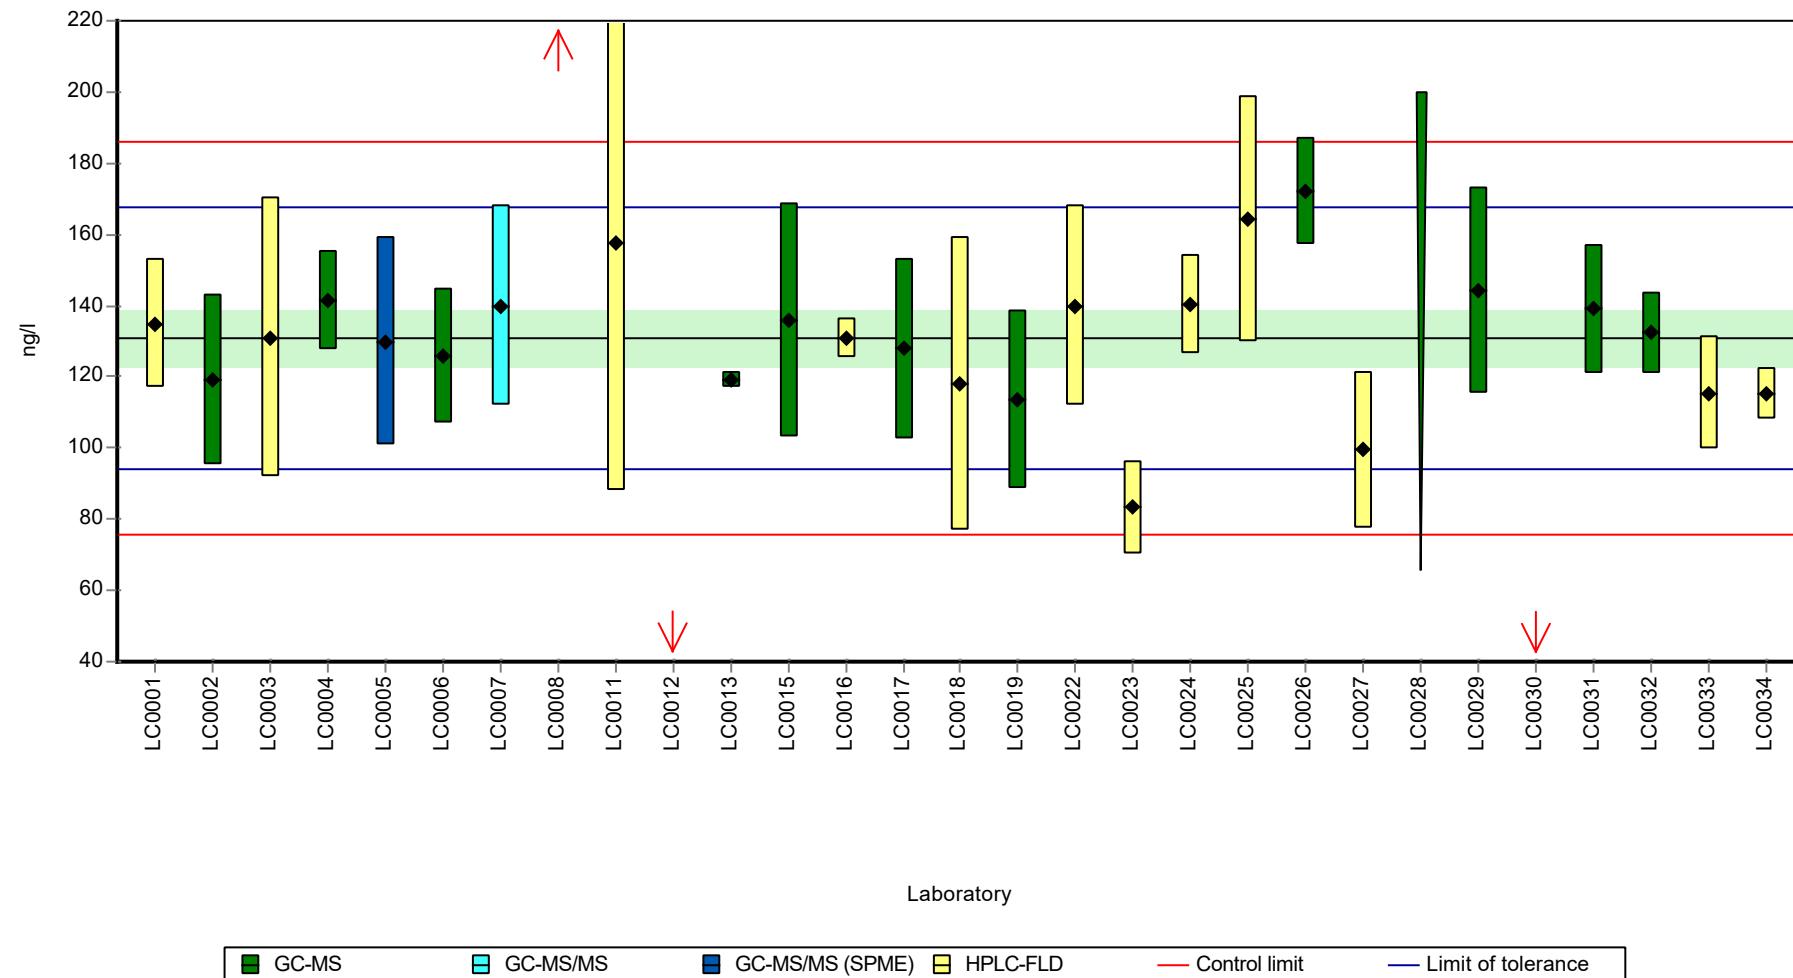


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Fluorene

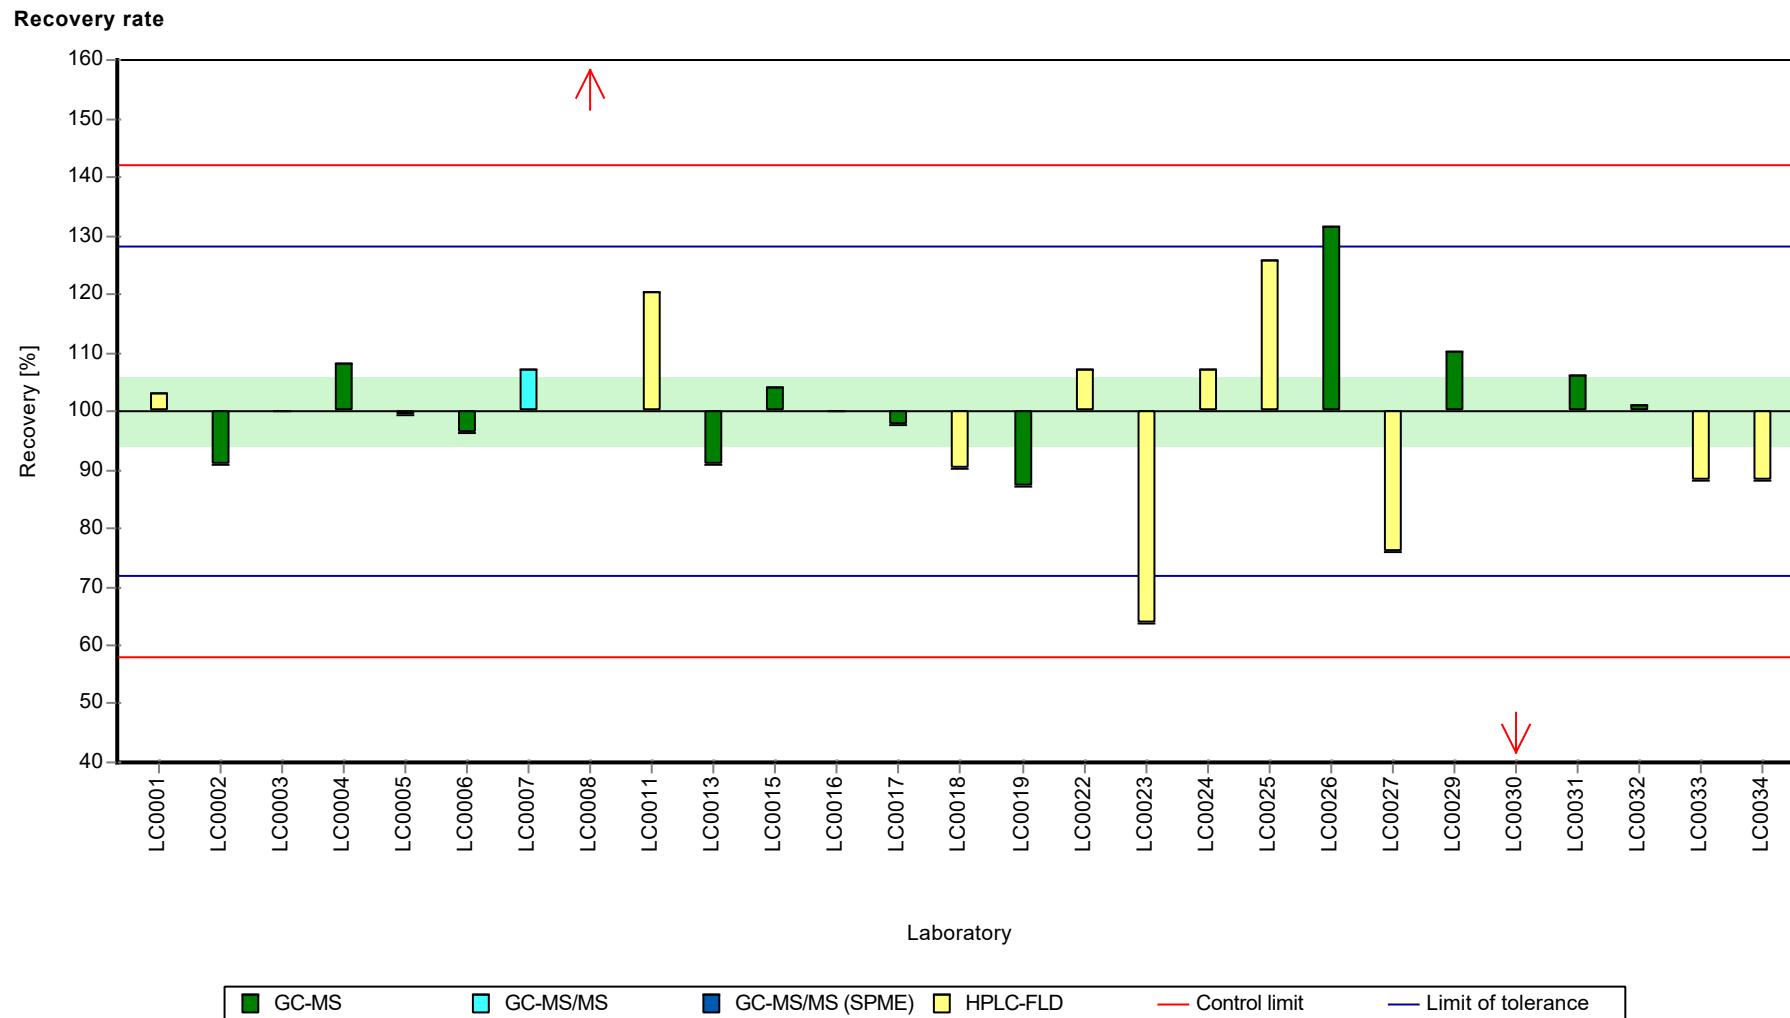

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Fluorene

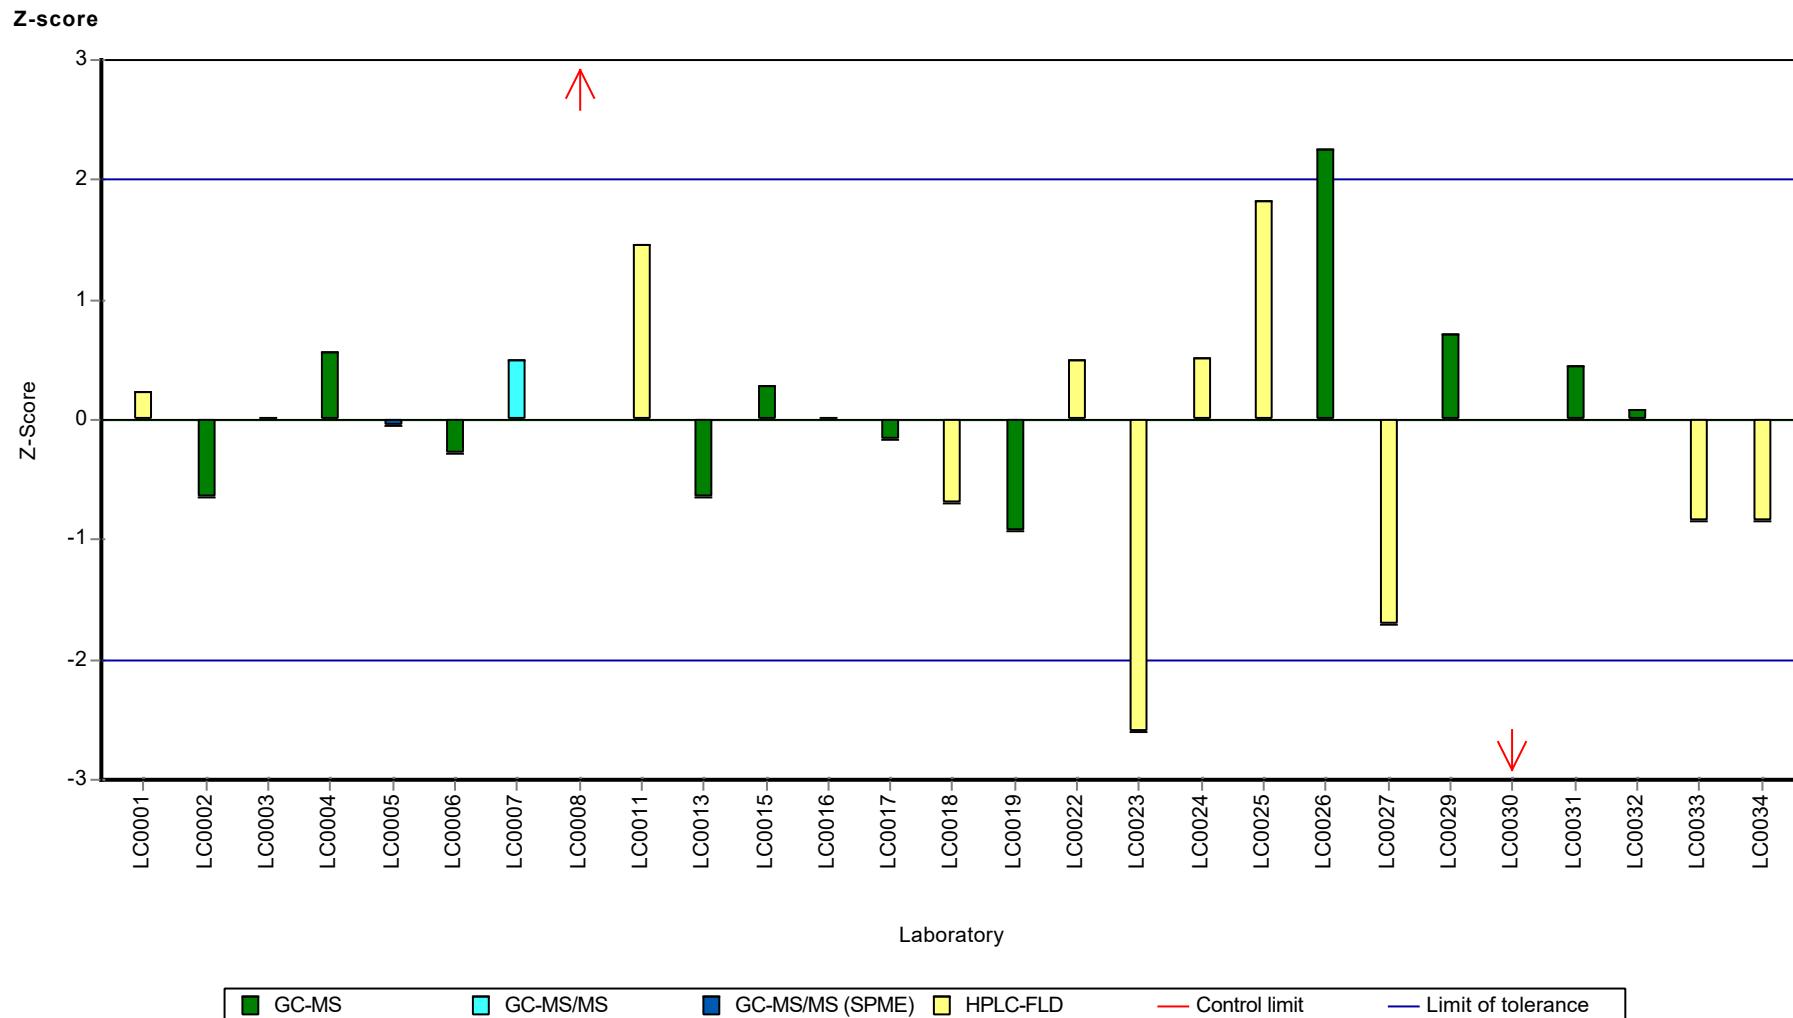

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Parameter oriented report

P24 A

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 21.2 ± 1.58
 Criterion 4.23 (20 %)
 Minimum - Maximum 9.6 - 30
 Control test value ± U (k=2) 27.3 ± 9.54

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	20	2.6	94.5	-0.27	
LC0002	24.4	6.1	115	0.77	
LC0003	19.1	5.72	90.3	-0.49	
LC0004	23.34	2.5	110	0.52	
LC0005	17.4	3.8	82.2	-0.89	
LC0006	24.2	3.63	114	0.72	
LC0007	14	3	66.2	-1.69	
LC0008	21.2	1.3	100	0.01	
LC0009	17.08	7.52	80.7	-0.96	
LC0010	26.4	5.93	125	1.24	
LC0011	30.02	13.21	142	2.09	
LC0012	1.57	0.29	7.4	-4.63	H
LC0013	21.13	0.42	99.9	-0.01	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	17	4	80.3	-0.98	
LC0016	24.4	1.05	115	0.77	
LC0017	24.6	4.9	116	0.81	
LC0018	20.5	7.18	96.9	-0.16	
LC0019	6.18	1.36	29.2	-3.54	H
LC0020	23.6	8.7	112	0.58	
LC0021	22.6	6.78	107	0.34	
LC0022	27.9	5.6	132	1.59	
LC0023	21.33	5.6	101	0.04	
LC0024	22.5	2.3	106	0.32	
LC0025	18	3.78	85.1	-0.75	
LC0026	9.6	0.45	45.4	-2.73	
LC0027	16.5	3.6	78	-1.1	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	18.3	3.7	86.5	-0.68	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	
LC0031	23.5	2.9	111	0.55	
LC0032	23.53	5.06	111	0.56	
LC0033	22.4	2.7	106	0.29	
LC0034	19.1	1.47	90.3	-0.49	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	20 ± 3.22	21.2 ± 2.36 ng/l
Minimum	1.57	9.6 ng/l
Maximum	30	30 ng/l
Standard deviation	5.98	4.24 ng/l
rel. standard deviation	29.8	20 %
n	31	29 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene


Graphical presentation of results

Results

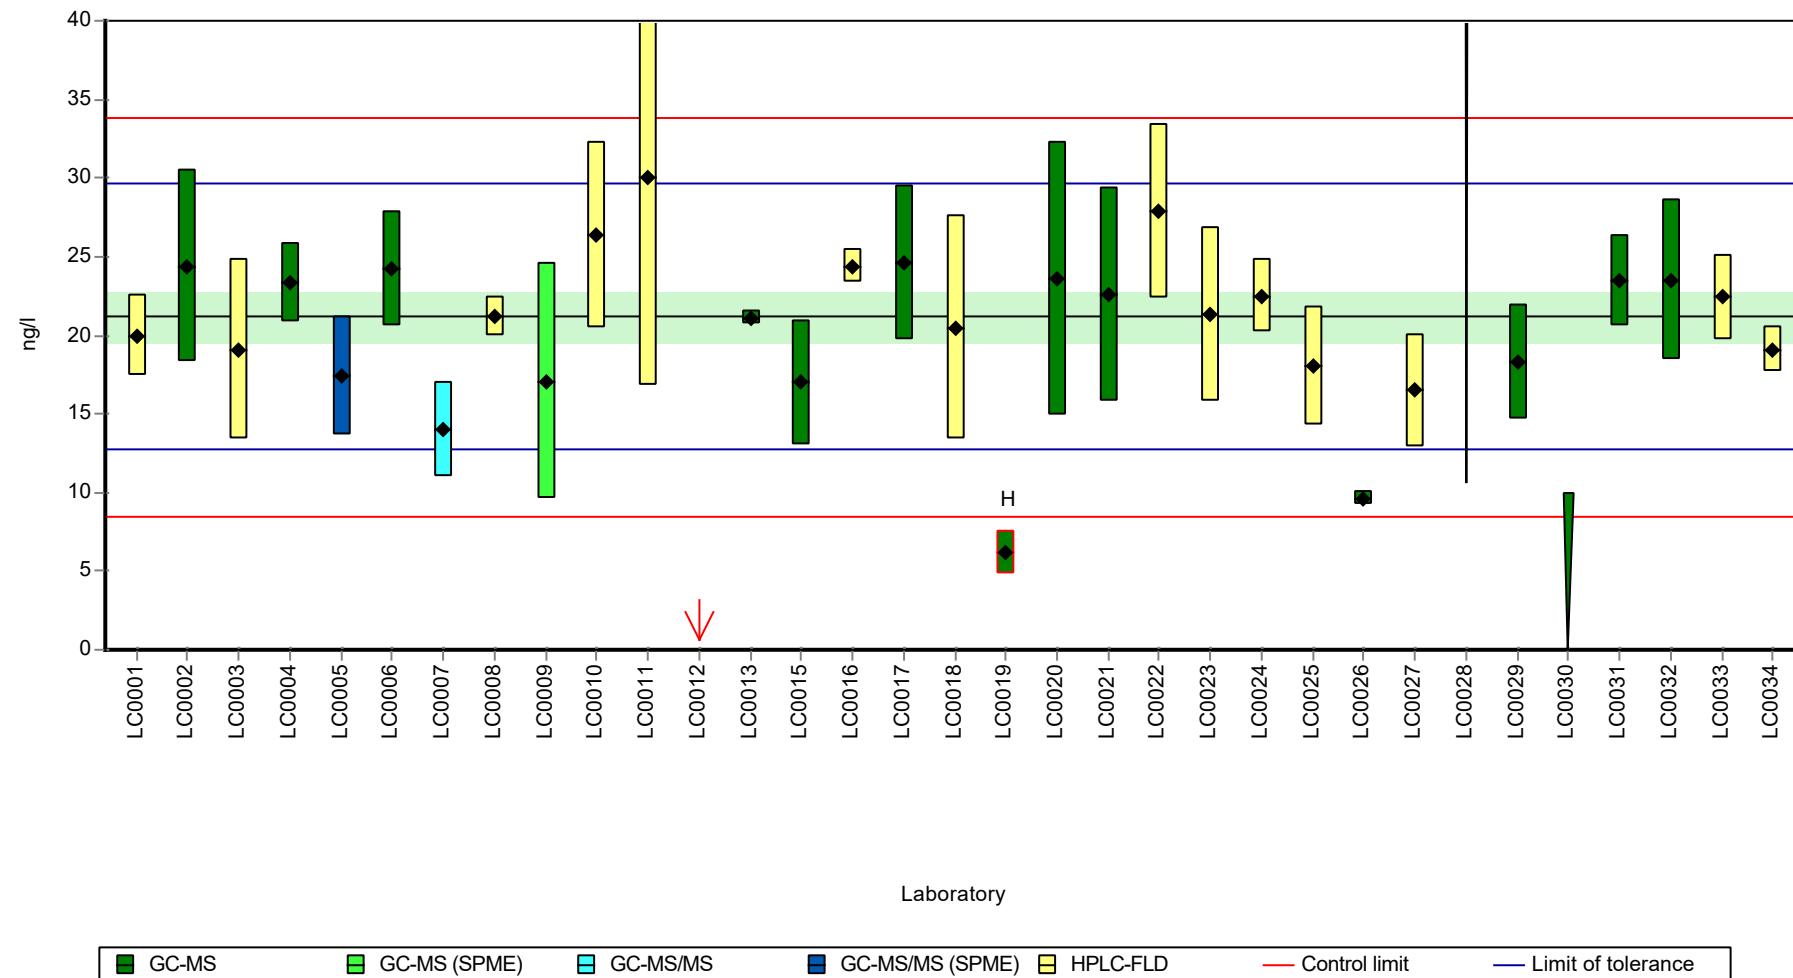


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

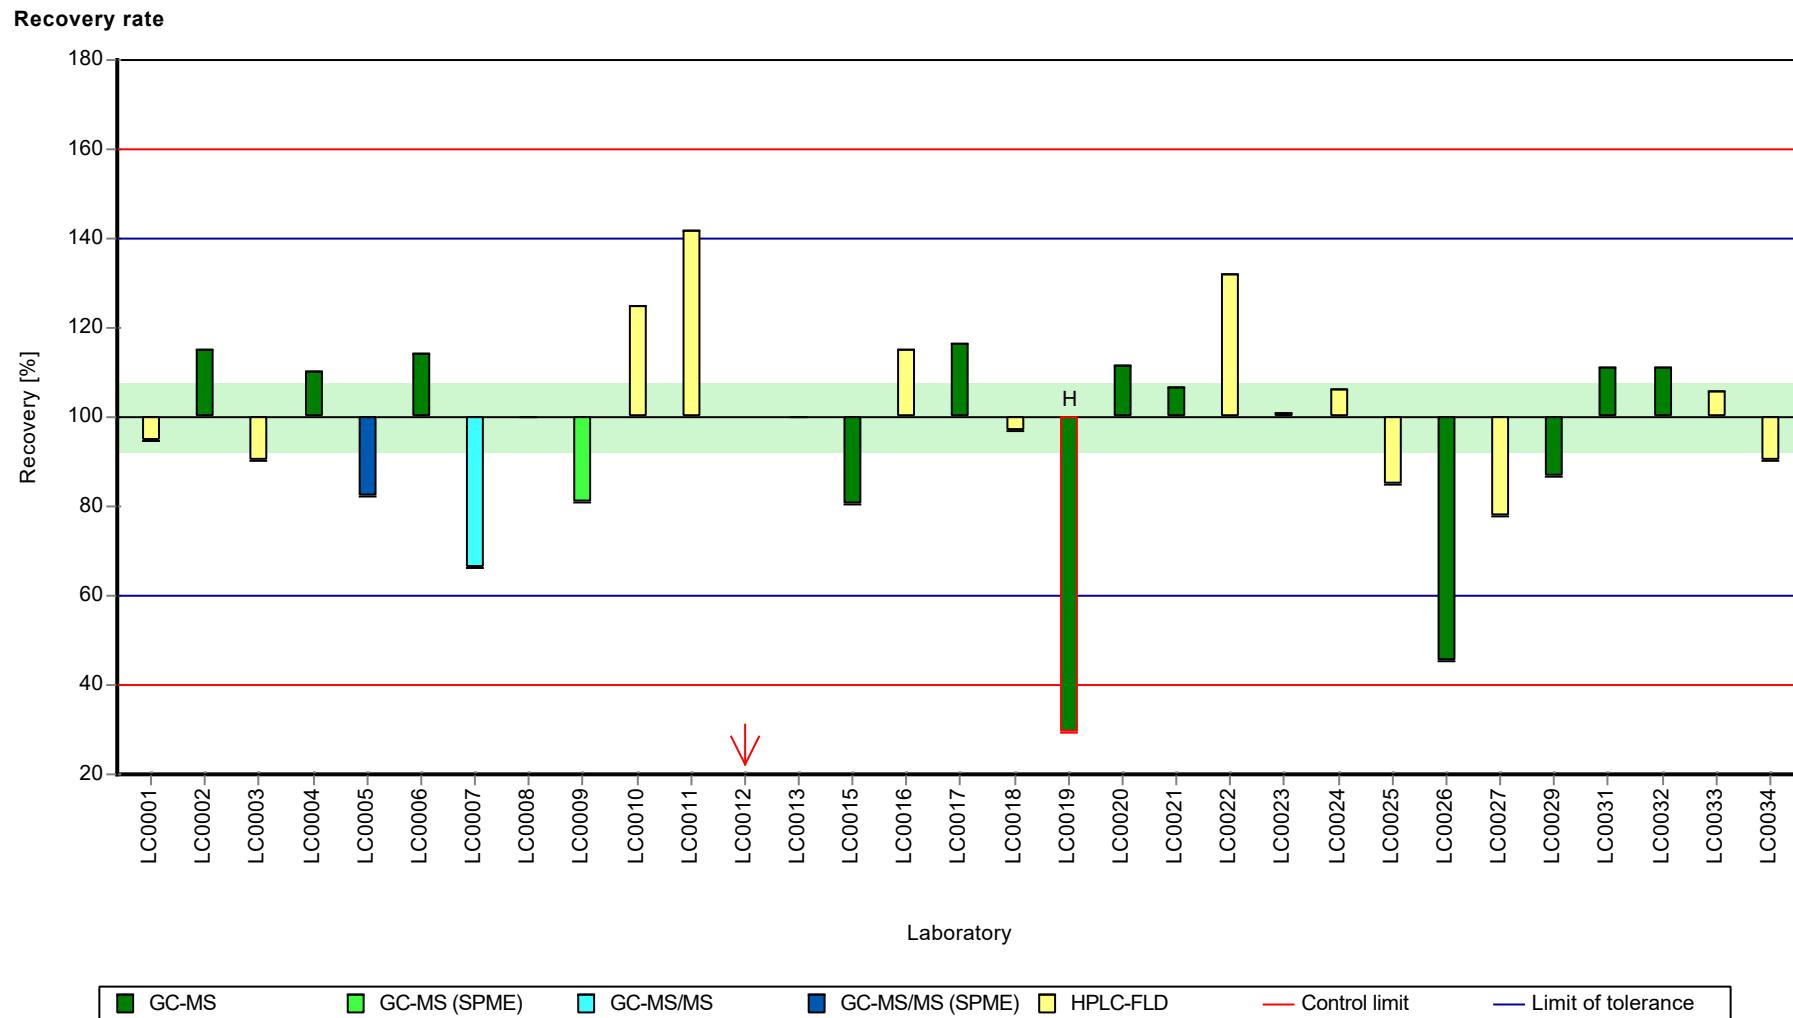

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

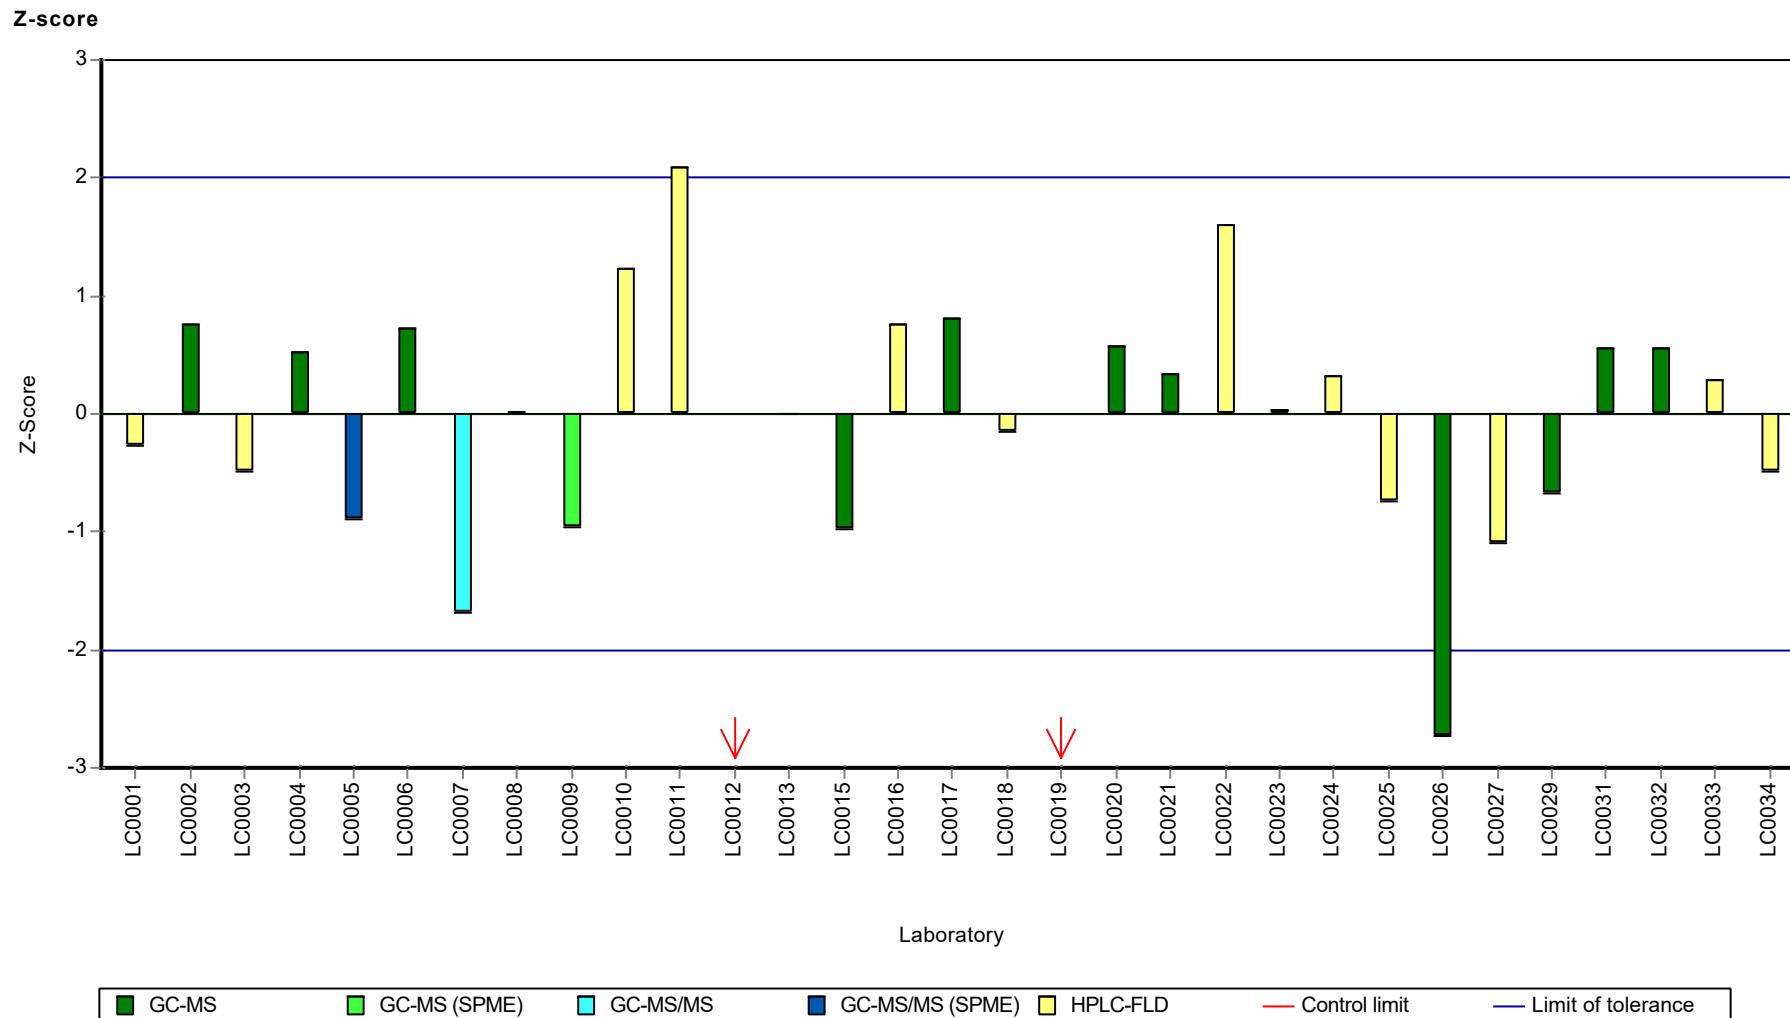

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Parameter oriented report

P24 B

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 111 ± 7.43
 Criterion 20.1 (18 %)
 Minimum - Maximum 62.7 - 147
 Control test value ± U (k=2) 138.0 ± 48.3

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	120	16	108	0.43	
LC0002	127	32	114	0.78	
LC0003	109	32.8	97.9	-0.12	
LC0004	147.26	14	132	1.79	
LC0005	91.7	20.2	82.3	-0.98	
LC0006	106.5	15.975	95.6	-0.24	
LC0007	97	19	87.1	-0.72	
LC0008	232	18	208	6.02	H
LC0009	95.2	41.9	85.5	-0.81	
LC0010	126	28.1	113	0.73	
LC0011	138.4	60.897	124	1.35	
LC0012	9.5503	0.29	8.6	-5.08	H
LC0013	109.7	0.88	98.5	-0.08	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	100	24	89.8	-0.57	
LC0016	126	4.18	113	0.73	
LC0017	126.1	25.2	113	0.73	
LC0018	110	38.5	98.7	-0.07	
LC0019	114.04	25.09	102	0.13	
LC0020	104.1	39	93.5	-0.36	
LC0021	116	34.8	104	0.23	
LC0022	143	18.6	128	1.58	
LC0023	65.53	12.4	58.8	-2.29	
LC0024	143.6	14.4	129	1.61	
LC0025	101.3	21.27	90.9	-0.5	
LC0026	62.7	2.3	56.3	-2.43	
LC0027	98.2	22	88.2	-0.66	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	118	24	106	0.33	
LC0030	13.5	2.7	12.1	-4.88	H
LC0031	105	13	94.3	-0.32	
LC0032	121.77	26.18	109	0.52	
LC0033	99.9	11.9	89.7	-0.57	
LC0034	107.4	8.28	96.4	-0.2	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	109 ± 20.3	111 ± 11.1 ng/l
Minimum	9.55	62.7 ng/l
Maximum	232	147 ng/l
Standard deviation	38.3	20 ng/l
rel. standard deviation	35.2	18 %
n	32	29 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene


Graphical presentation of results

Results

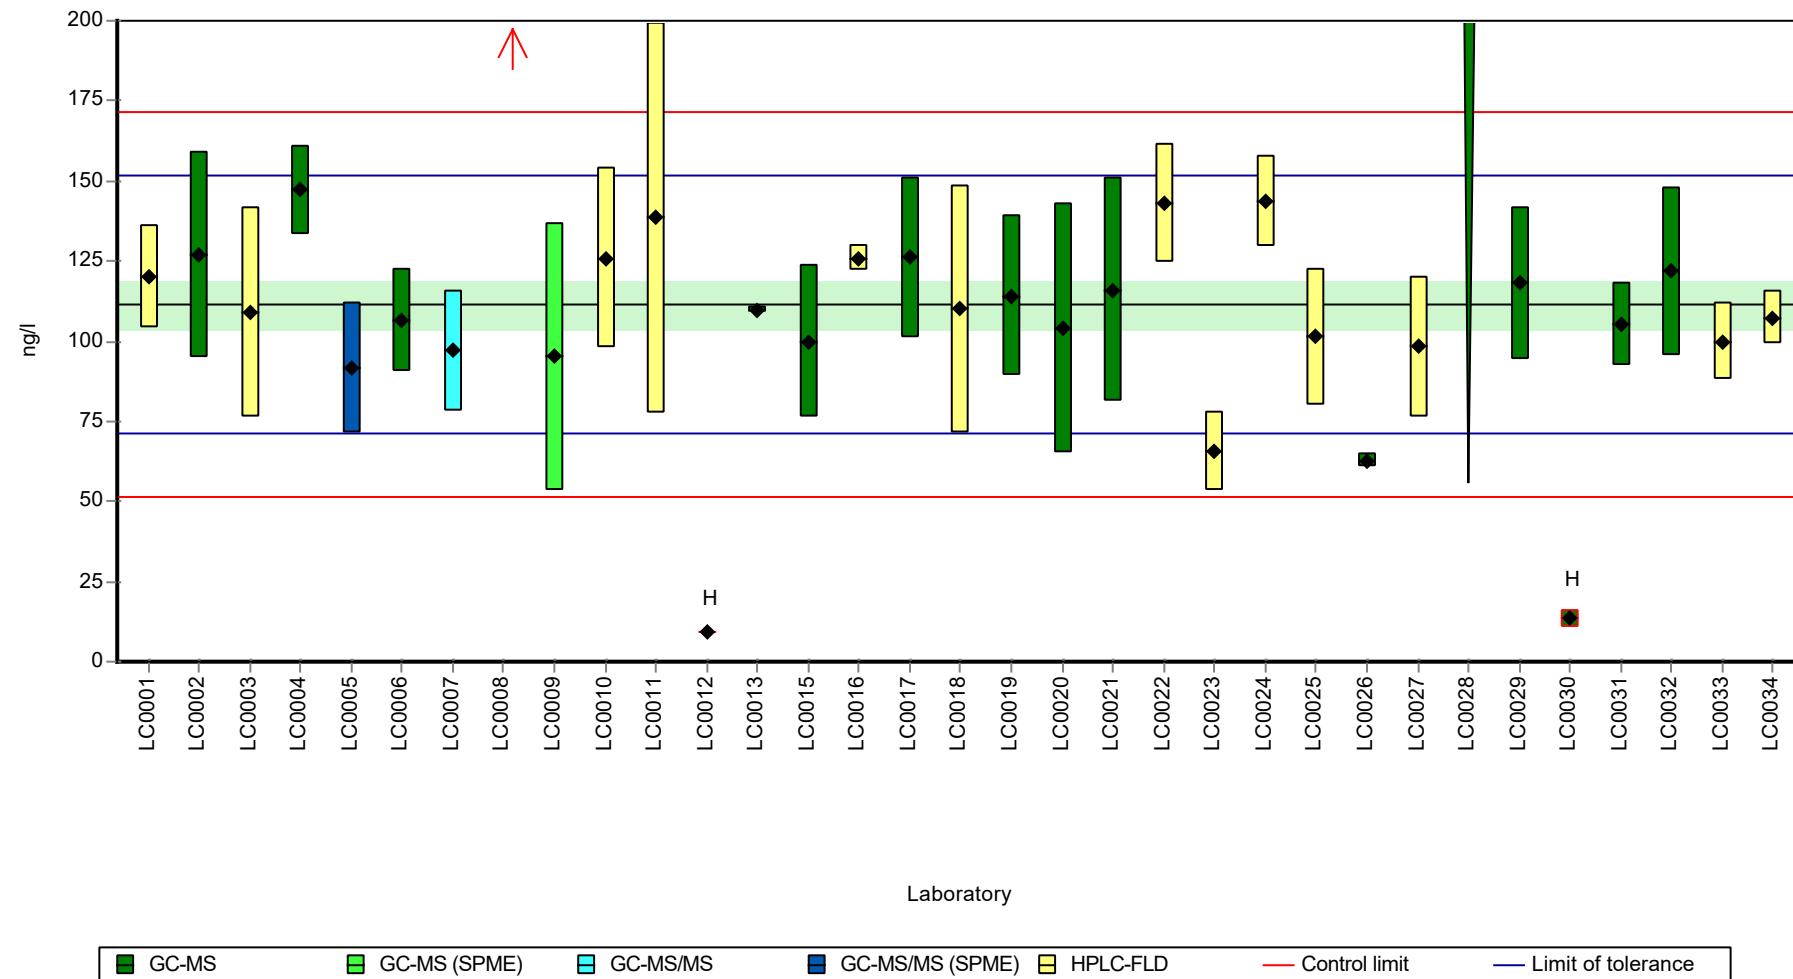


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

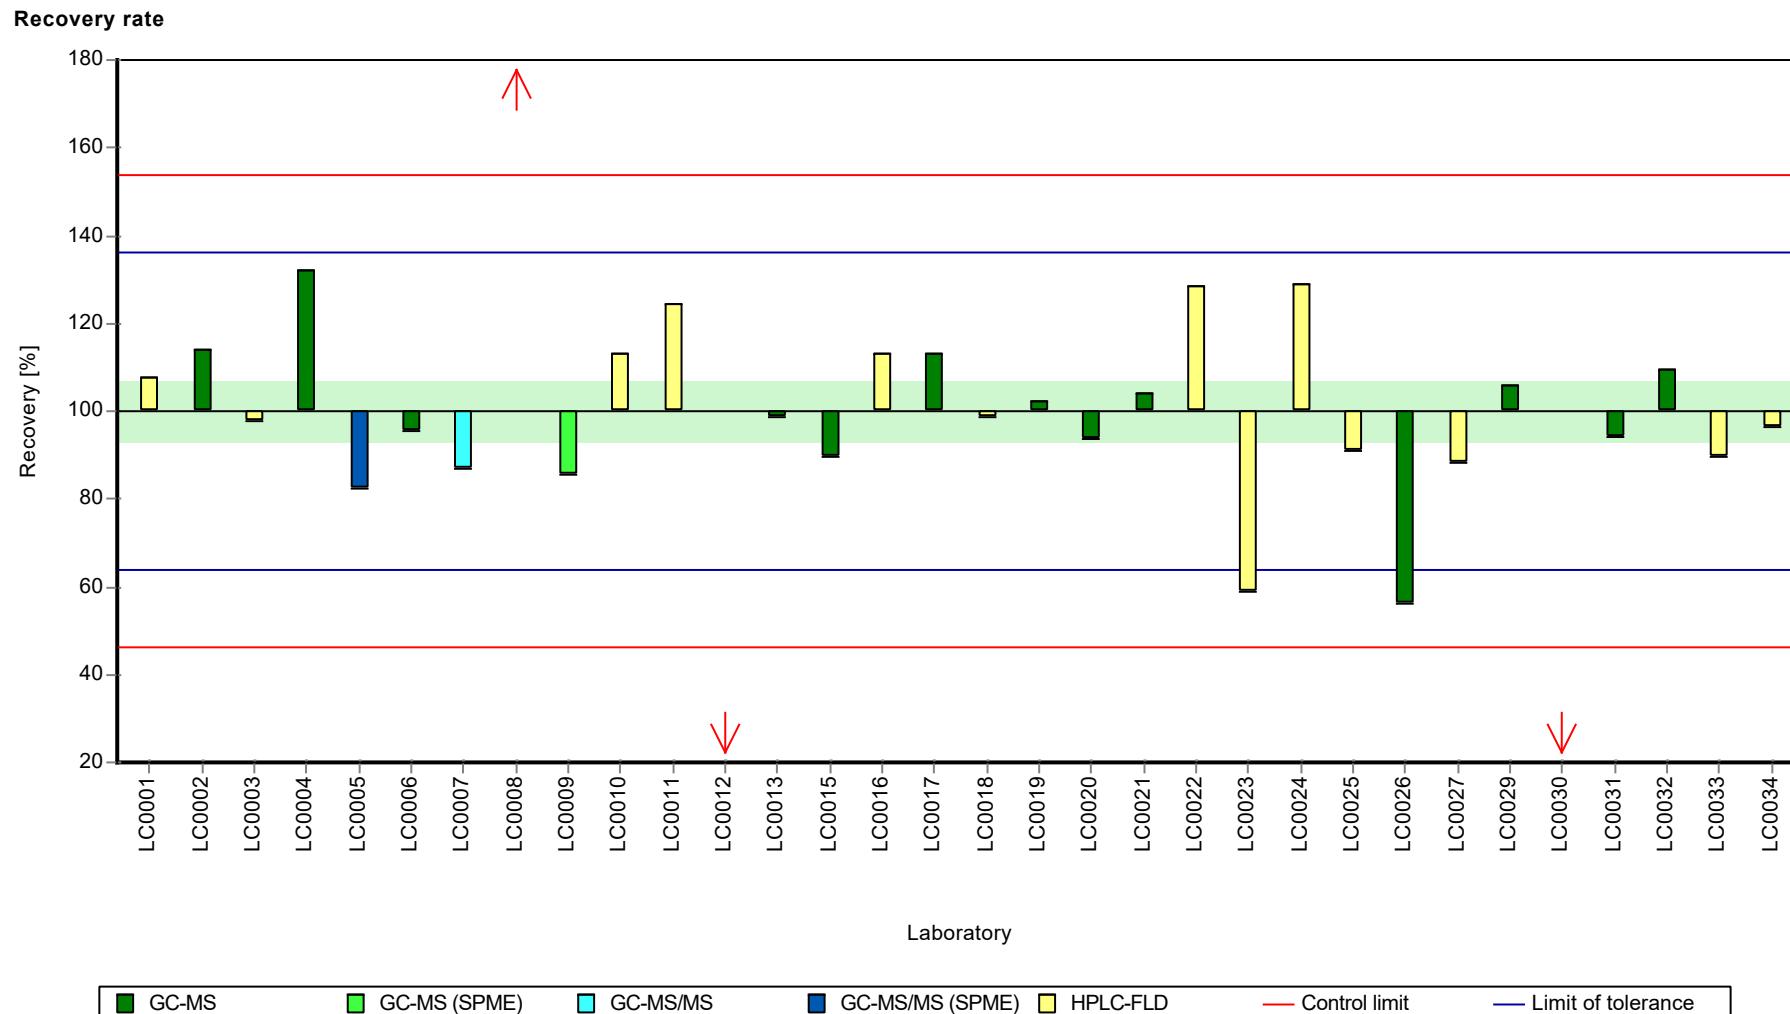

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Indeno[1,2,3-cd]pyrene

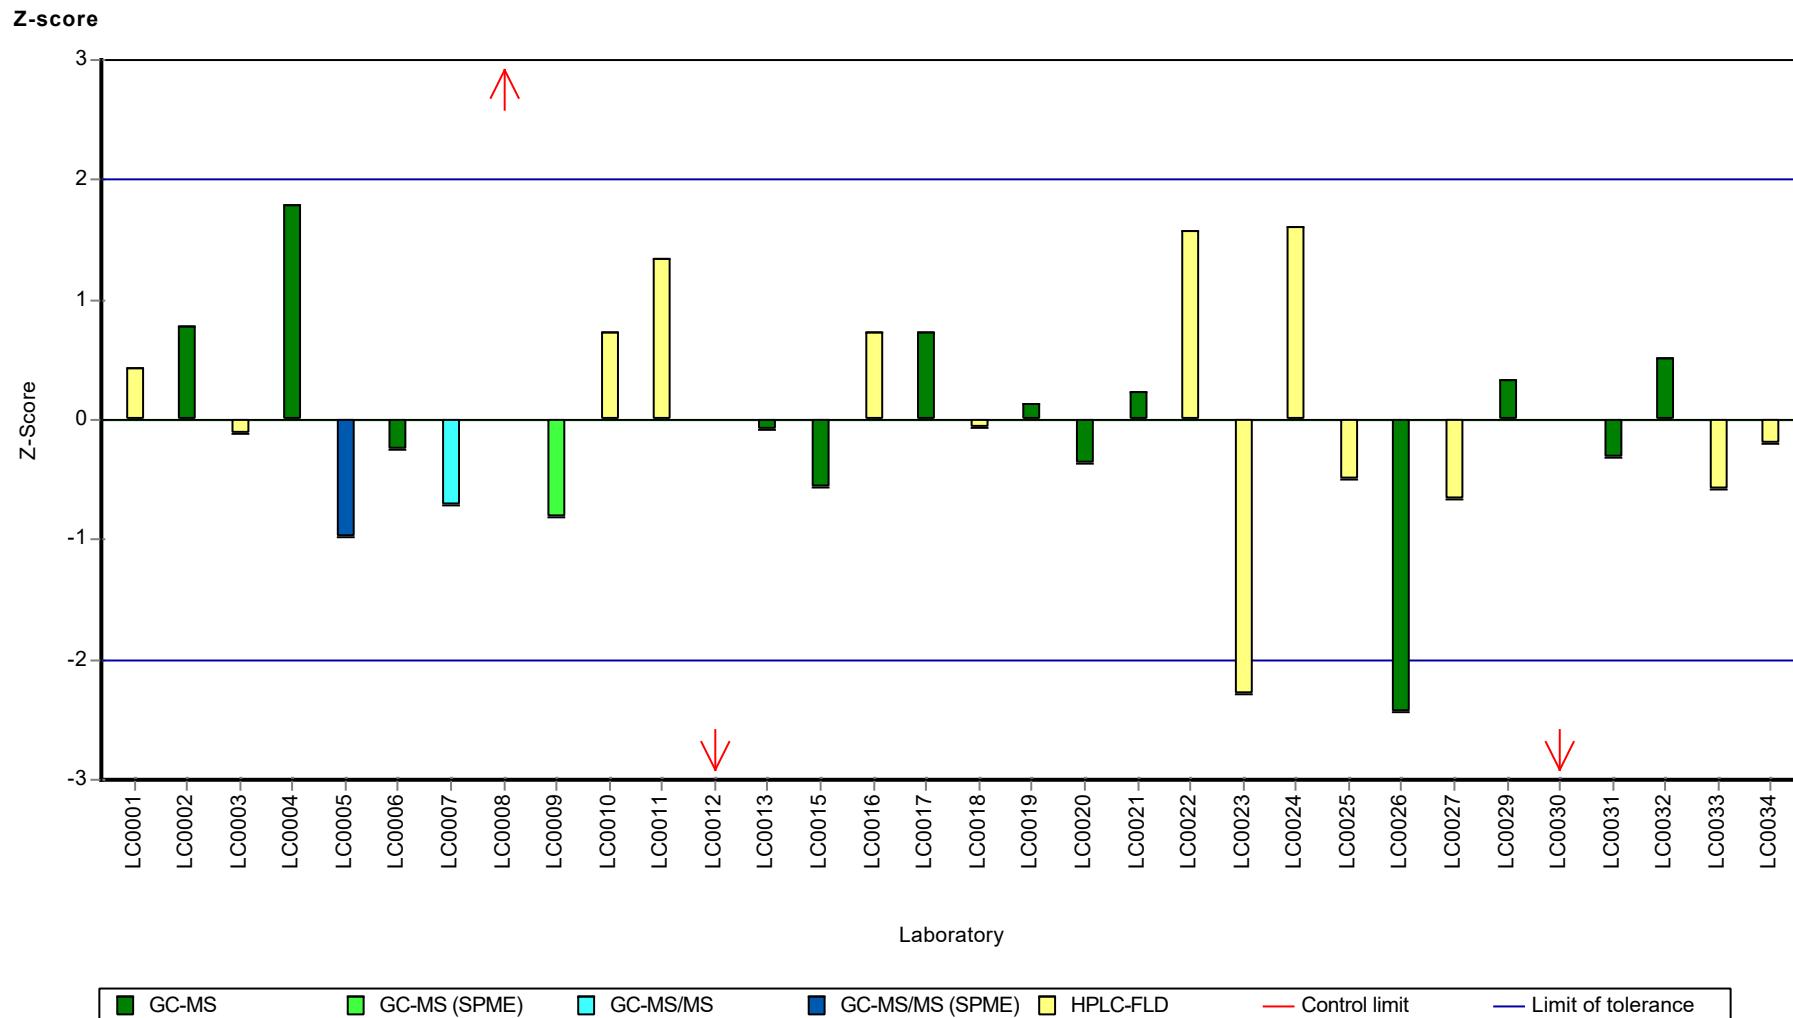

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Naphthalene

Parameter oriented report

P24A

Naphthalene

Unit ng/l
 Assigned value ± U (k=2) 36.2 ± 3.55
 Criterion 7.6 (21 %)
 Minimum - Maximum 23 - 57.3
 Control test value ± U (k=2) 40.1 ± 12

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	84.8	11	234	6.4	
LC0002	33.7	6.7	93.1	-0.33	
LC0003	37.7	11.3	104	0.2	
LC0004	44.25	4	122	1.06	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	44.15	6.623	122	1.05	
LC0007	23	5	63.6	-1.74	
LC0008	24.7	1.3	68.3	-1.51	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	57.29	25.209	158	2.78	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	33.51	0.72	92.6	-0.35	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	35	8	96.7	-0.16	
LC0016	44.2	1.61	122	1.05	
LC0017	37.7	7.5	104	0.2	
LC0018	30.8	10.8	85.1	-0.71	
LC0019	9.59	2.11	26.5	-3.5	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	< 50 (LOQ)	-	-	-	
LC0023	32.02	7.2	88.5	-0.55	
LC0024	33	3.3	91.2	-0.42	
LC0025	35.2	7.39	97.3	-0.13	
LC0026	49.7	4.29	137	1.78	
LC0027	37.9	8.3	105	0.23	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	31	6.2	85.7	-0.68	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	42.4	8	117	0.82	
LC0032	35.18	3.925	97.2	-0.13	
LC0033	28.7	8.1	79.3	-0.99	
LC0034	25	1.28	69.1	-1.47	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Naphthalene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	37.1 ± 8.57	36.2 ± 5.32 ng/l
Minimum	9.59	23 ng/l
Maximum	84.8	57.3 ng/l
Standard deviation	14	8.32 ng/l
rel. standard deviation	37.7	23 %
n	24	22 -


Graphical presentation of results

Results

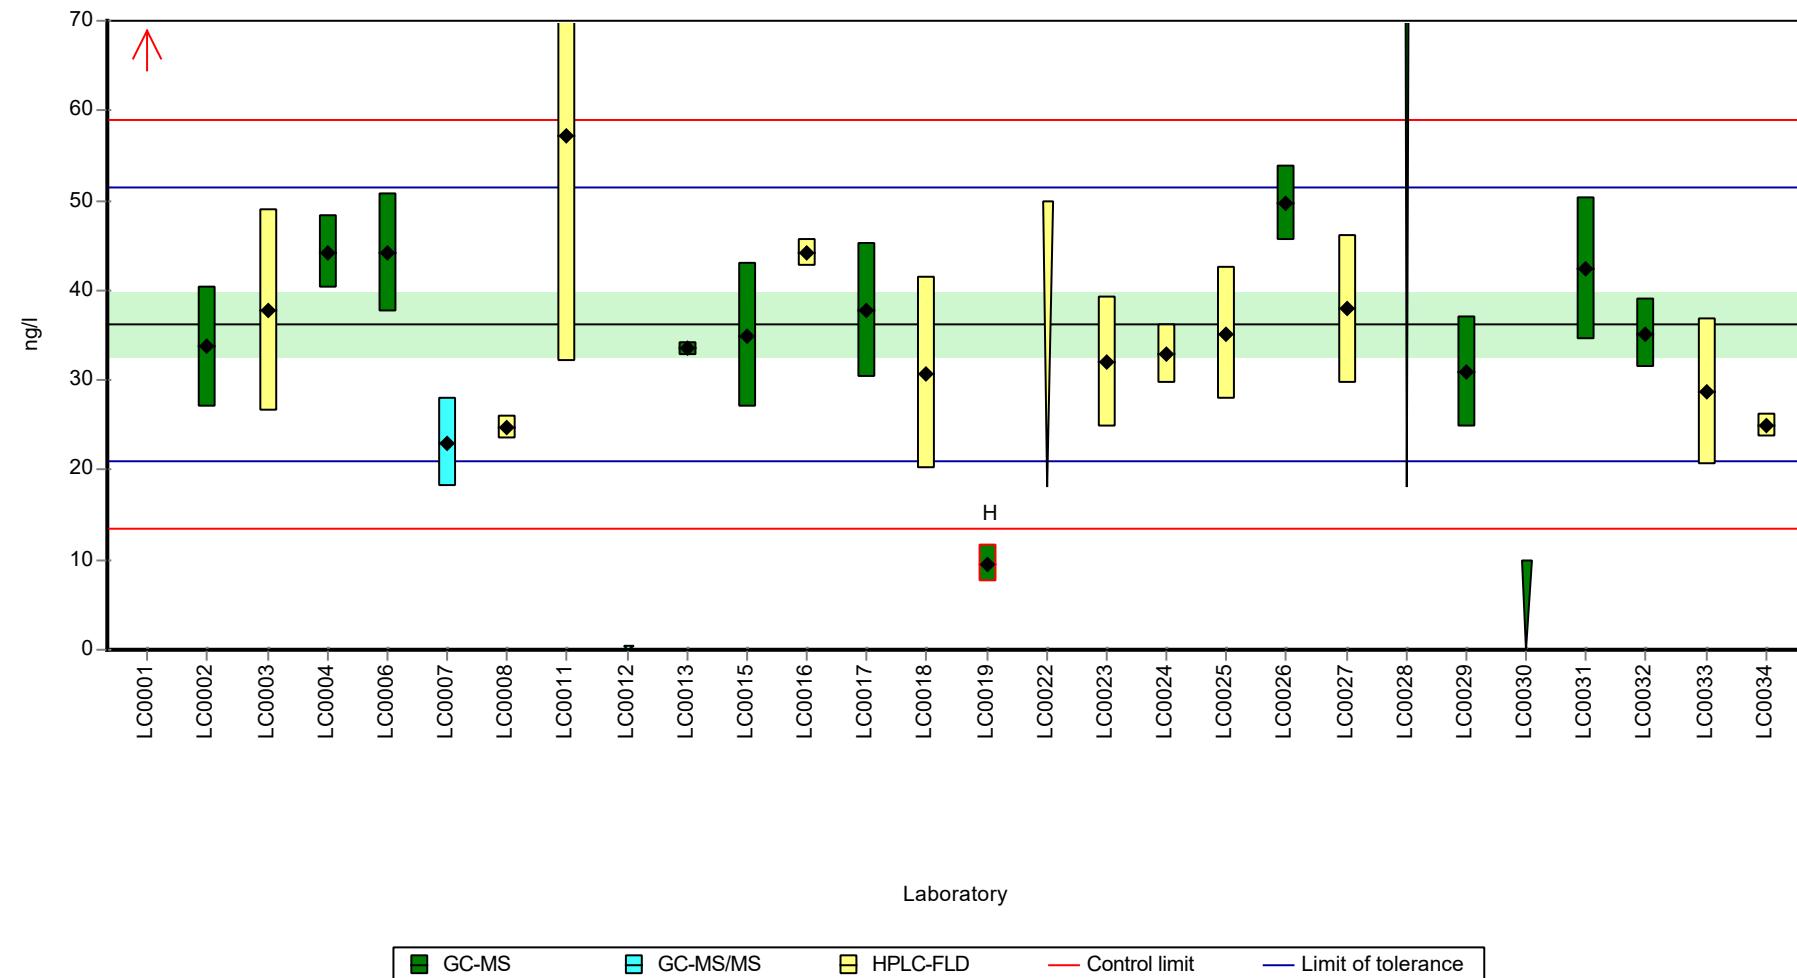


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Naphthalene

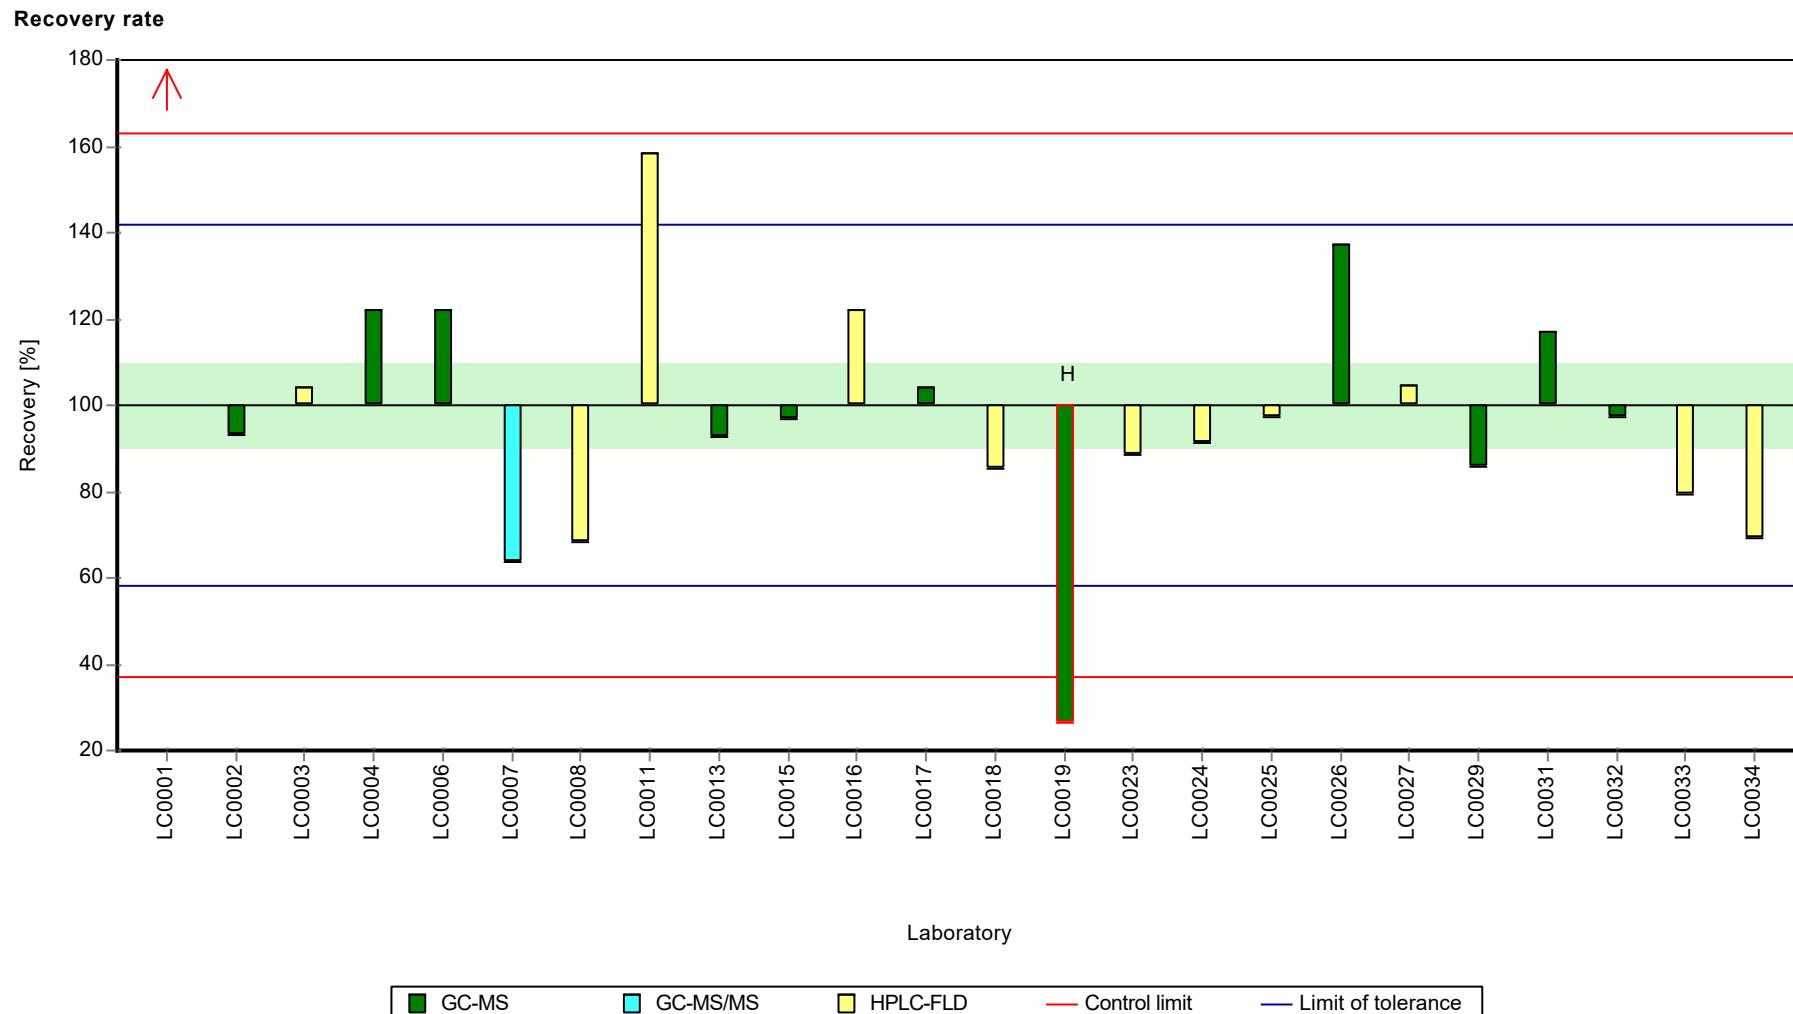

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Naphthalene

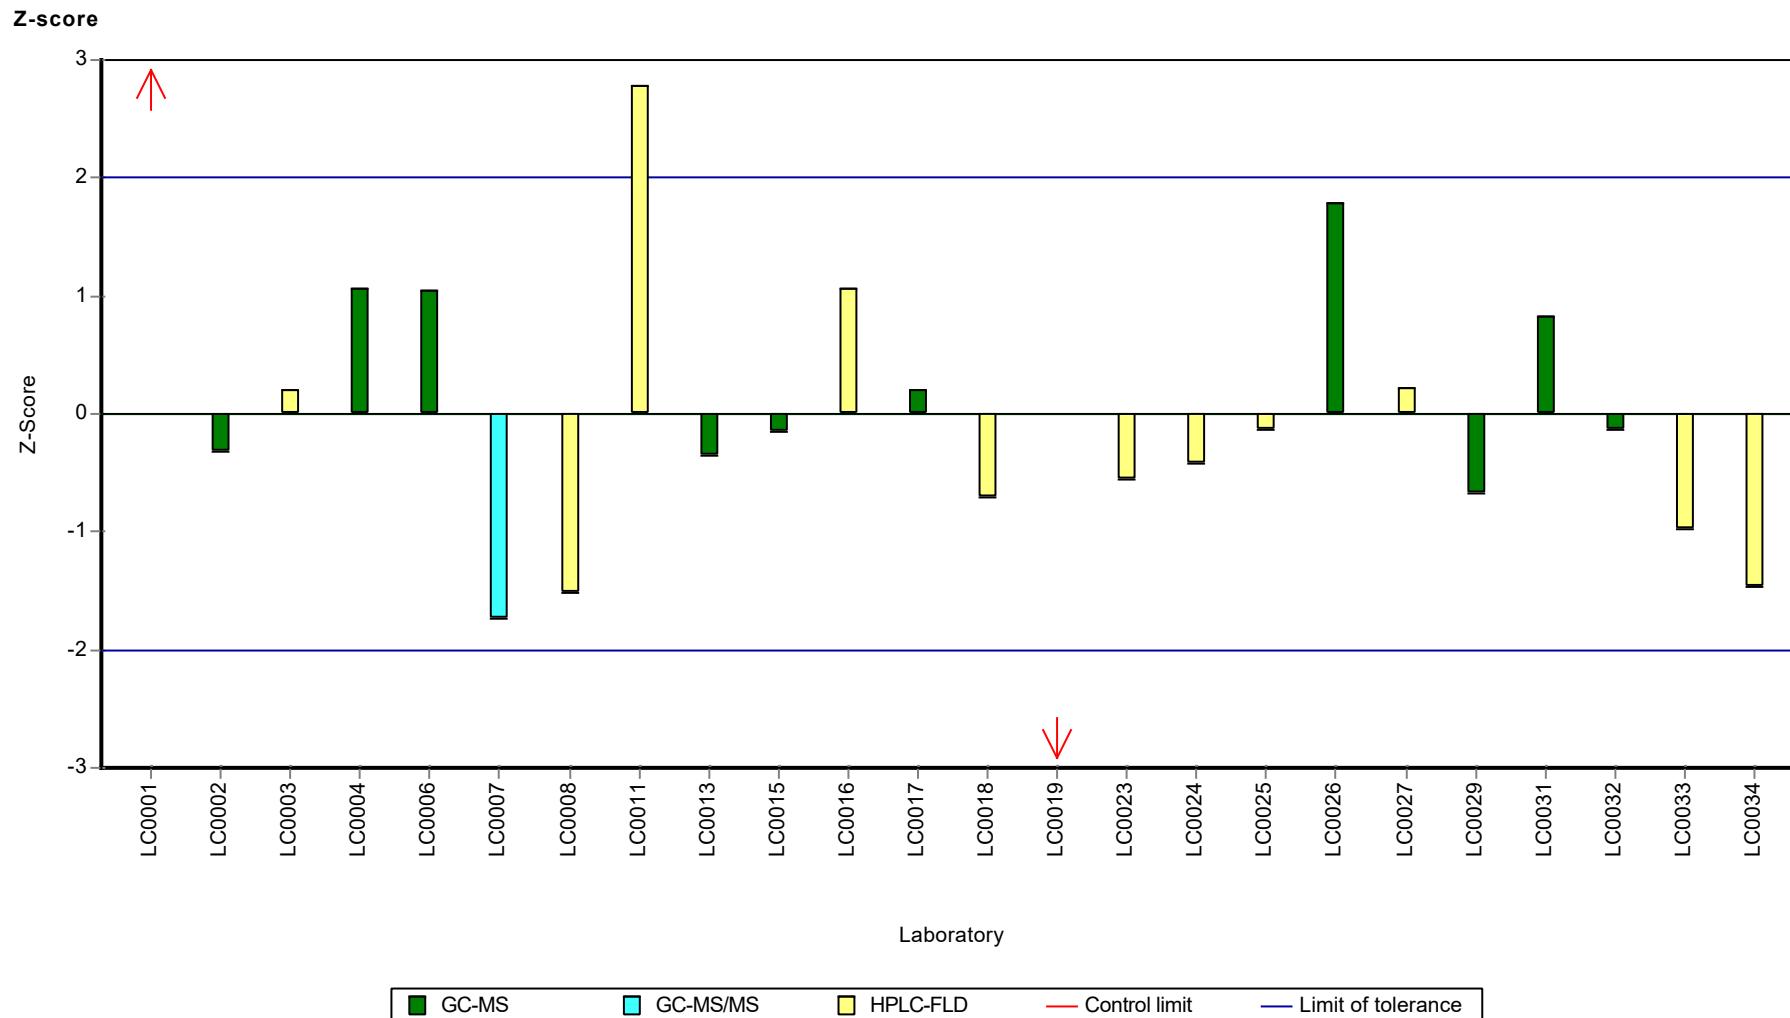

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Naphthalene

Parameter oriented report

P24 B

Naphthalene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 182 \pm 12.7
 Criterion 38.3 (21 %)
 Minimum - Maximum 105 - 246
 Control test value \pm U (k=2) 230.0 \pm 69.1

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	463	60	254	7.32	
LC0002	182	36	99.8	-0.01	
LC0003	159	47.7	87.2	-0.61	
LC0004	190.18	19	104	0.2	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	152.7	22.905	83.7	-0.78	
LC0007	192	38	105	0.25	
LC0008	282	2	155	2.6	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	176.82	77.801	96.9	-0.15	
LC0012	< 0.5 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	172.9	1.31	94.8	-0.25	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	204	49	112	0.56	
LC0016	197	6.69	108	0.38	
LC0017	181.7	36.3	99.6	-0.02	
LC0018	161	56.4	88.3	-0.56	
LC0019	135.14	29.73	74.1	-1.23	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	169	50.7	92.6	-0.35	
LC0023	105.1	19.8	57.6	-2.02	
LC0024	195.5	19.6	107	0.34	
LC0025	217.4	45.65	119	0.91	
LC0026	246	4.67	135	1.66	
LC0027	192	42	105	0.25	
LC0028	220	29	121	0.98	
LC0029	179	36	98.1	-0.09	
LC0030	21	4.2	11.5	-4.21	H
LC0031	201	38	110	0.48	
LC0032	183.83	20.495	101	0.04	
LC0033	47.5	13.4	26	-3.52	H
LC0034	61.8	3.17	33.9	-3.15	H

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Naphthalene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	181 ± 46.1	182 ± 19 ng/l
Minimum	21	105 ng/l
Maximum	463	246 ng/l
Standard deviation	79.9	29.7 ng/l
rel. standard deviation	44.1	16.3 %
n	27	22 -


Graphical presentation of results

Results

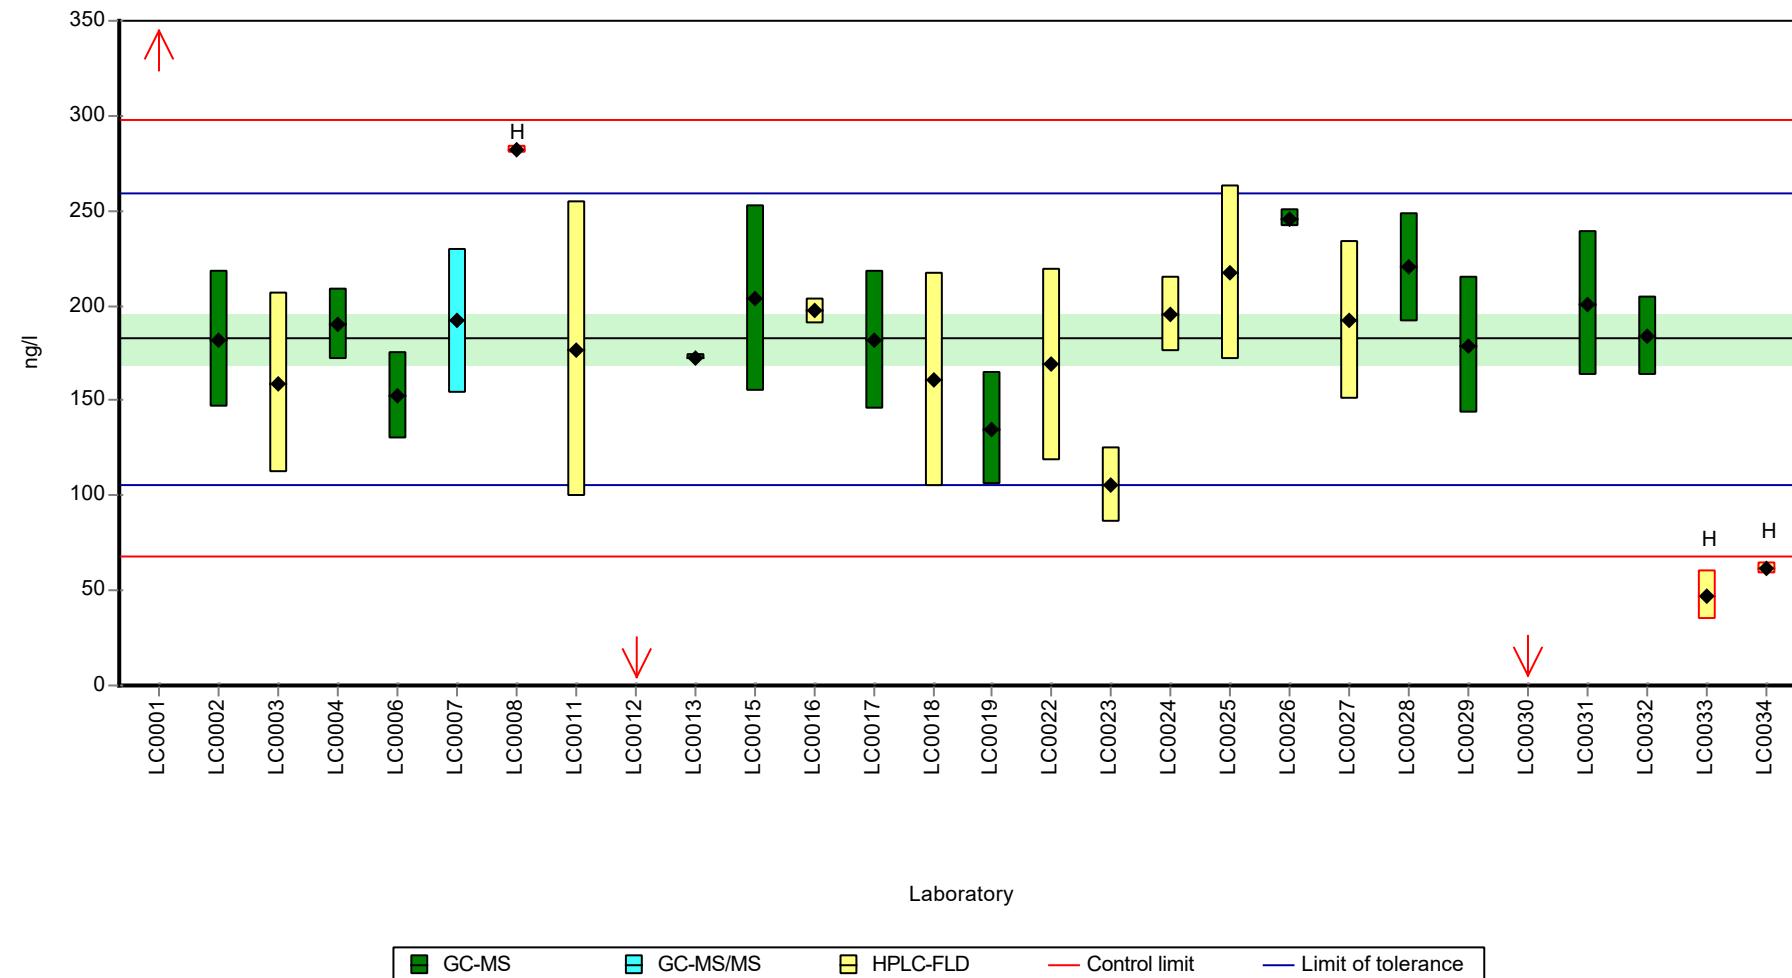


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Naphthalene

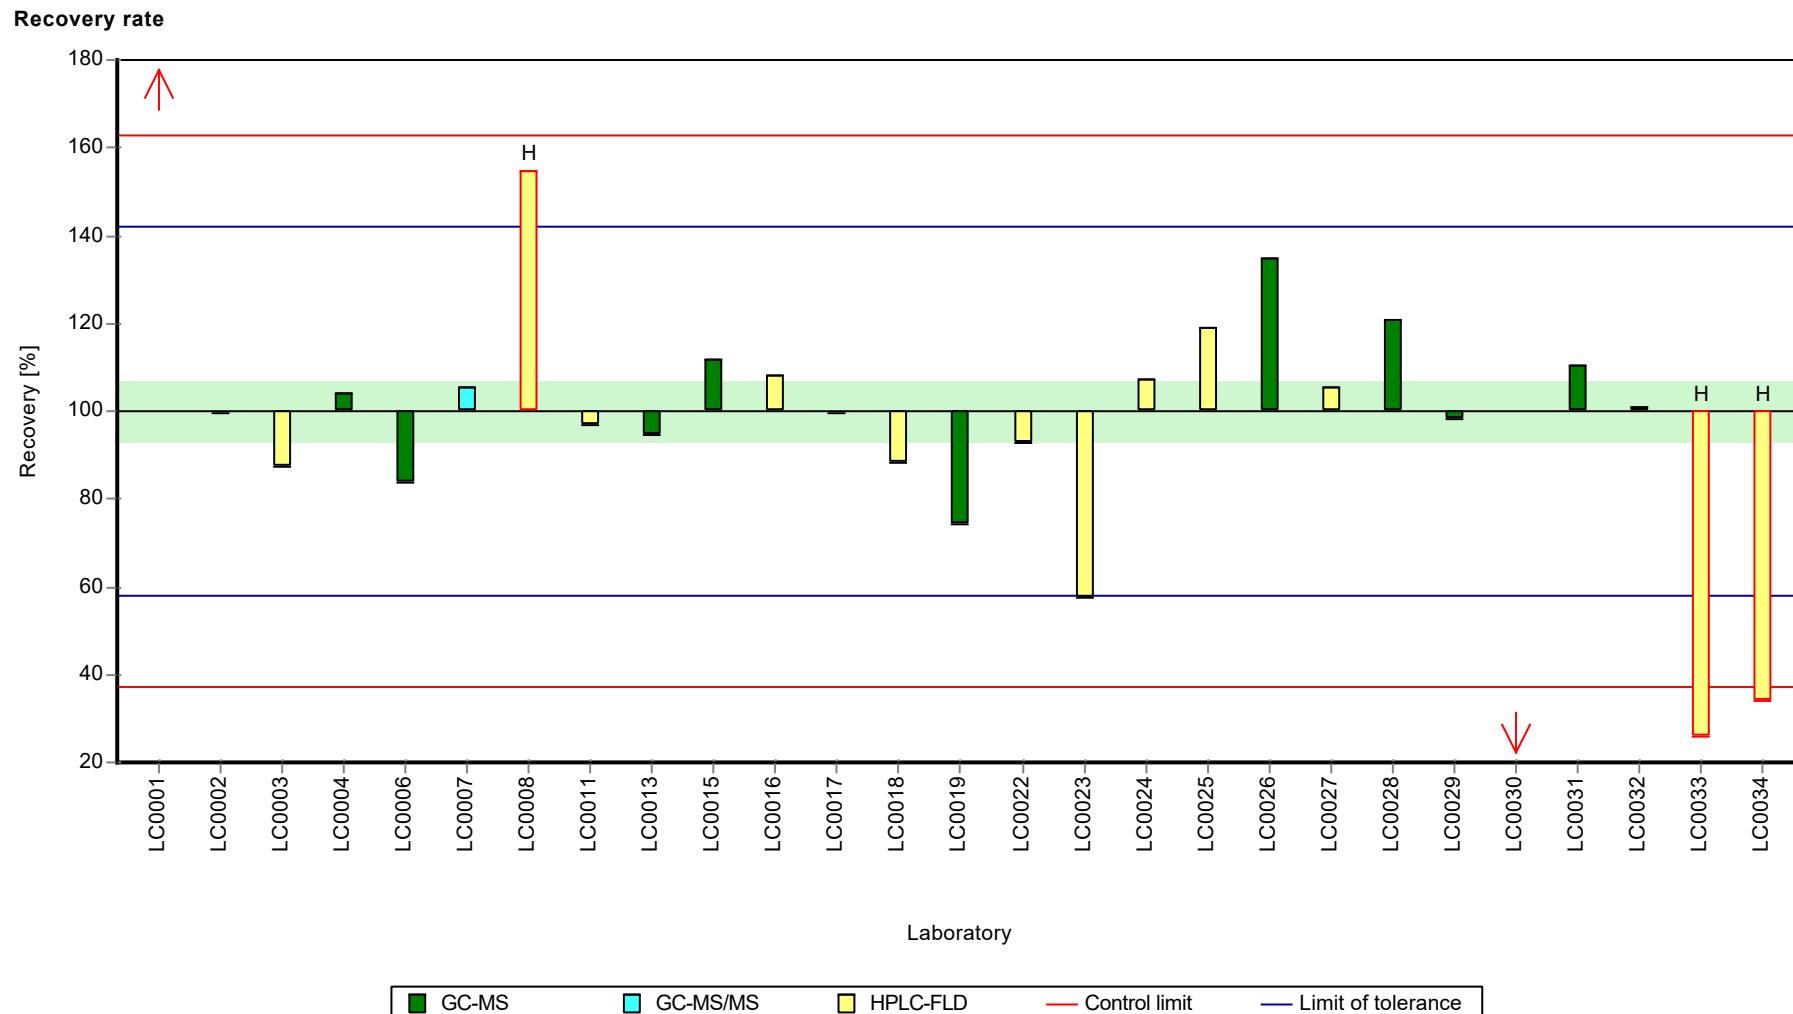

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Naphthalene

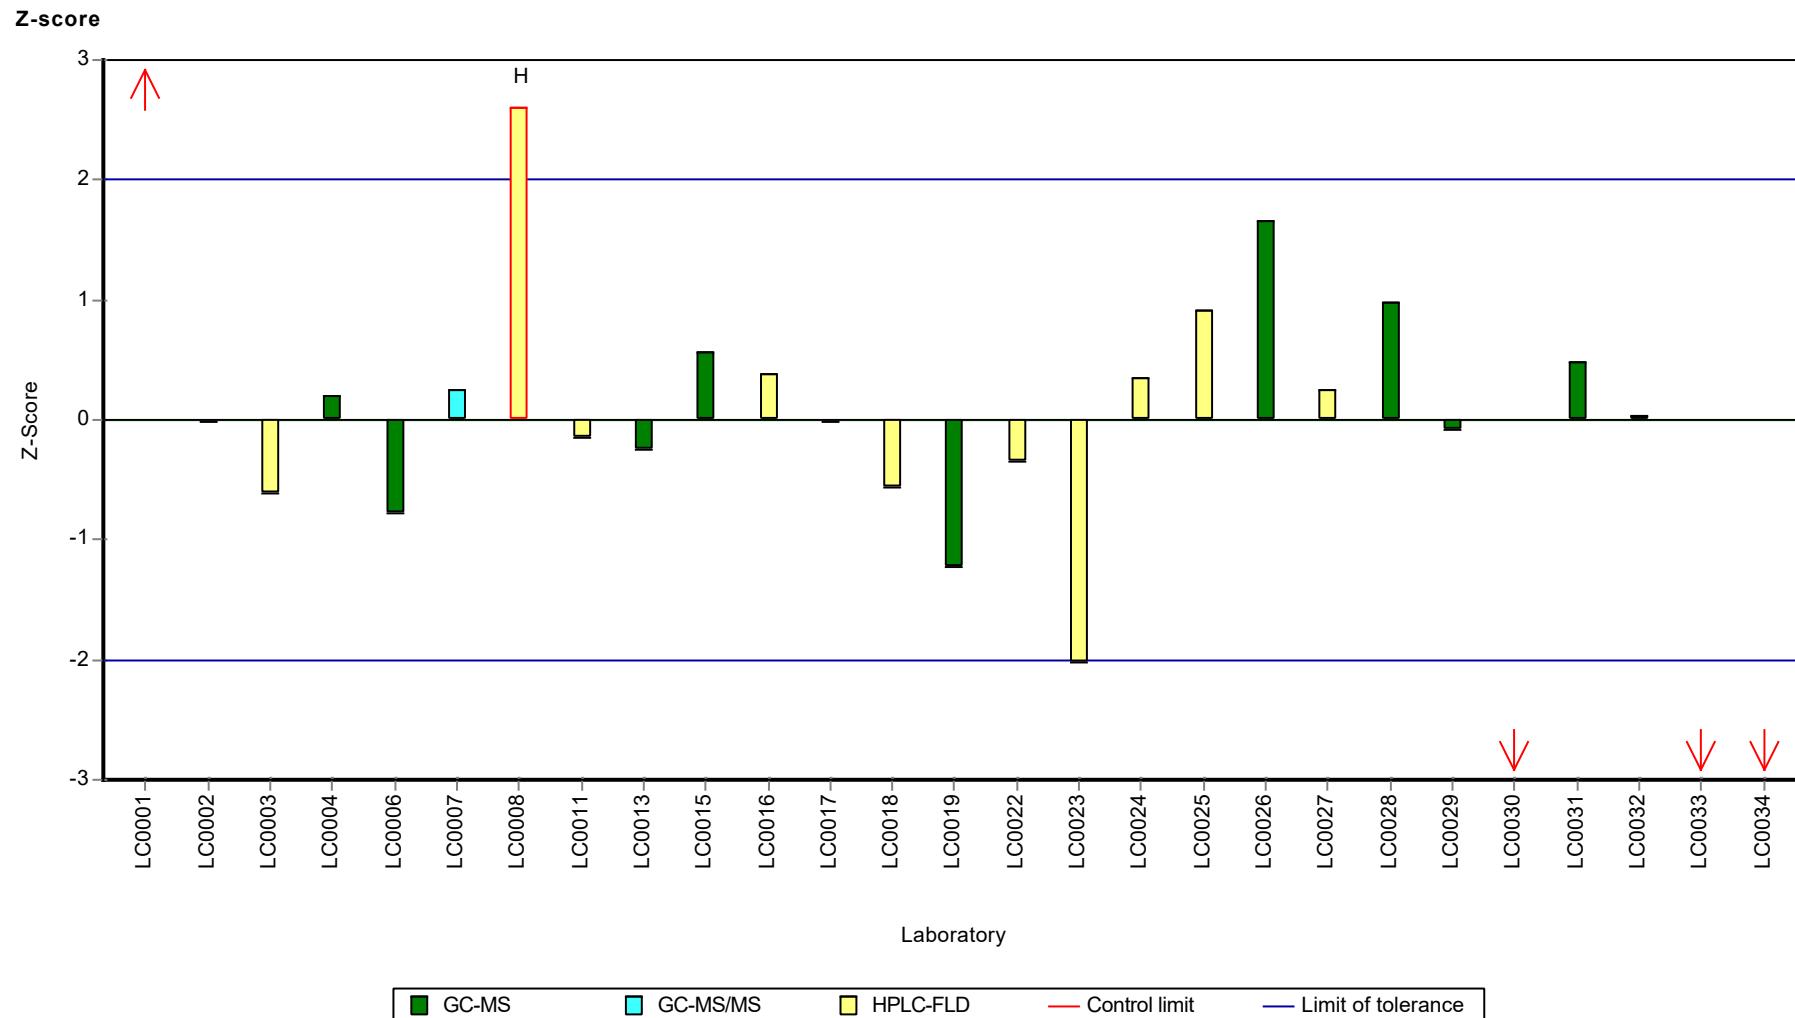

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Phenanthrene

Parameter oriented report

P24A

Phenanthrene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 29.6 \pm 3.63
 Criterion 9.18 (31 %)
 Minimum - Maximum 11.4 - 49.7
 Control test value \pm U (k=2) 34.4 \pm 8.61

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	28.7	3.7	96.9	-0.1	
LC0002	28	5.6	94.6	-0.18	
LC0003	49.7	14.9	168	2.19	
LC0004	45.99	4.5	155	1.78	
LC0005	28.1	6.2	94.9	-0.16	
LC0006	31.15	4.673	105	0.17	
LC0007	19	4	64.2	-1.16	
LC0008	43.1	1.5	146	1.47	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	61.62	27.115	208	3.49	H
LC0012	12.61	1.21	42.6	-1.85	
LC0013	27.34	0.77	92.3	-0.25	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	27	7	91.2	-0.28	
LC0016	29	1.27	97.9	-0.07	
LC0017	35.9	7.2	121	0.69	
LC0018	25.3	8.86	85.4	-0.47	
LC0019	11.41	2.28	38.5	-1.98	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	30.6	6.1	103	0.11	
LC0023	34.4	7.1	116	0.52	
LC0024	28.5	2.9	96.3	-0.12	
LC0025	35.8	7.52	121	0.67	
LC0026	39.5	0.45	133	1.08	
LC0027	28.3	6.2	95.6	-0.14	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	20	4	67.5	-1.05	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	
LC0031	30.2	3.7	102	0.06	
LC0032	28.55	2.925	96.4	-0.12	
LC0033	122.6	13.2	414	10.13	H
LC0034	22.1	1.49	74.6	-0.82	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Phenanthrene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	34.2 ± 11.9	29.6 ± 5.45 ng/l
Minimum	11.4	11.4 ng/l
Maximum	123	49.7 ng/l
Standard deviation	20.6	9.08 ng/l
rel. standard deviation	60.3	30.7 %
n	27	25 -


Graphical presentation of results

Results

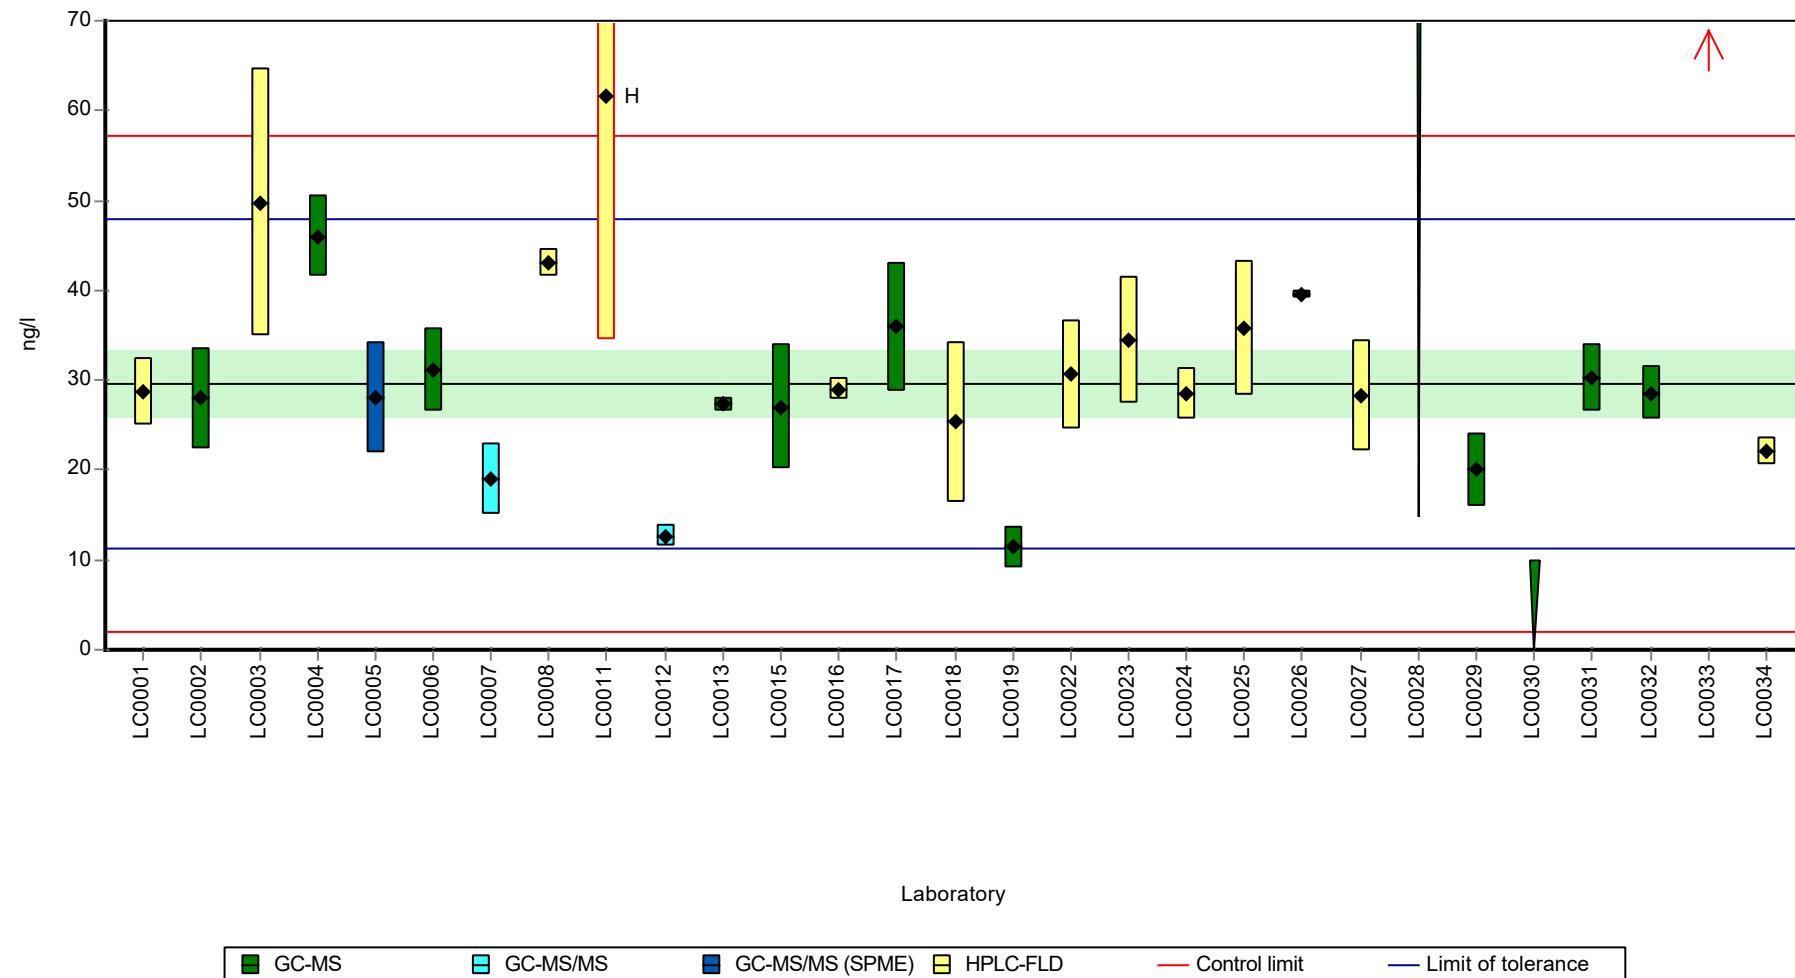


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Phenanthrene

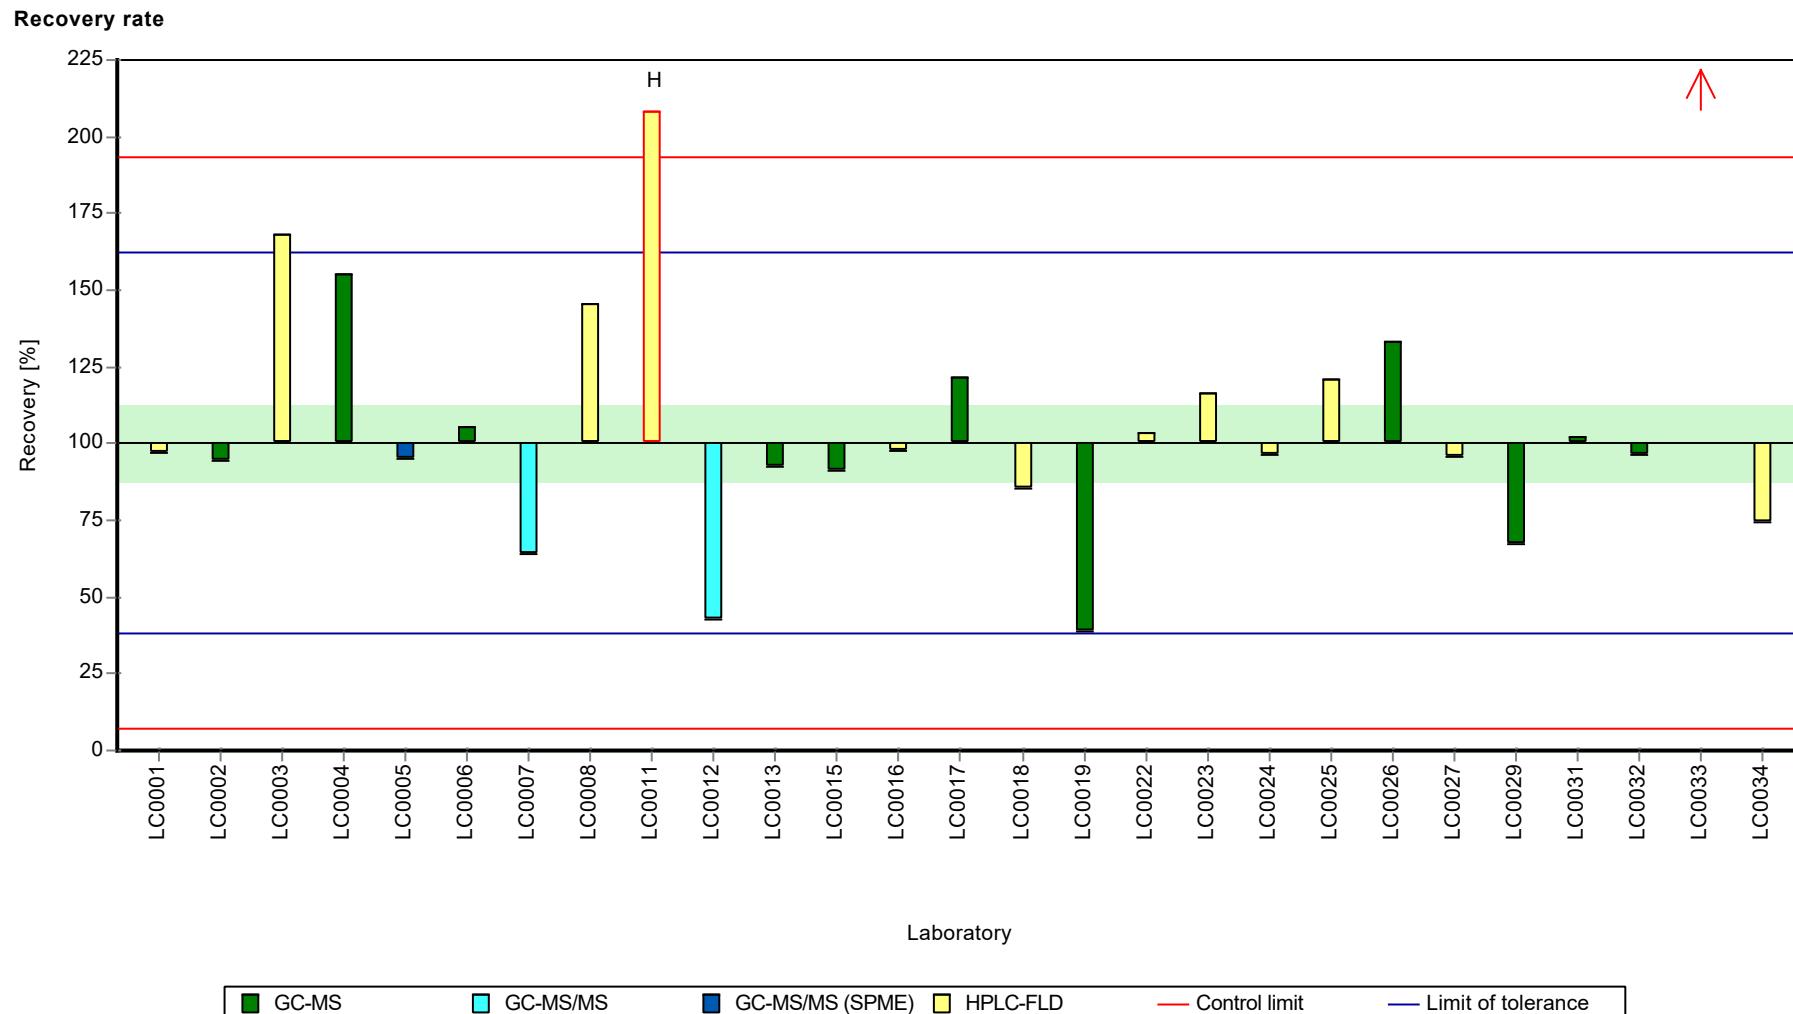

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Phenanthrene

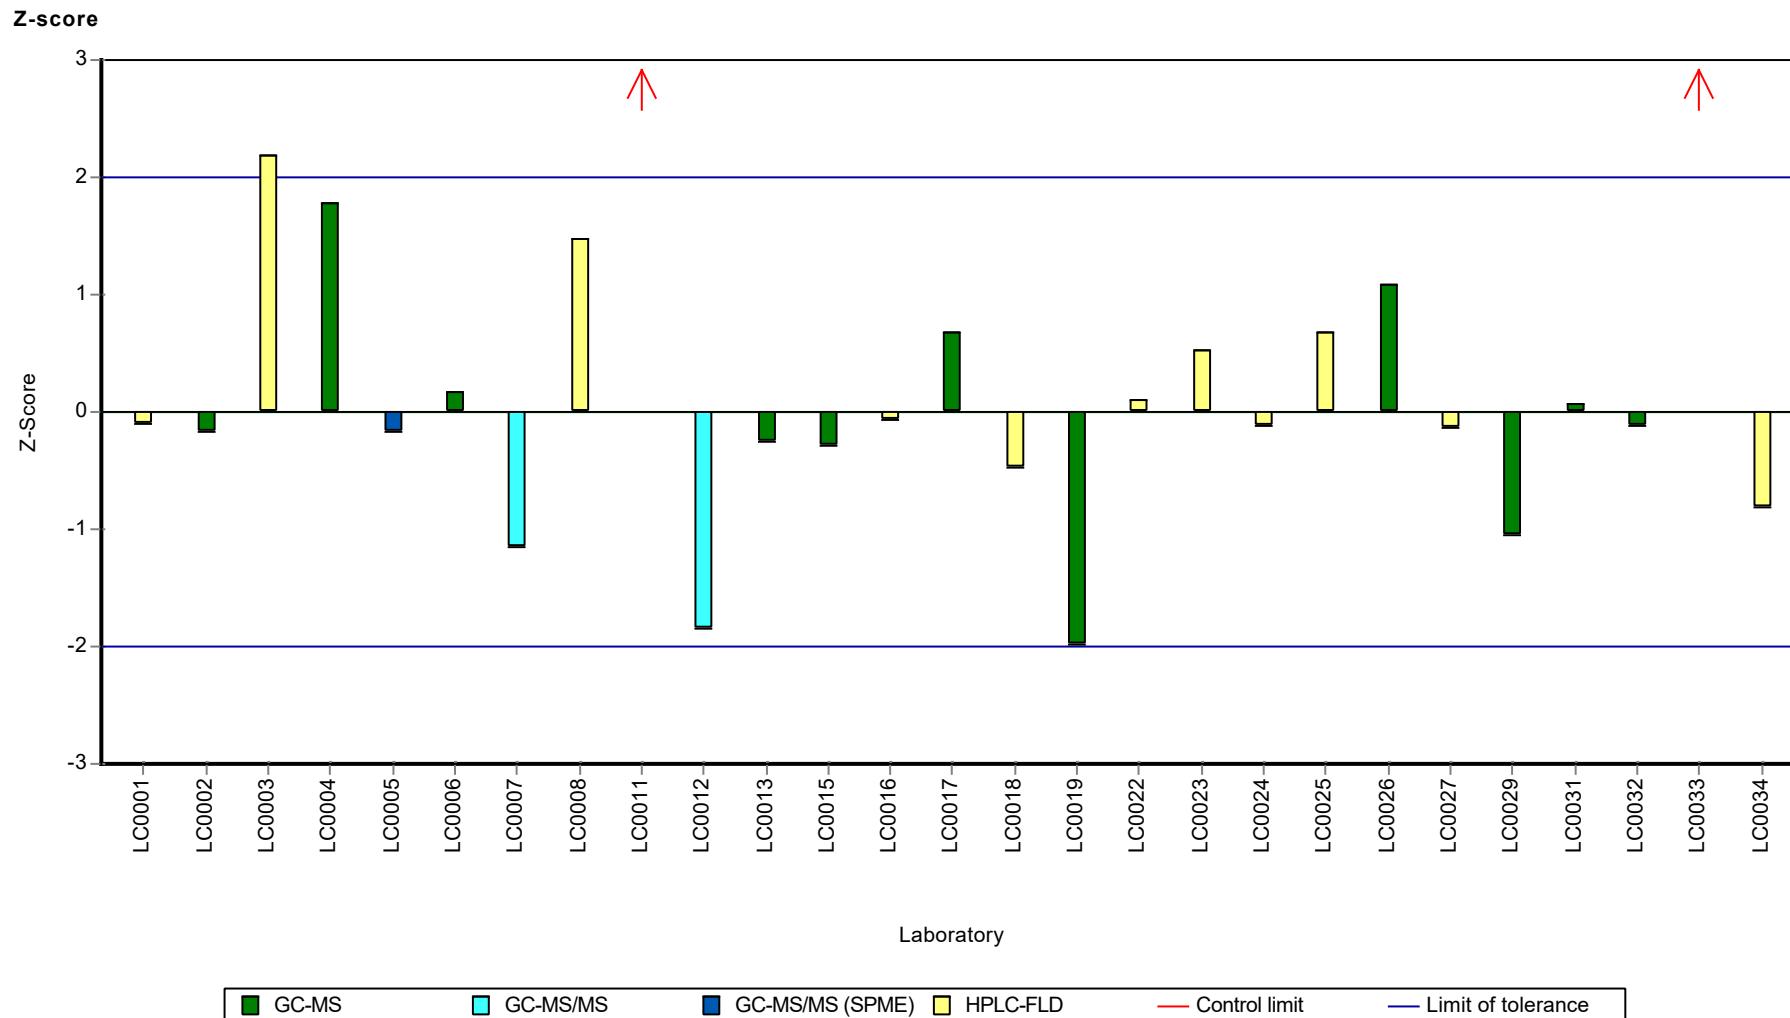

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Phenanthrene

Parameter oriented report

P24 B

Phenanthrene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 180 \pm 13.7
 Criterion 26.9 (15 %)
 Minimum - Maximum 129 - 274
 Control test value \pm U (k=2) 209.0 \pm 52.4

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	174	23	96.9	-0.21	
LC0002	171	34	95.2	-0.32	
LC0003	204	61.2	114	0.91	
LC0004	228.56	22	127	1.82	
LC0005	165	36	91.9	-0.54	
LC0006	168.8	25.32	94	-0.4	
LC0007	181	36	101	0.05	
LC0008	412	8.4	229	8.63	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	190.81	83.956	106	0.42	
LC0012	274.38	1.21	153	3.52	
LC0013	158.2	2.24	88.1	-0.79	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	191	46	106	0.42	
LC0016	182	5.18	101	0.09	
LC0017	179.5	35.9	100	0.00	
LC0018	158	55.3	88	-0.8	
LC0019	137.9	30.34	76.8	-1.55	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	189	37.8	105	0.35	
LC0023	154.4	14.7	86	-0.93	
LC0024	188	18.8	105	0.31	
LC0025	243.5	51.14	136	2.37	
LC0026	284	43.5	158	3.88	H
LC0027	143	32	79.6	-1.36	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	139	28	77.4	-1.51	
LC0030	20	4	11.1	-5.92	H
LC0031	186	23	104	0.24	
LC0032	174.36	17.87	97.1	-0.19	
LC0033	295.9	31.8	165	4.32	H
LC0034	128.6	8.68	71.6	-1.89	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Phenanthrene

Characteristics of parameter


	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	190 ± 38.8	180 ± 20.5 ng/l
Minimum	20	129 ng/l
Maximum	412	274 ng/l
Standard deviation	68.5	33.5 ng/l
rel. standard deviation	36	18.7 %
n	28	24 -

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Phenanthrene


Graphical presentation of results

Results

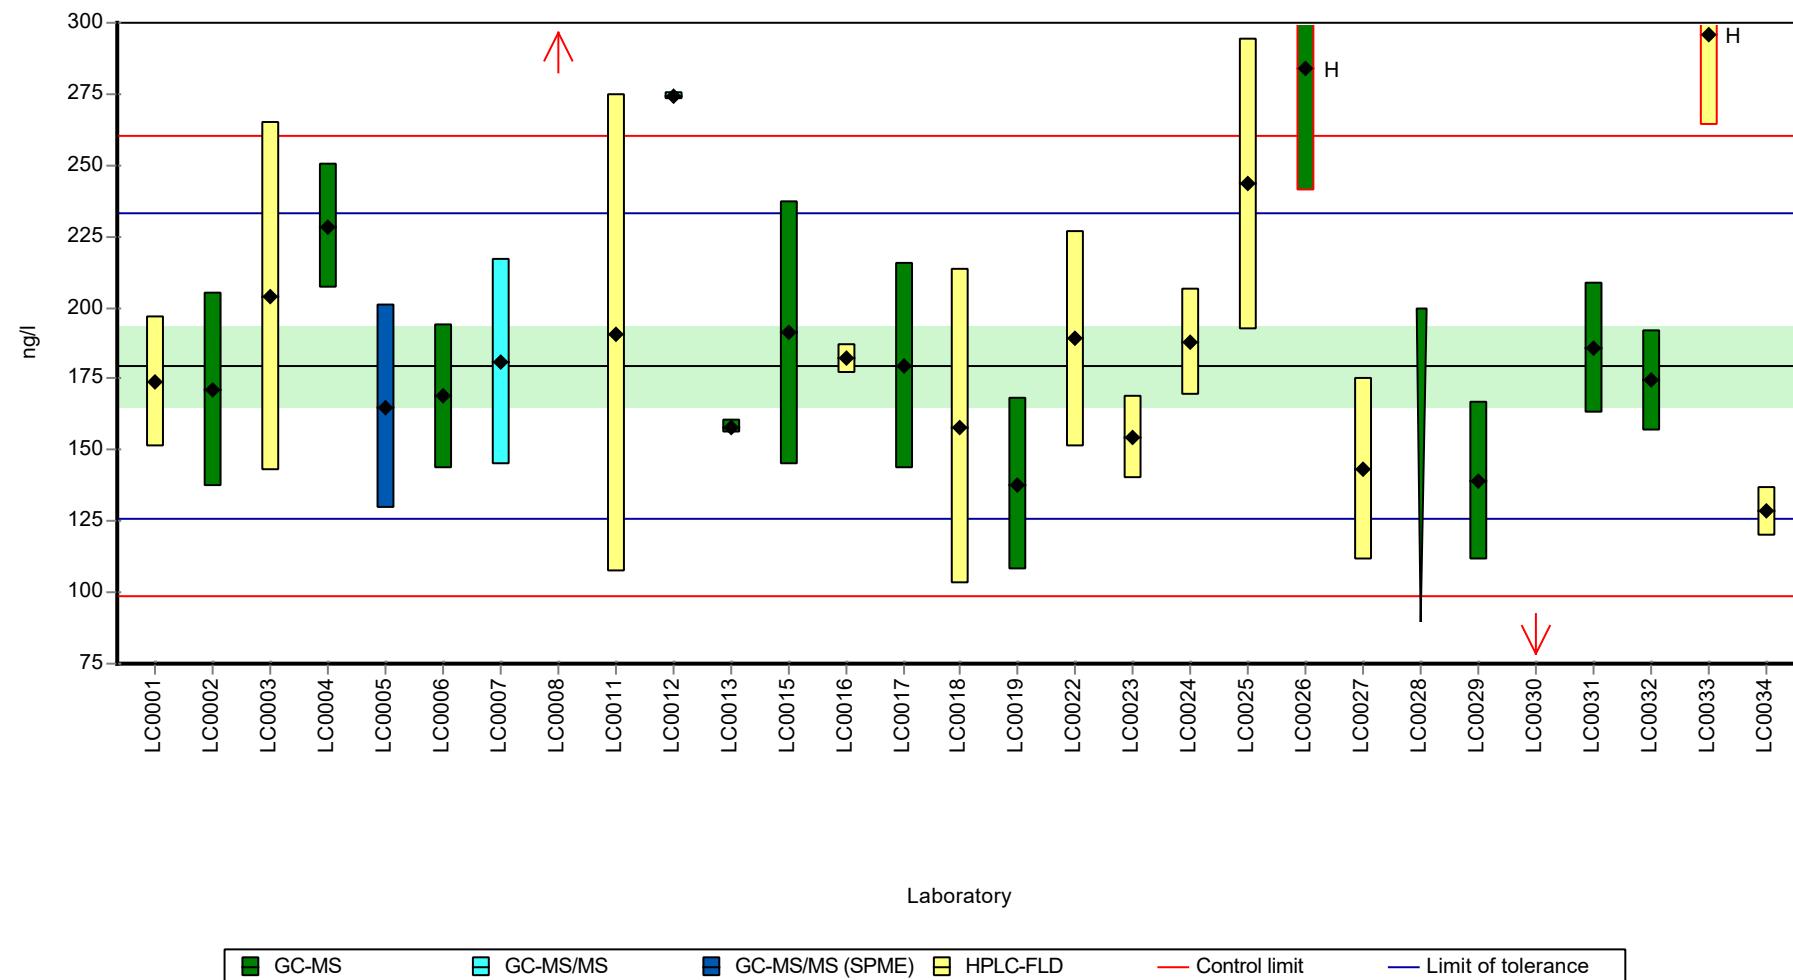


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Phenanthrene

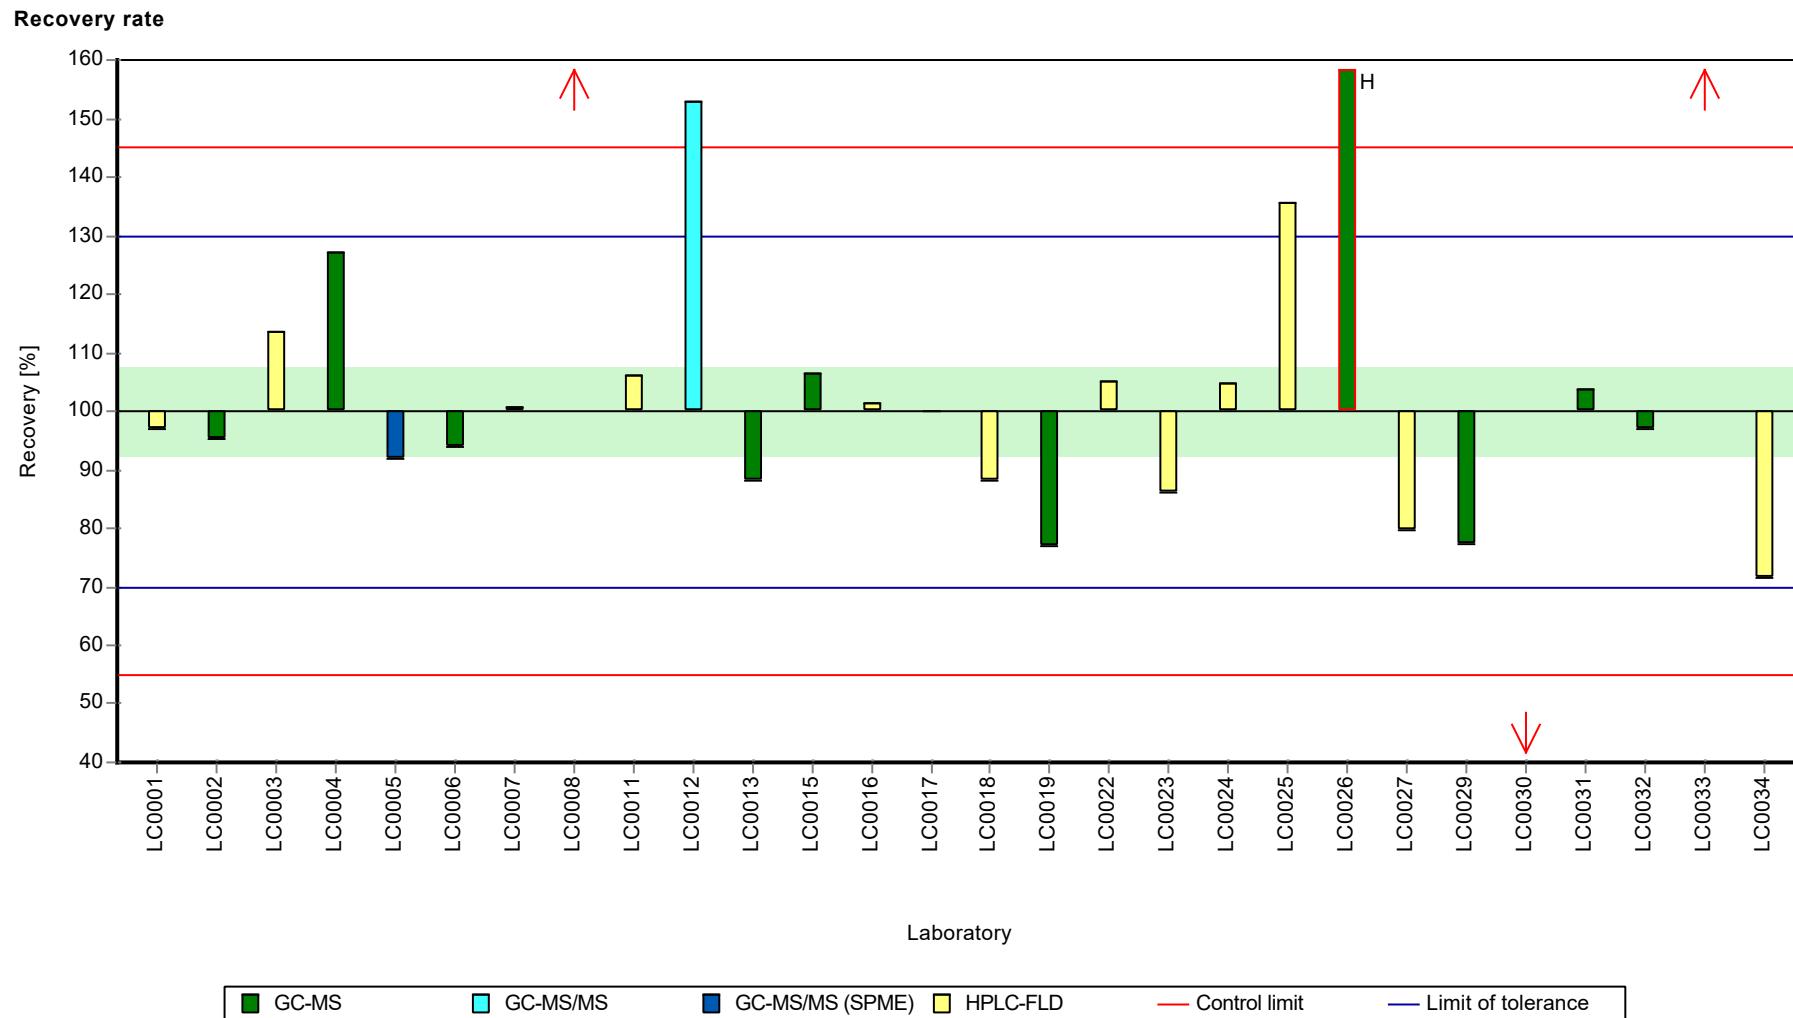

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Phenanthrene

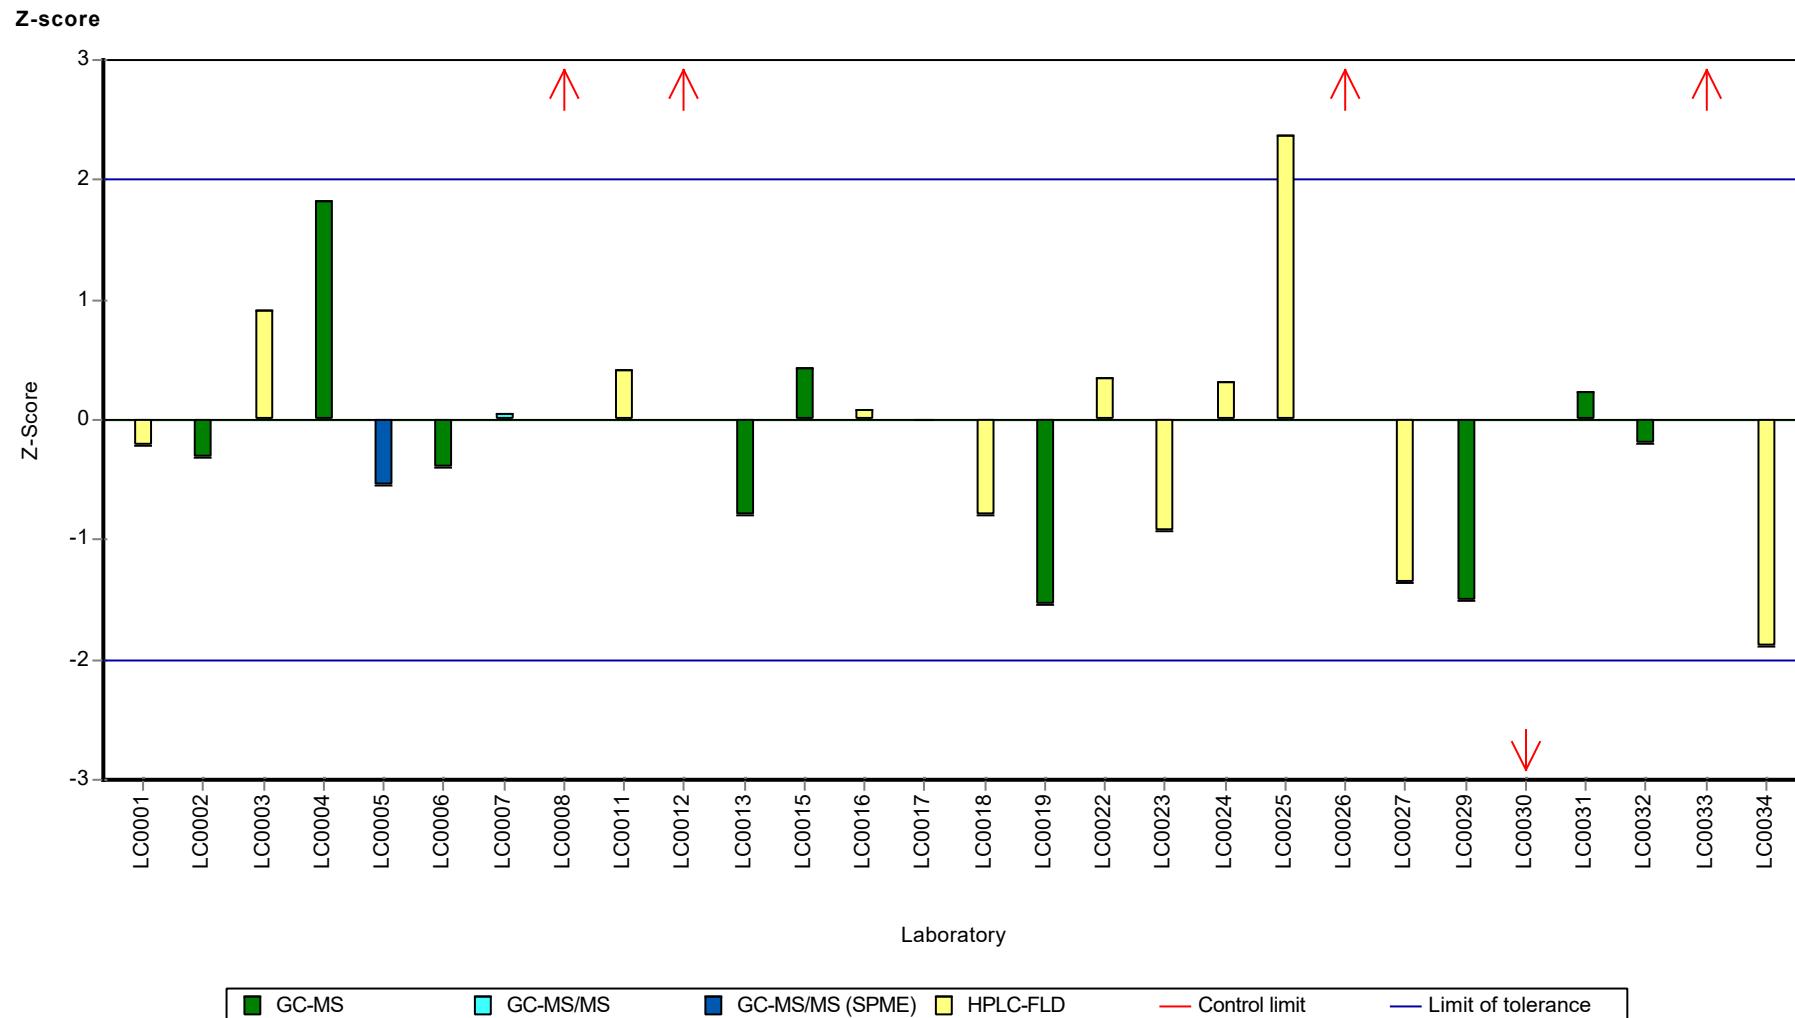

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24A, Parameter: Pyrene

Parameter oriented report

P24A

Pyrene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 25.4 \pm 1.57
 Criterion 4.06 (16 %)
 Minimum - Maximum 17.3 - 34.6
 Control test value \pm U (k=2) 29.9 \pm 7.47

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	28.6	3.7	113	0.79	
LC0002	25.1	5	98.8	-0.07	
LC0003	31	9.3	122	1.38	
LC0004	29.75	3	117	1.07	
LC0005	21.9	4.8	86.2	-0.86	
LC0006	28.55	4.283	112	0.77	
LC0007	21	4	82.7	-1.08	
LC0008	26.6	0.53	105	0.29	
LC0009	21.4	9.4	84.2	-0.99	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	39.86	17.54	157	3.56	H
LC0012	58.54	2.14	230	8.15	H
LC0013	27.51	0.8	108	0.52	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	24	6	94.5	-0.35	
LC0016	27.2	0.98	107	0.44	
LC0017	34.6	6.9	136	2.26	
LC0018	24.1	8.44	94.9	-0.32	
LC0019	3.02	0.66	11.9	-5.51	H
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	28.7	5.7	113	0.81	
LC0023	27.43	5.7	108	0.5	
LC0024	26.6	2.7	105	0.29	
LC0025	21.7	4.56	85.4	-0.91	
LC0026	24.8	0.844	97.6	-0.15	
LC0027	22	4.8	86.6	-0.84	
LC0028	< 200 (LOQ)	-	-	-	
LC0029	17.3	3.5	68.1	-1.99	
LC0030	< 10 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0031	26.6	3.5	105	0.29	
LC0032	26.98	2.4	106	0.39	
LC0033	21.8	1.8	85.8	-0.89	
LC0034	19.9	1.46	78.3	-1.35	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24A, Parameter: Pyrene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	26.3 ± 5.07	25.4 ± 2.36 ng/l
Minimum	3.02	17.3 ng/l
Maximum	58.5	34.6 ng/l
Standard deviation	8.94	3.93 ng/l
rel. standard deviation	34	15.5 %
n	28	25 -


Graphical presentation of results

Results

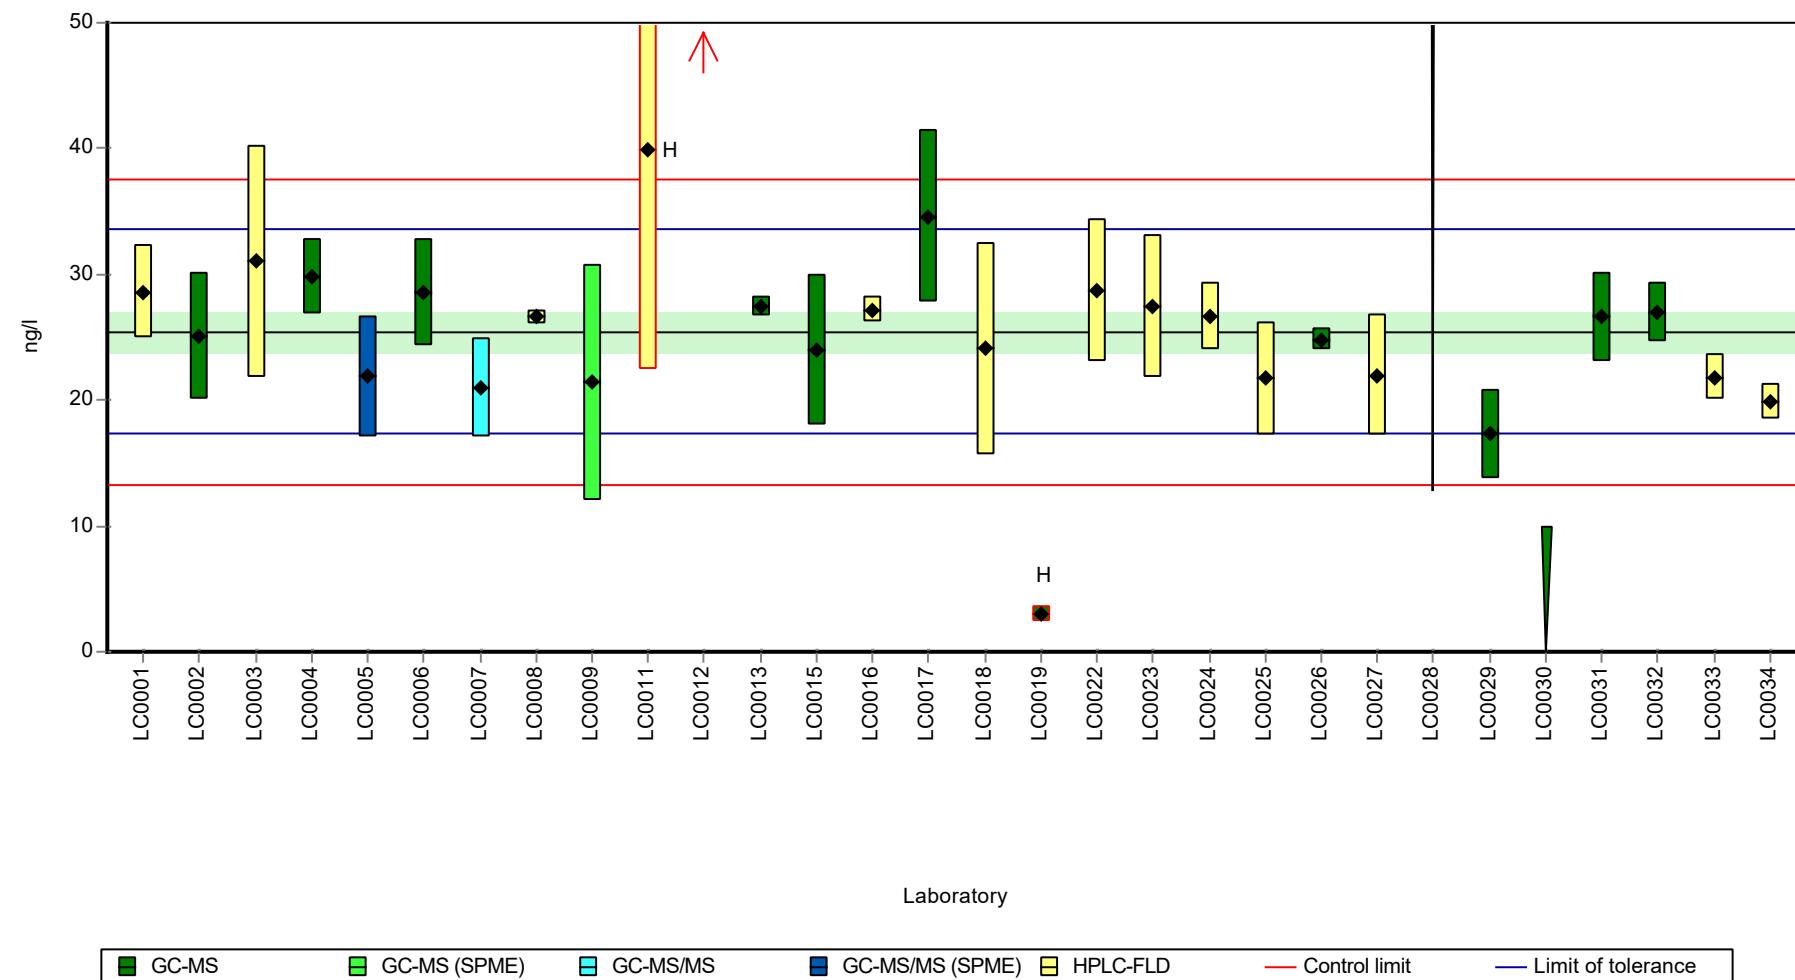


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Pyrene

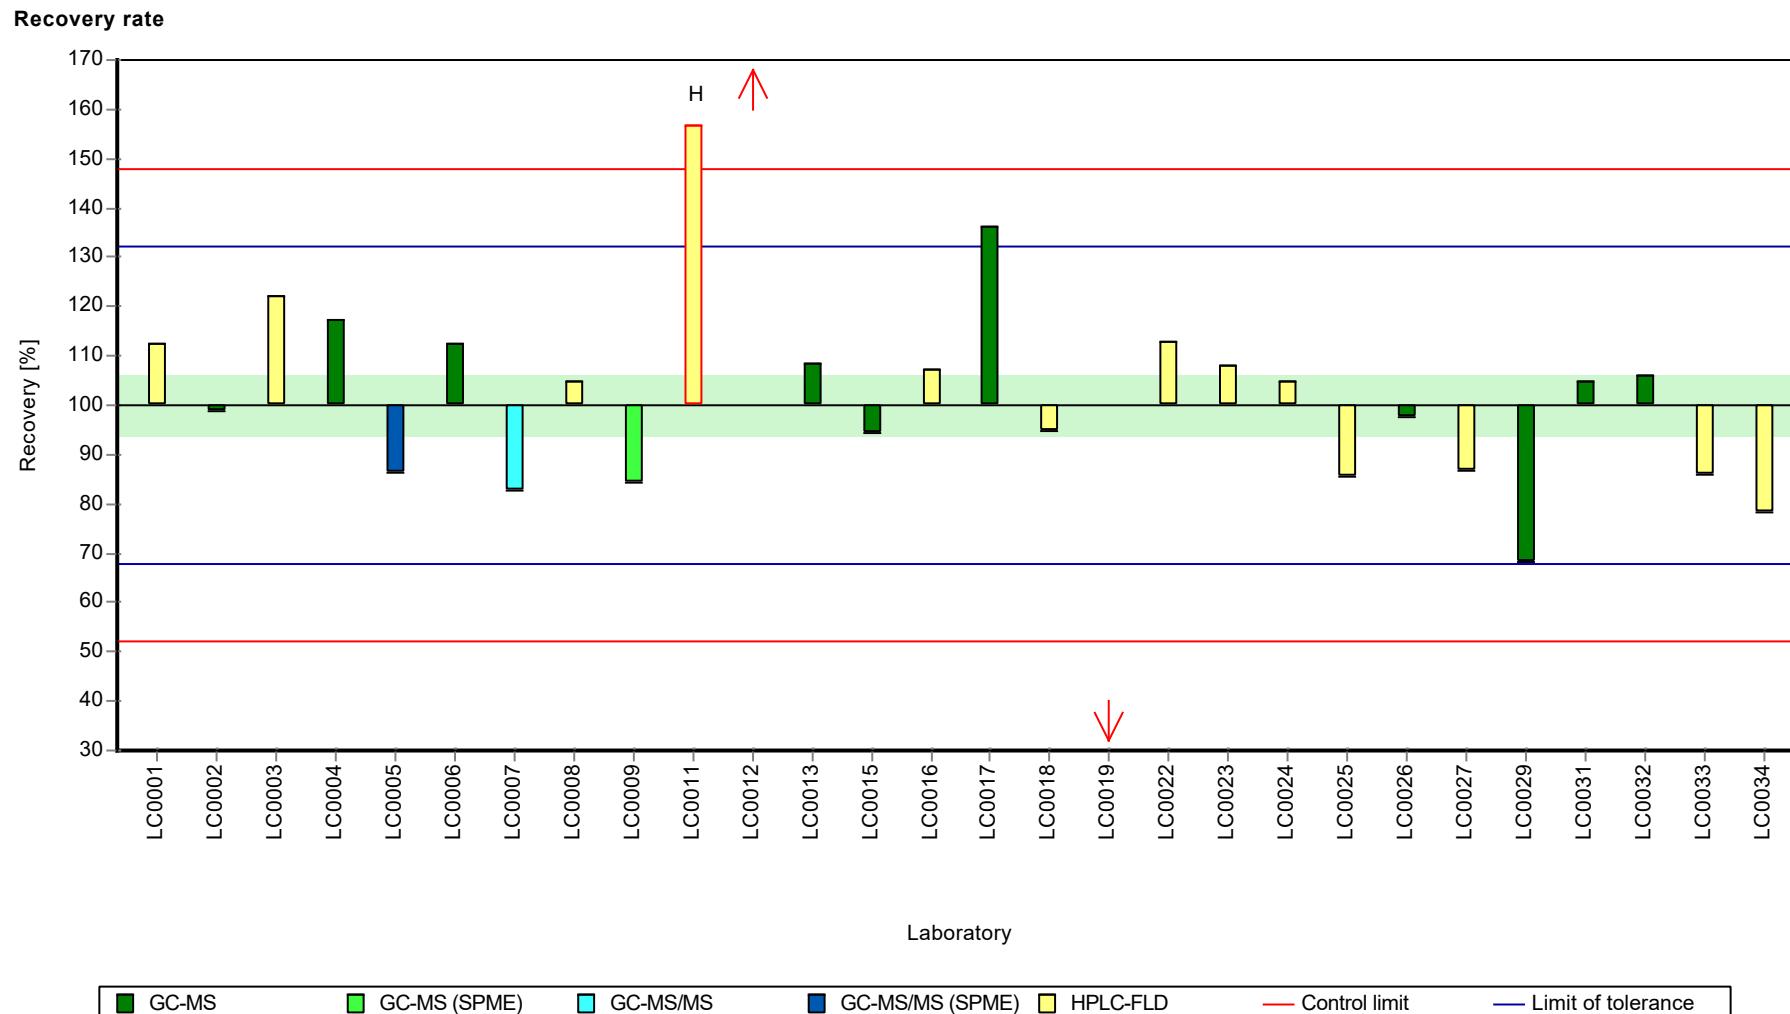

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24A, Parameter: Pyrene

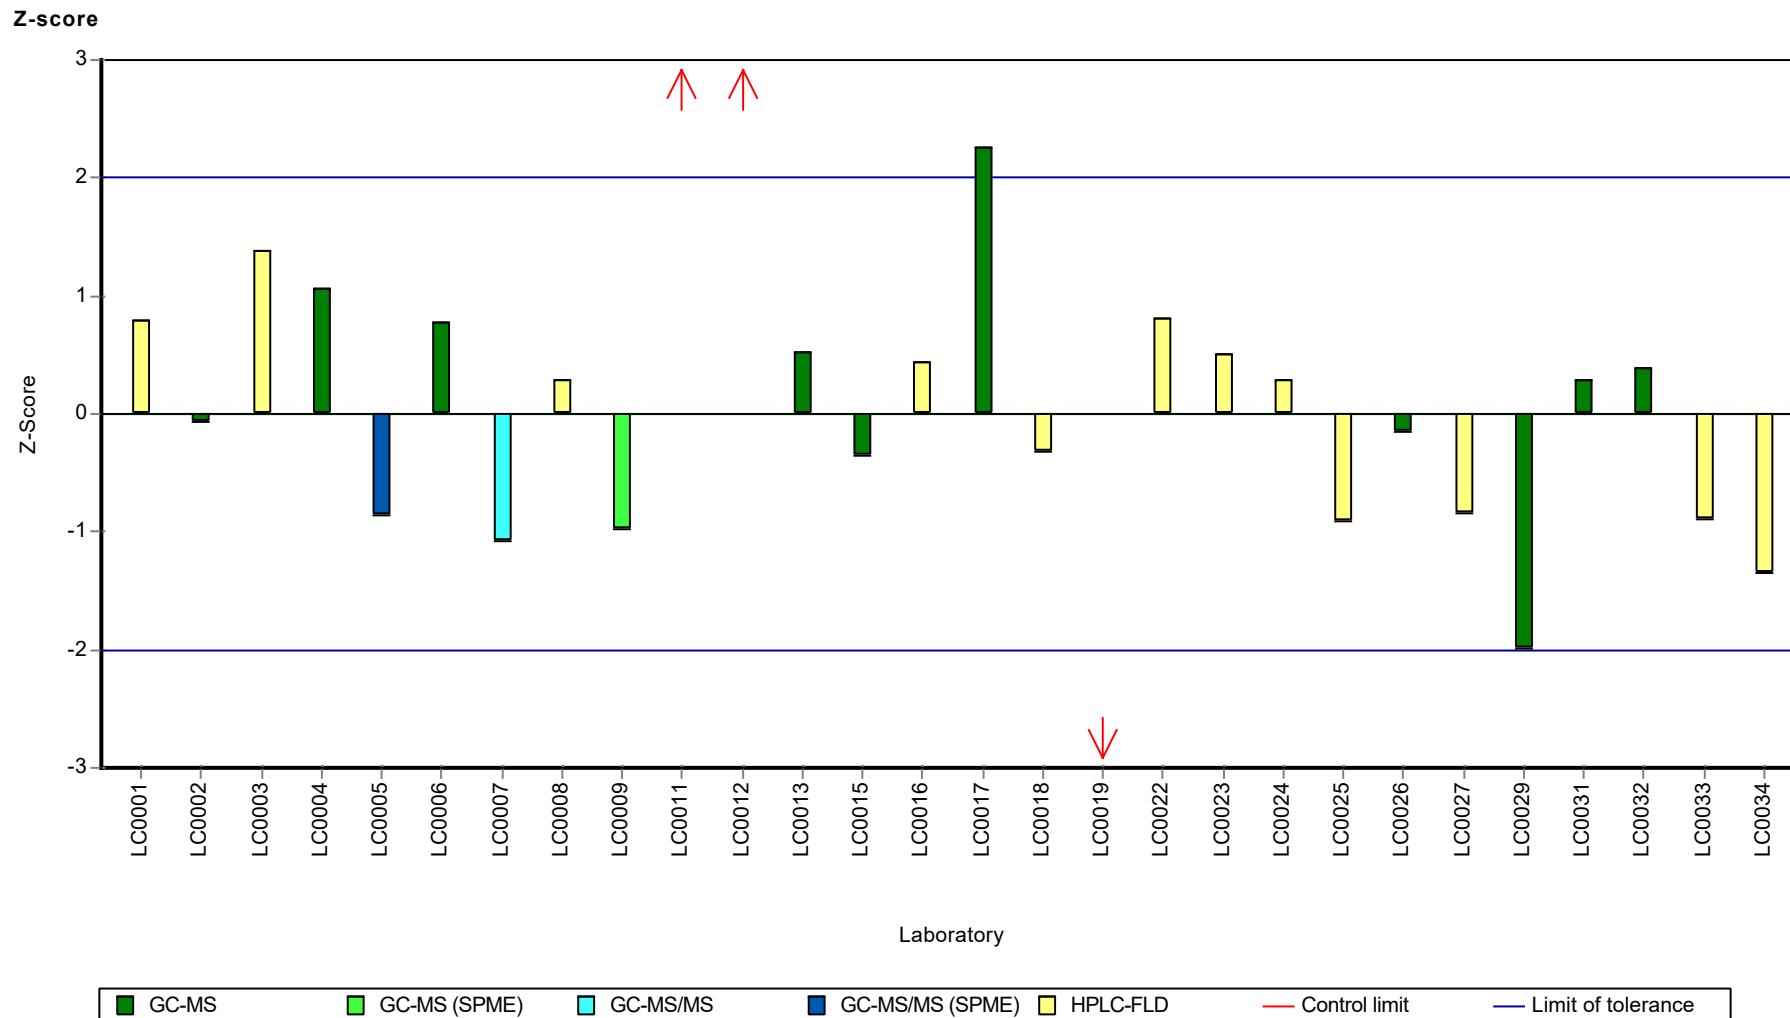

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic

Sample: P24B, Parameter: Pyrene

Parameter oriented report

P24 B

Pyrene

Unit ng/l
 Assigned value \pm U (k=2) 179 \pm 8.09
 Criterion 28.7 (16 %)
 Minimum - Maximum 141 - 213
 Control test value \pm U (k=2) 208.0 \pm 52.1

Labcode	Result	\pm U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	191	25	107	0.41	
LC0002	174	35	97	-0.19	
LC0003	186	55.8	104	0.23	
LC0004	212.57	21	119	1.16	
LC0005	155	34	86.4	-0.85	
LC0006	176.98	26.547	98.7	-0.08	
LC0007	191	38	107	0.41	
LC0008	362	13	202	6.37	H
LC0009	157.7	69.4	87.9	-0.75	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	202.21	88.971	113	0.8	
LC0012	449.25	2.14	251	9.41	H
LC0013	181.4	3.73	101	0.07	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	187	45	104	0.27	
LC0016	201	3.9	112	0.76	
LC0017	185.3	37.1	103	0.21	
LC0018	174	60.9	97	-0.19	
LC0019	168.92	37.16	94.2	-0.36	
LC0020	-	-	-	-	
LC0021	-	-	-	-	
LC0022	206	41.2	115	0.93	
LC0023	144.7	23.8	80.7	-1.21	
LC0024	199.5	20	111	0.7	
LC0025	165.5	34.76	92.3	-0.48	
LC0026	273	27	152	3.27	H
LC0027	149	33	83.1	-1.06	
LC0028	200	26	112	0.72	
LC0029	146	29	81.4	-1.16	
LC0030	21	4.2	11.7	-5.52	H
LC0031	196	26	109	0.58	
LC0032	192.11	17.095	107	0.45	
LC0033	178.5	14.5	99.5	-0.03	
LC0034	140.9	10.34	78.6	-1.34	

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic


Sample: P24B, Parameter: Pyrene

Characteristics of parameter

	all results	without outliers Unit
Mean ± CI (99%)	192 ± 38.8	179 ± 12.1 ng/l
Minimum	21	141 ng/l
Maximum	449	213 ng/l
Standard deviation	70.9	20.6 ng/l
rel. standard deviation	36.9	11.5 %
n	30	26 -


Graphical presentation of results

Results

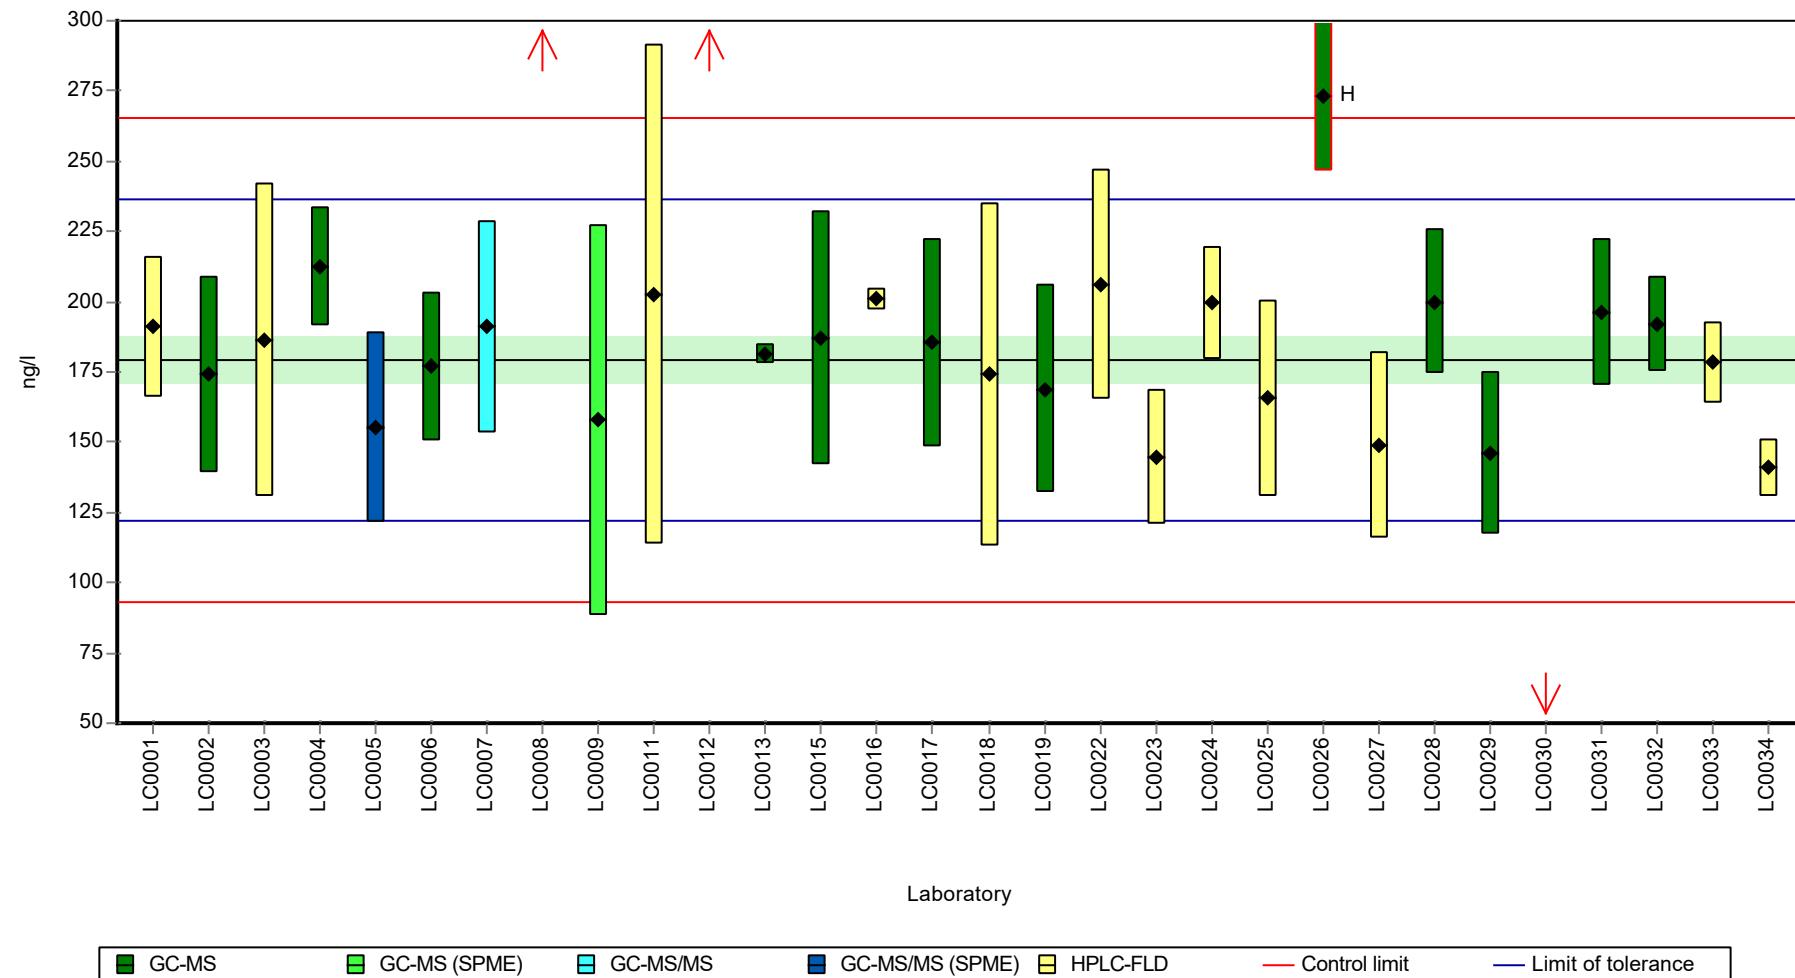


Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Pyrene

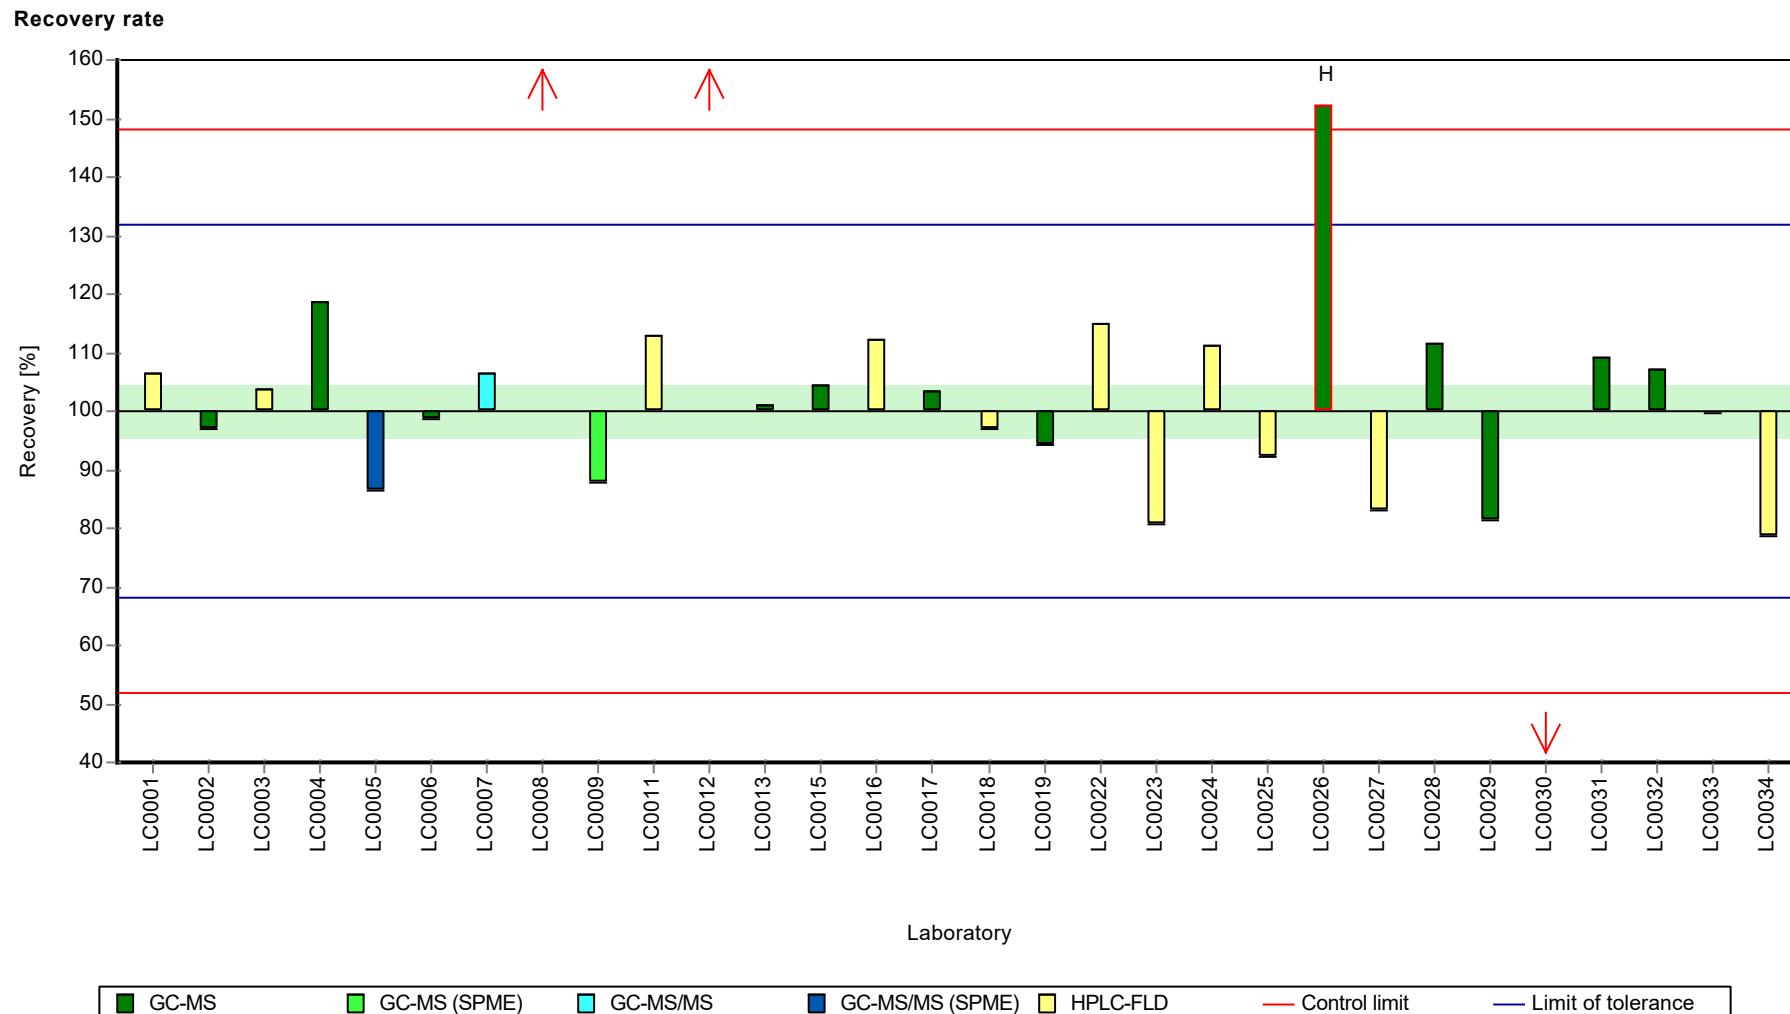

Parameter oriented report Polycyclic Aromatic Hydrocarbons P24

Sample: P24B, Parameter: Pyrene

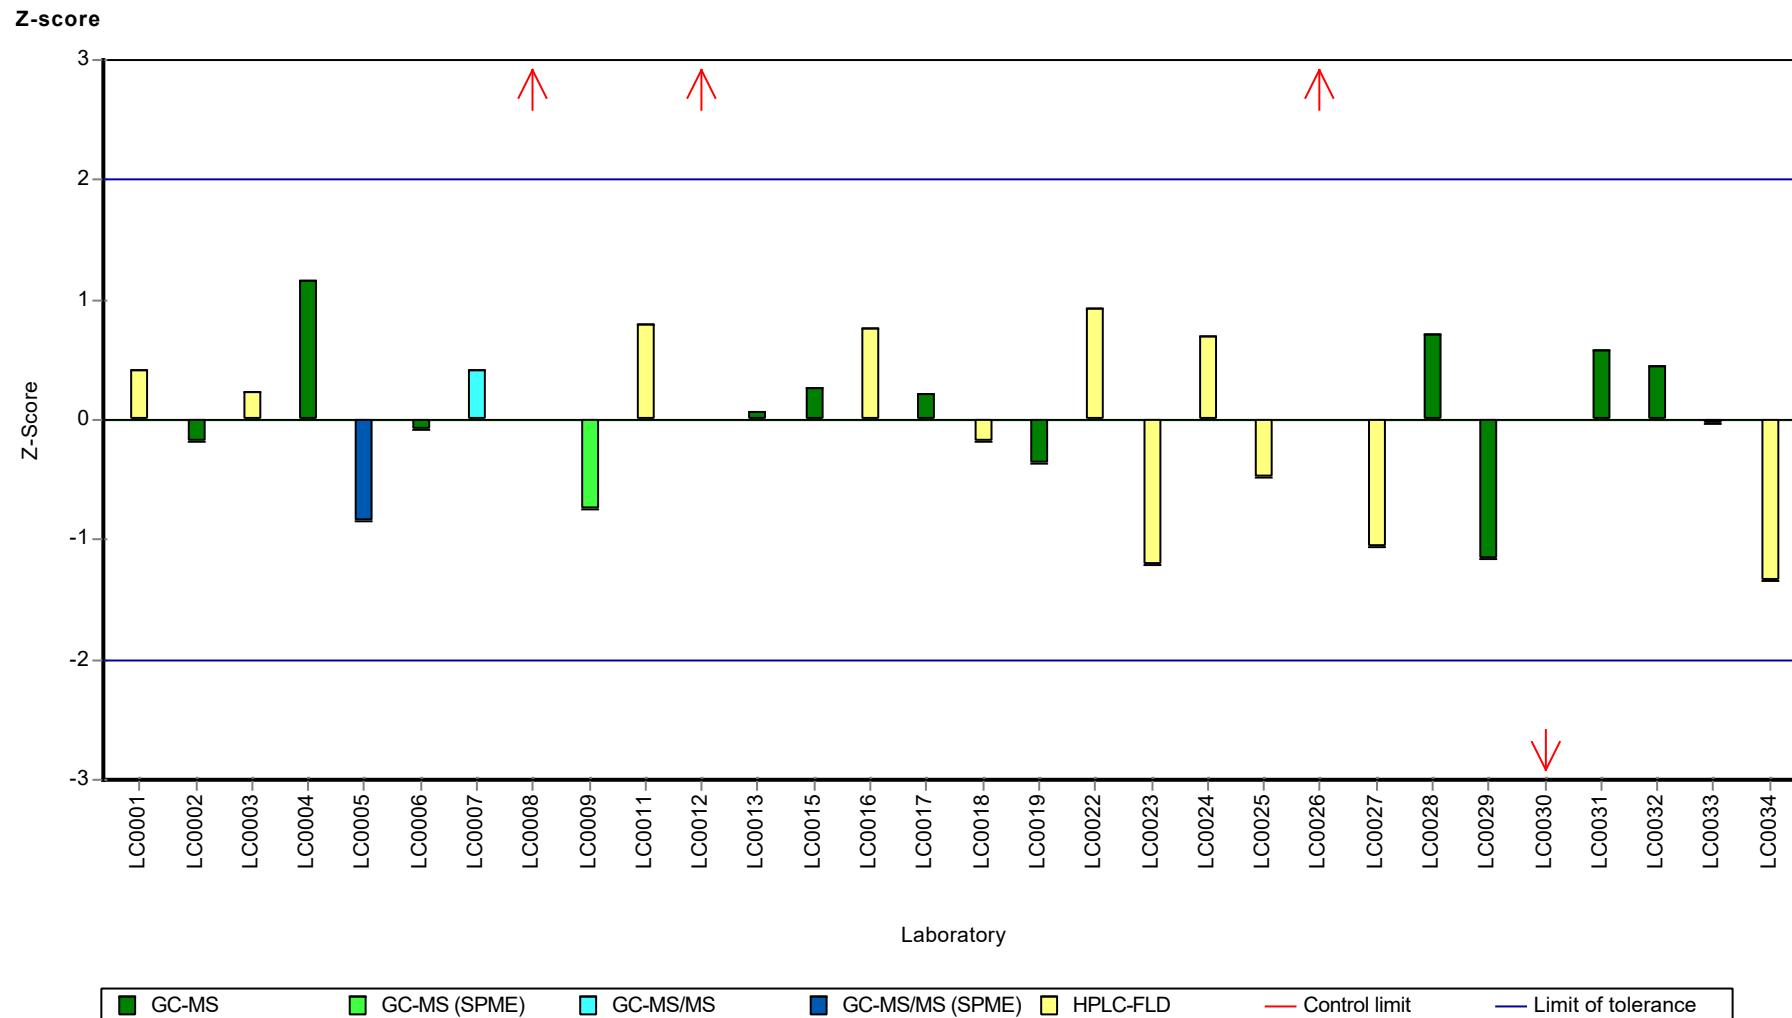

E8. Labororientierte Auswertung / Laboratory oriented report

Die Labororientierte Auswertung ist nach dem Laborcode sortiert.

The laboratory oriented report is sorted by laboratory code.


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	31.2 ± 4.1	5.08	117	0.88
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	162 ± 21	5.89	660	23.34
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 3.2	6.39	101	0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.6 ± 3.2	4.77	108	0.39
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	19.5 ± 2.5	3.78	124	0.99
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	27 ± 3.5	4.05	113	0.79
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.8 ± 3.6	7.43	120	0.62
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.9 ± 3.1	5.61	111	0.41
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	28.4 ± 3.7	5.91	106	0.26
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.7 ± 3.6	7.7	108	0.26
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	29.6 ± 3.8	4.9	109	0.48
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	25.9 ± 3.4	3.83	94.6	-0.38
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	20 ± 2.6	4.23	94.5	-0.27
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	84.8 ± 11	7.6	234	6.40
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.7 ± 3.7	9.18	96.9	-0.10
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.6 ± 3.7	4.06	113	0.79

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	190 ± 25	34.1	106	0.31
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	283 ± 37	34.4	197	4.06
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	207 ± 27	47.2	114	0.54
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	158 ± 21	30.8	108	0.37
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177 ± 23	35.4	120	0.83
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	152 ± 20	23.3	111	0.64
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	196 ± 25	48.6	129	0.91
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	175 ± 23	39.9	114	0.54
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	193 ± 25	39.7	107	0.32
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	175 ± 23	39.2	134	1.13
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194 ± 25	32.3	108	0.44
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	135 ± 18	18.3	103	0.23
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	120 ± 16	20.1	108	0.43

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	463 ± 60	38.3	254 7.32
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	174 ± 23	26.9	96.9 -0.21
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	191 ± 25	28.7	107 0.41

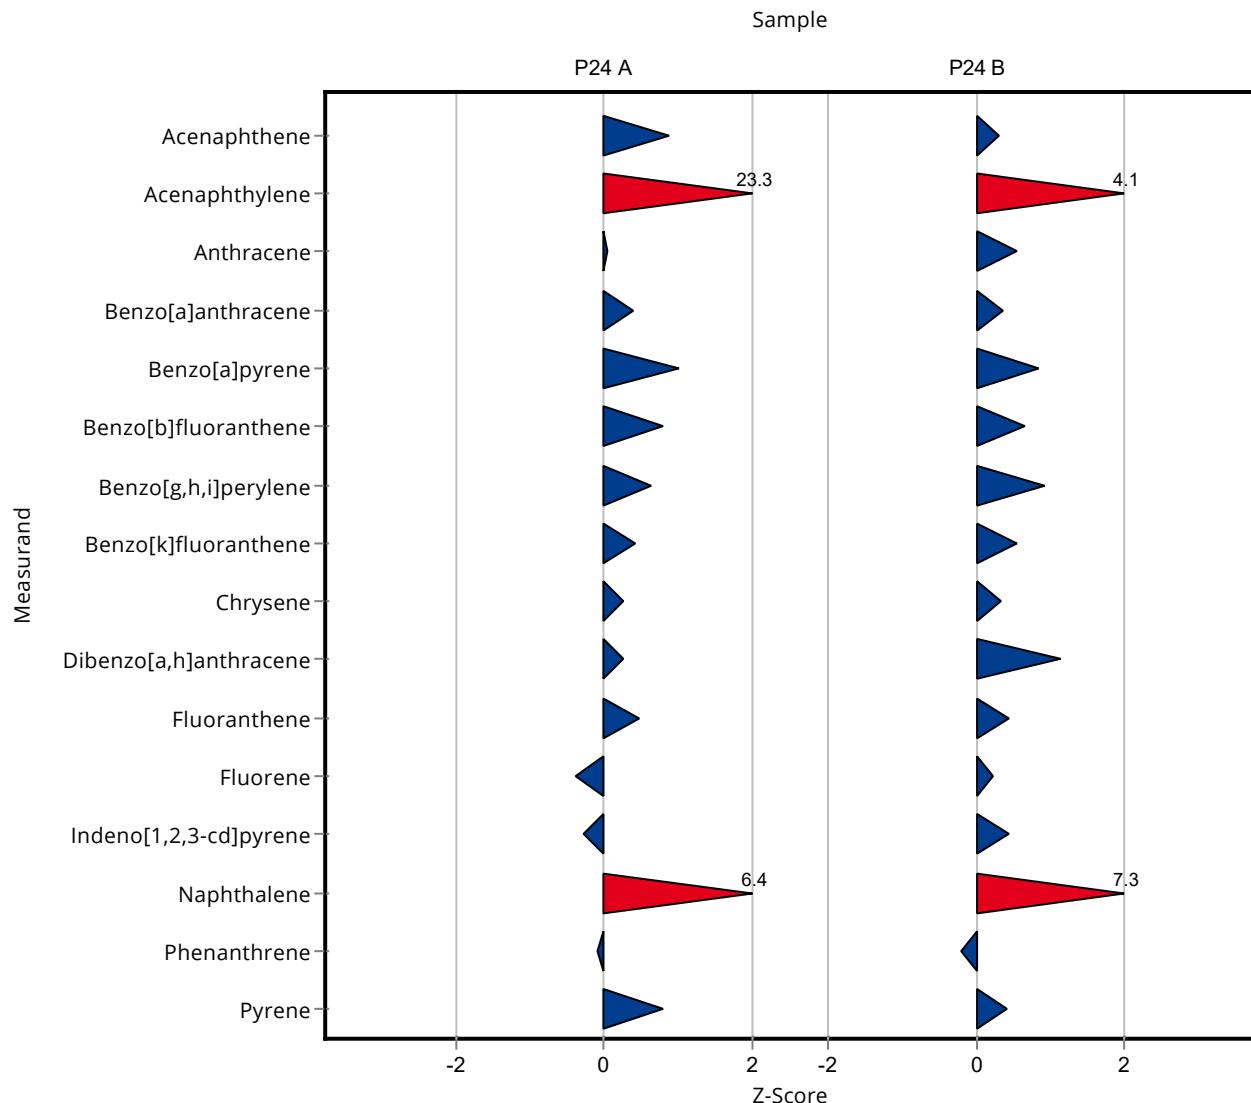


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	31.2 ± 4.1	5.08	117	0.54
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	162 ± 21	5.89	660	3.27
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 3.2	6.39	101	0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.6 ± 3.2	4.77	108	0.28
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	19.5 ± 2.5	3.78	124	0.72
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	27 ± 3.5	4.05	113	0.45
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.8 ± 3.6	7.43	120	0.62
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.9 ± 3.1	5.61	111	0.37
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	28.4 ± 3.7	5.91	106	0.20
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.7 ± 3.6	7.7	108	0.28
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	29.6 ± 3.8	4.9	109	0.31
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	25.9 ± 3.4	3.83	94.6	-0.21
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	20 ± 2.6	4.23	94.5	-0.21
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	84.8 ± 11	7.6	234	2.18
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.7 ± 3.7	9.18	96.9	-0.11
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.6 ± 3.7	4.06	113	0.42

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	190 ± 25	34.1	106	0.20
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	283 ± 37	34.4	197	1.87
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	207 ± 27	47.2	114	0.47
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	158 ± 21	30.8	108	0.27
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177 ± 23	35.4	120	0.63
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	152 ± 20	23.3	111	0.37

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	196 ± 25	48.6	129	0.86
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	175 ± 23	39.9	114	0.46
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	193 ± 25	39.7	107	0.25
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	175 ± 23	39.2	134	0.89
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194 ± 25	32.3	108	0.28
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	135 ± 18	18.3	103	0.11
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	120 ± 16	20.1	108	0.26
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	463 ± 60	38.3	254	2.33
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	174 ± 23	26.9	96.9	-0.12
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	191 ± 25	28.7	107	0.23

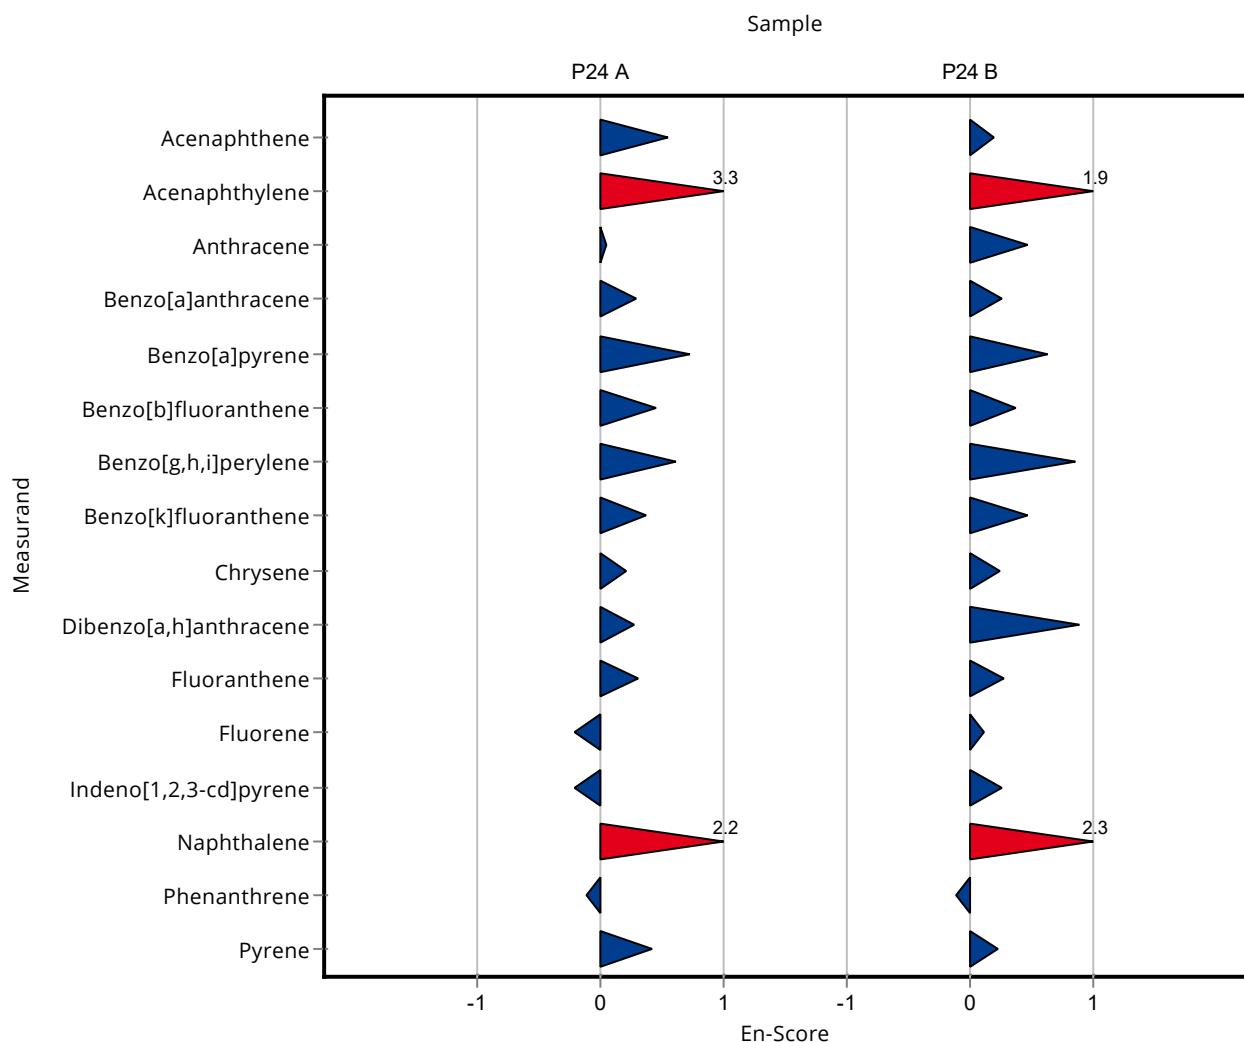


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.6 ± 5.3	5.08	99.6	-0.02
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.4 ± 5.7	5.89	116	0.65
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 5	6.39	101	0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.2 ± 4.4	4.77	97.6	-0.11
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15.4 ± 3.9	3.78	97.8	-0.09
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23 ± 5.8	4.05	96.7	-0.20
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.6 ± 5.9	7.43	102	0.05
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	20.5 ± 5.1	5.61	95	-0.19
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	25.8 ± 5.2	5.91	96	-0.18
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.5 ± 6.1	7.7	95.5	-0.15
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	26 ± 5.2	4.9	95.5	-0.25
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27.2 ± 5.4	3.83	99.4	-0.04
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.4 ± 6.1	4.23	115	0.77
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33.7 ± 6.7	7.6	93.1	-0.33
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28 ± 5.6	9.18	94.6	-0.18
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	25.1 ± 5	4.06	98.8	-0.07

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	158 ± 32	34.1	88	-0.63
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	147 ± 29	34.4	103	0.11
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	179 ± 36	47.2	98.6	-0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	139 ± 28	30.8	94.8	-0.25
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	148 ± 37	35.4	100	0.02
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	125 ± 31	23.3	91.2	-0.52
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	163 ± 41	48.6	107	0.23
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	138 ± 35	39.9	90	-0.38
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	172 ± 34	39.7	95.4	-0.21
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	145 ± 36	39.2	111	0.37
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	176 ± 35	32.3	98	-0.11
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	119 ± 24	18.3	91	-0.64
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	127 ± 32	20.1	114	0.78

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	182 ± 36	38.3	99.8
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	171 ± 34	26.9	95.2
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	174 ± 35	28.7	97

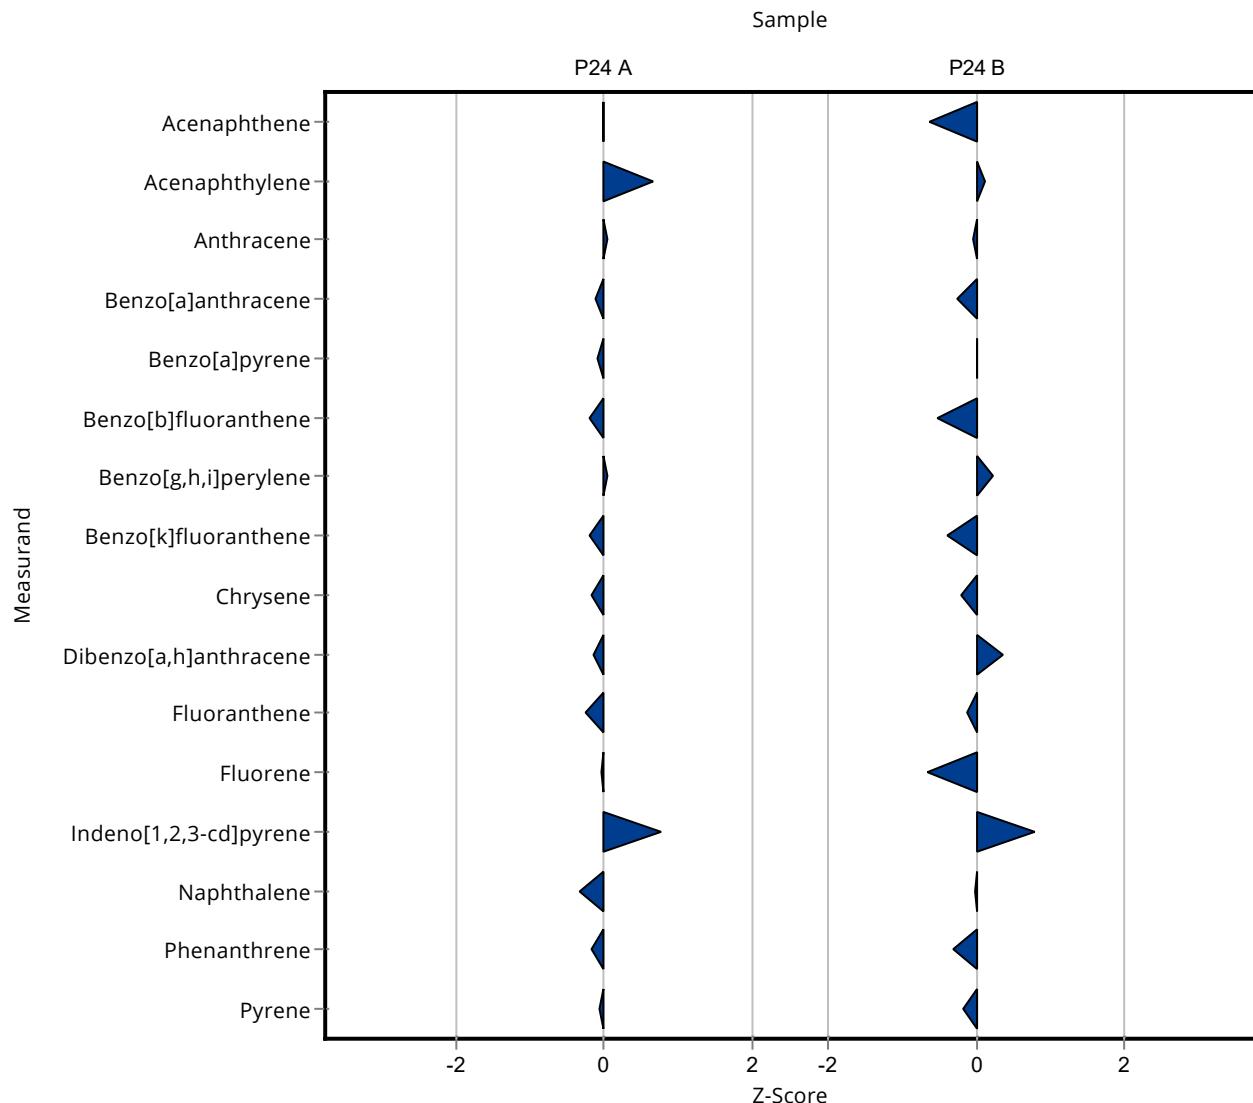


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.6 ± 5.3	5.08	99.6	-0.01
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.4 ± 5.7	5.89	116	0.33
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 5	6.39	101	0.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.2 ± 4.4	4.77	97.6	-0.06
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15.4 ± 3.9	3.78	97.8	-0.04
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23 ± 5.8	4.05	96.7	-0.07
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.6 ± 5.9	7.43	102	0.03
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	20.5 ± 5.1	5.61	95	-0.11
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	25.8 ± 5.2	5.91	96	-0.10
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.5 ± 6.1	7.7	95.5	-0.09
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	26 ± 5.2	4.9	95.5	-0.12
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27.2 ± 5.4	3.83	99.4	-0.02
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.4 ± 6.1	4.23	115	0.26
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33.7 ± 6.7	7.6	93.1	-0.18
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28 ± 5.6	9.18	94.6	-0.14
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	25.1 ± 5	4.06	98.8	-0.03

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	158 ± 32	34.1	88	-0.33
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	147 ± 29	34.4	103	0.06
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	179 ± 36	47.2	98.6	-0.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	139 ± 28	30.8	94.8	-0.13
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	148 ± 37	35.4	100	0.01
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	125 ± 31	23.3	91.2	-0.19

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	163 ± 41	48.6	107	0.13
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	138 ± 35	39.9	90	-0.22
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	172 ± 34	39.7	95.4	-0.12
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	145 ± 36	39.2	111	0.19
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	176 ± 35	32.3	98	-0.05
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	119 ± 24	18.3	91	-0.24
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	127 ± 32	20.1	114	0.24
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	182 ± 36	38.3	99.8	-0.01
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	171 ± 34	26.9	95.2	-0.12
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	174 ± 35	28.7	97	-0.08

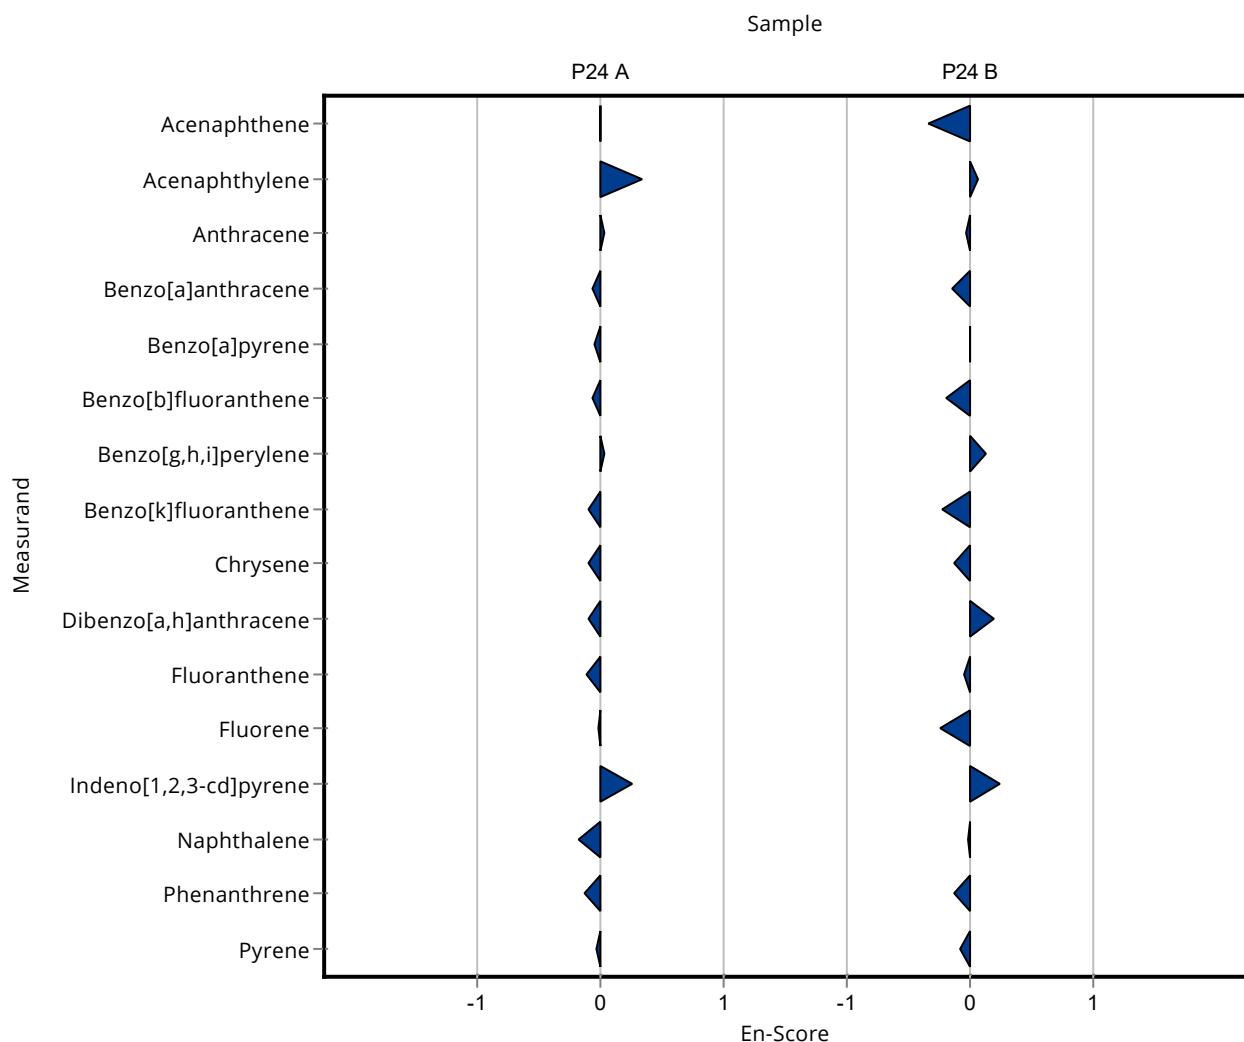


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.5 ± 7.94	5.08	99.2	-0.04
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	21.8 ± 6.53	5.89	88.8	-0.47
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.2 ± 7.56	6.39	102	0.09
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.9 ± 6.57	4.77	96.3	-0.18
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16.8 ± 5.04	3.78	107	0.28
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23.8 ± 7.13	4.05	100	0.00
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	25.8 ± 7.74	7.43	111	0.35
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.5 ± 6.45	5.61	99.6	-0.01
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	26.4 ± 7.92	5.91	98.2	-0.08
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.5 ± 8.24	7.7	107	0.24
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	32.2 ± 9.66	4.9	118	1.01
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.4 ± 8.81	3.83	107	0.53
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	19.1 ± 5.72	4.23	90.3	-0.49
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.7 ± 11.3	7.6	104	0.20
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	49.7 ± 14.9	9.18	168	2.19
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	31 ± 9.3	4.06	122	1.38

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	181 ± 54.2	34.1	101	0.04
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	141 ± 42.3	34.4	98.4	-0.07
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	187 ± 56	47.2	103	0.12
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	146 ± 43.7	30.8	99.6	-0.02
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	148 ± 44.3	35.4	100	0.02
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	138 ± 41.4	23.3	101	0.04
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	125 ± 37.5	48.6	82.3	-0.55
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	152 ± 45.6	39.9	99.2	-0.03
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	178 ± 53.3	39.7	98.7	-0.06
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	96.3 ± 28.9	39.2	73.8	-0.87
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	189 ± 56.7	32.3	105	0.29
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	131 ± 39.2	18.3	100	0.01
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	109 ± 32.8	20.1	97.9	-0.12

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	159 ± 47.7	38.3	87.2 -0.61
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	204 ± 61.2	26.9	114 0.91
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	186 ± 55.8	28.7	104 0.23

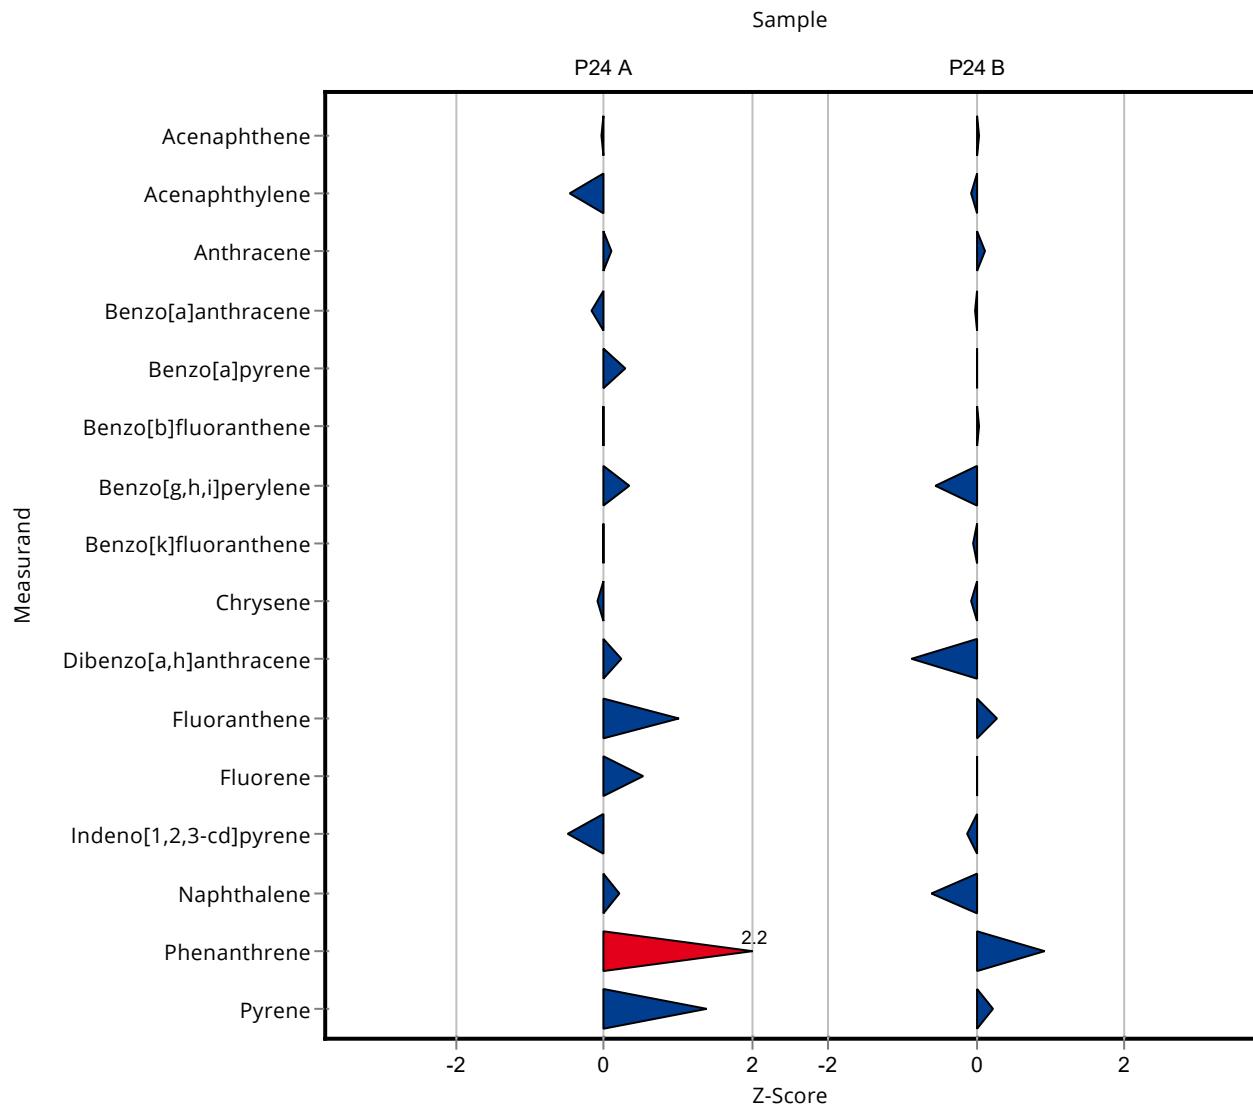


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.5 ± 7.94	5.08	99.2	-0.01
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	21.8 ± 6.53	5.89	88.8	-0.21
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.2 ± 7.56	6.39	102	0.04
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.9 ± 6.57	4.77	96.3	-0.06
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16.8 ± 5.04	3.78	107	0.10
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23.8 ± 7.13	4.05	100	0.00
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	25.8 ± 7.74	7.43	111	0.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.5 ± 6.45	5.61	99.6	-0.01
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	26.4 ± 7.92	5.91	98.2	-0.03
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.5 ± 8.24	7.7	107	0.11
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	32.2 ± 9.66	4.9	118	0.26
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.4 ± 8.81	3.83	107	0.12
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	19.1 ± 5.72	4.23	90.3	-0.18
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.7 ± 11.3	7.6	104	0.07
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	49.7 ± 14.9	9.18	168	0.67
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	31 ± 9.3	4.06	122	0.30

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	181 ± 54.2	34.1	101	0.01
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	141 ± 42.3	34.4	98.4	-0.03
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	187 ± 56	47.2	103	0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	146 ± 43.7	30.8	99.6	-0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	148 ± 44.3	35.4	100	0.01
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	138 ± 41.4	23.3	101	0.01

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	125 ± 37.5	48.6	82.3	-0.35
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	152 ± 45.6	39.9	99.2	-0.01
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	178 ± 53.3	39.7	98.7	-0.02
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	96.3 ± 28.9	39.2	73.8	-0.56
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	189 ± 56.7	32.3	105	0.08
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	131 ± 39.2	18.3	100	0.00
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	109 ± 32.8	20.1	97.9	-0.04
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	159 ± 47.7	38.3	87.2	-0.24
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	204 ± 61.2	26.9	114	0.20
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	186 ± 55.8	28.7	104	0.06

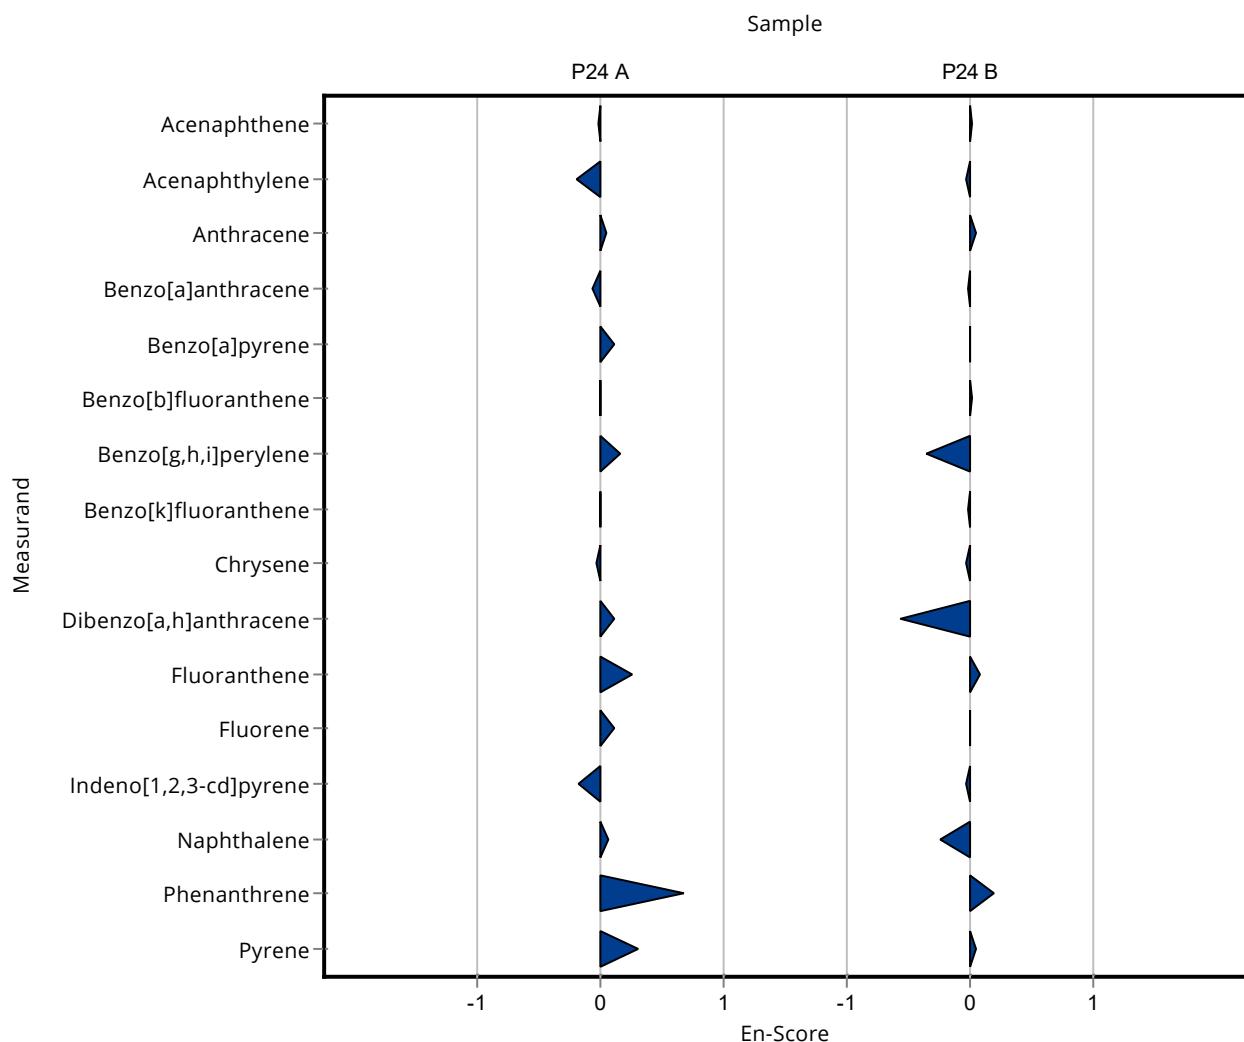


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.6 ± 3	5.08	103	0.17
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.71 ± 3	5.89	109	0.37
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	26.09 ± 3	6.39	106	0.23
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	25.22 ± 2.5	4.77	111	0.52
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.67 ± 2	3.78	112	0.51
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	31.06 ± 3	4.05	131	1.80
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.96 ± 2	7.43	103	0.10
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.4 ± 2	5.61	108	0.32
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	26.55 ± 2.5	5.91	98.8	-0.06
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.48 ± 2	7.7	91.5	-0.28
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.65 ± 3	4.9	116	0.90
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	28.86 ± 3	3.83	105	0.39
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.34 ± 2.5	4.23	110	0.52
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.25 ± 4	7.6	122	1.06
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	45.99 ± 4.5	9.18	155	1.78
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	29.75 ± 3	4.06	117	1.07

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	190.61 ± 19	34.1	106	0.32
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	148.67 ± 15	34.4	104	0.15
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	204.37 ± 20	47.2	113	0.49
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	190.11 ± 19	30.8	130	1.41
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	194.11 ± 19	35.4	132	1.32
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	191.75 ± 19	23.3	140	2.35
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	198.79 ± 20	48.6	131	0.97
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	184.26 ± 18	39.9	120	0.78
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	204.55 ± 20	39.7	113	0.61
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	182.96 ± 18	39.2	140	1.34
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	212.75 ± 21	32.3	118	1.02
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	141.26 ± 14	18.3	108	0.57
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	147.26 ± 14	20.1	132	1.79

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]		z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	190.18 ± 19	38.3	104	0.20
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	228.56 ± 22	26.9	127	1.82
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	212.57 ± 21	28.7	119	1.16

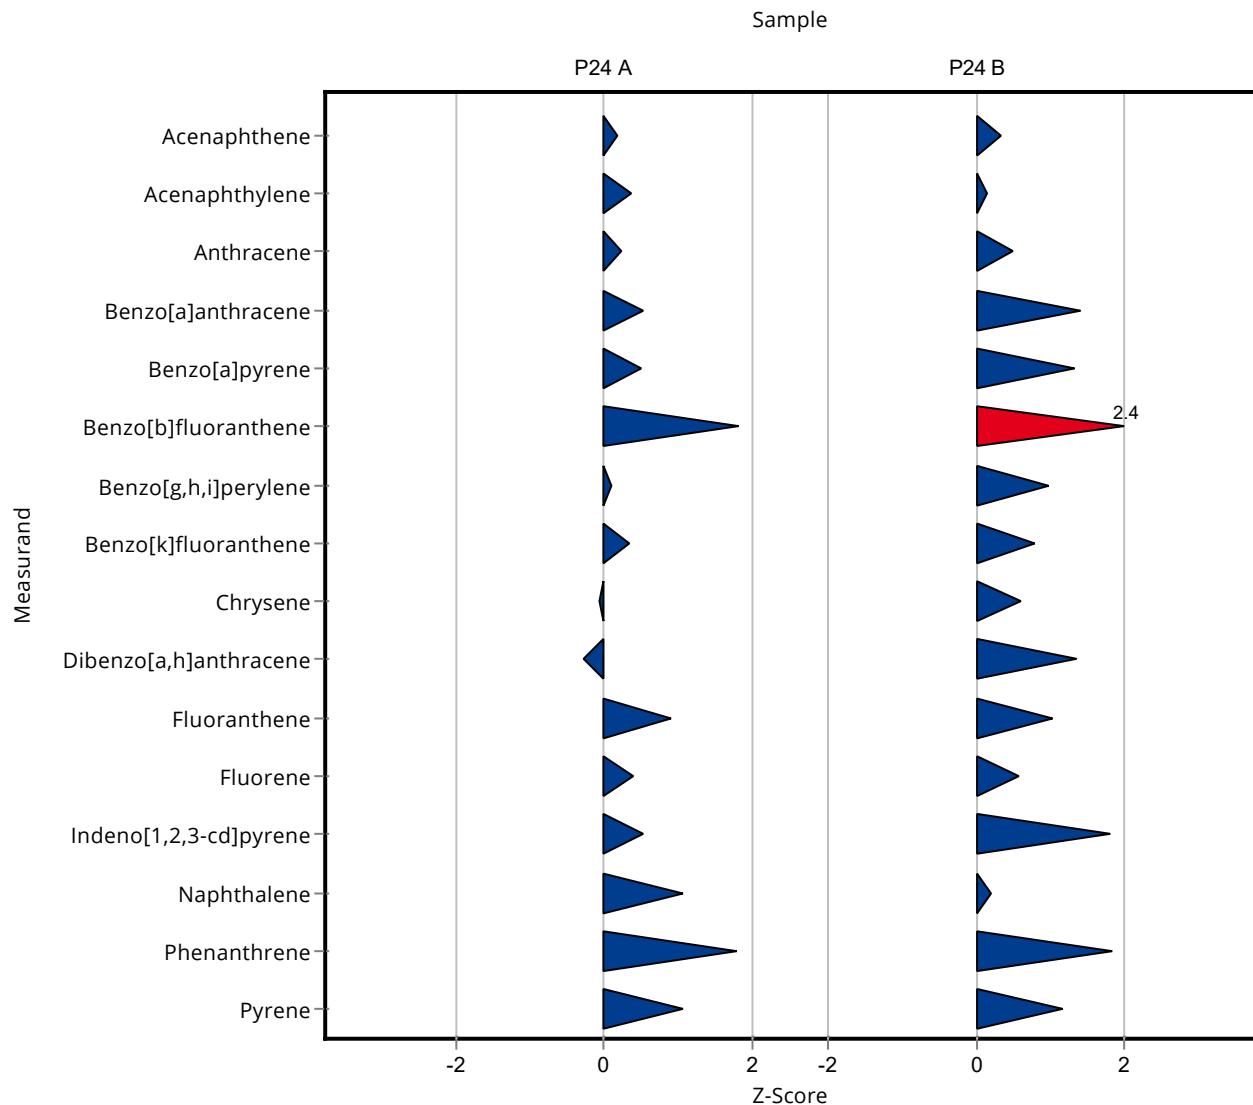


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.6 ± 3	5.08	103	0.14
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.71 ± 3	5.89	109	0.33
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	26.09 ± 3	6.39	106	0.25
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	25.22 ± 2.5	4.77	111	0.48
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.67 ± 2	3.78	112	0.45
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	31.06 ± 3	4.05	131	1.17
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.96 ± 2	7.43	103	0.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.4 ± 2	5.61	108	0.44
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	26.55 ± 2.5	5.91	98.8	-0.06
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.48 ± 2	7.7	91.5	-0.51
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.65 ± 3	4.9	116	0.71
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	28.86 ± 3	3.83	105	0.24
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.34 ± 2.5	4.23	110	0.42
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.25 ± 4	7.6	122	0.92
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	45.99 ± 4.5	9.18	155	1.69
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	29.75 ± 3	4.06	117	0.70

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	190.61 ± 19	34.1	106	0.28
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	148.67 ± 15	34.4	104	0.17
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	204.37 ± 20	47.2	113	0.56
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	190.11 ± 19	30.8	130	1.12
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	194.11 ± 19	35.4	132	1.20
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	191.75 ± 19	23.3	140	1.41

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	198.79 ± 20	48.6	131	1.13
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	184.26 ± 18	39.9	120	0.84
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	204.55 ± 20	39.7	113	0.59
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	182.96 ± 18	39.2	140	1.28
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	212.75 ± 21	32.3	118	0.77
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	141.26 ± 14	18.3	108	0.36
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	147.26 ± 14	20.1	132	1.24
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	190.18 ± 19	38.3	104	0.19
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	228.56 ± 22	26.9	127	1.06
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	212.57 ± 21	28.7	119	0.78

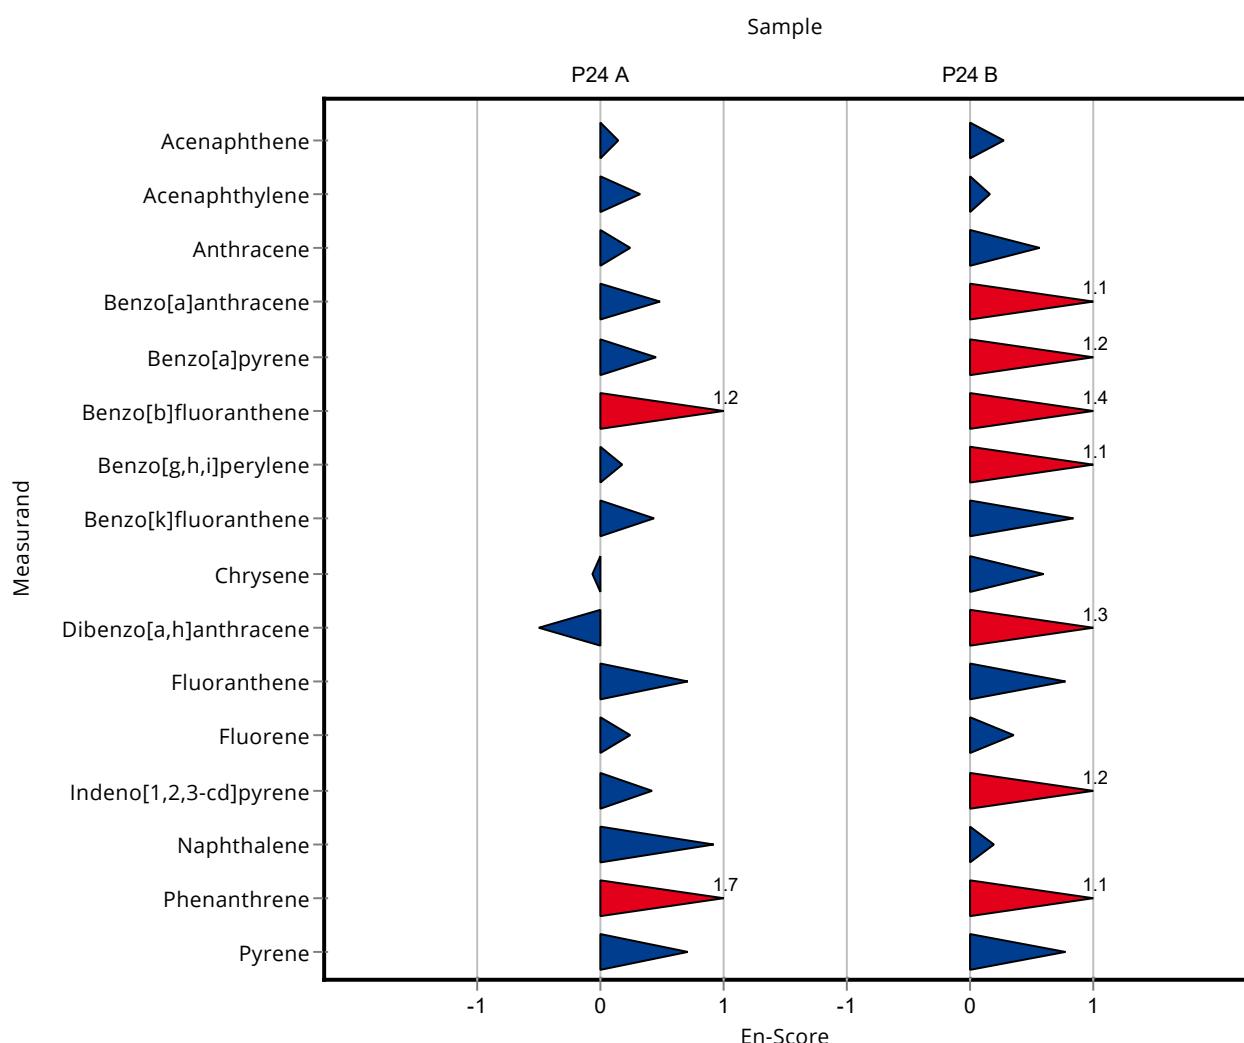


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.2 ± 5.8	5.08	98.1	-0.10
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.6 ± 5.6	5.89	104	0.18
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.9 ± 4.8	6.39	89	-0.42
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	19.6 ± 4.3	4.77	86.2	-0.66
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.7 ± 2.8	3.78	80.6	-0.81
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21.2 ± 4.7	4.05	89.1	-0.64
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18.9 ± 4.2	7.43	81.4	-0.58
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18.9 ± 4.2	5.61	87.6	-0.48
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23.6 ± 5.2	5.91	87.8	-0.55
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30.5 ± 6.7	7.7	119	0.63
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	25.4 ± 5.6	4.9	93.3	-0.37
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.6 ± 5.9	3.83	97.2	-0.20
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17.4 ± 3.8	4.23	82.2	-0.89
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.1 ± 6.2	9.18	94.9	-0.16
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.9 ± 4.8	4.06	86.2	-0.86

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	181 ± 40	34.1	101	0.04
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	138 ± 30	34.4	96.3	-0.16
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	171 ± 38	47.2	94.2	-0.22
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	123 ± 27	30.8	83.9	-0.77
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	124 ± 27	35.4	84.1	-0.66
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	118 ± 26	23.3	86.1	-0.82
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	133 ± 29	48.6	87.6	-0.39
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	137 ± 30	39.9	89.4	-0.41
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	167 ± 37	39.7	92.6	-0.34
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	165 ± 36	39.2	126	0.88
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	185 ± 41	32.3	103	0.17
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	130 ± 29	18.3	99.4	-0.04
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	91.7 ± 20.2	20.1	82.3	-0.98

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	165 ± 36	26.9	91.9 -0.54
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	155 ± 34	28.7	86.4 -0.85

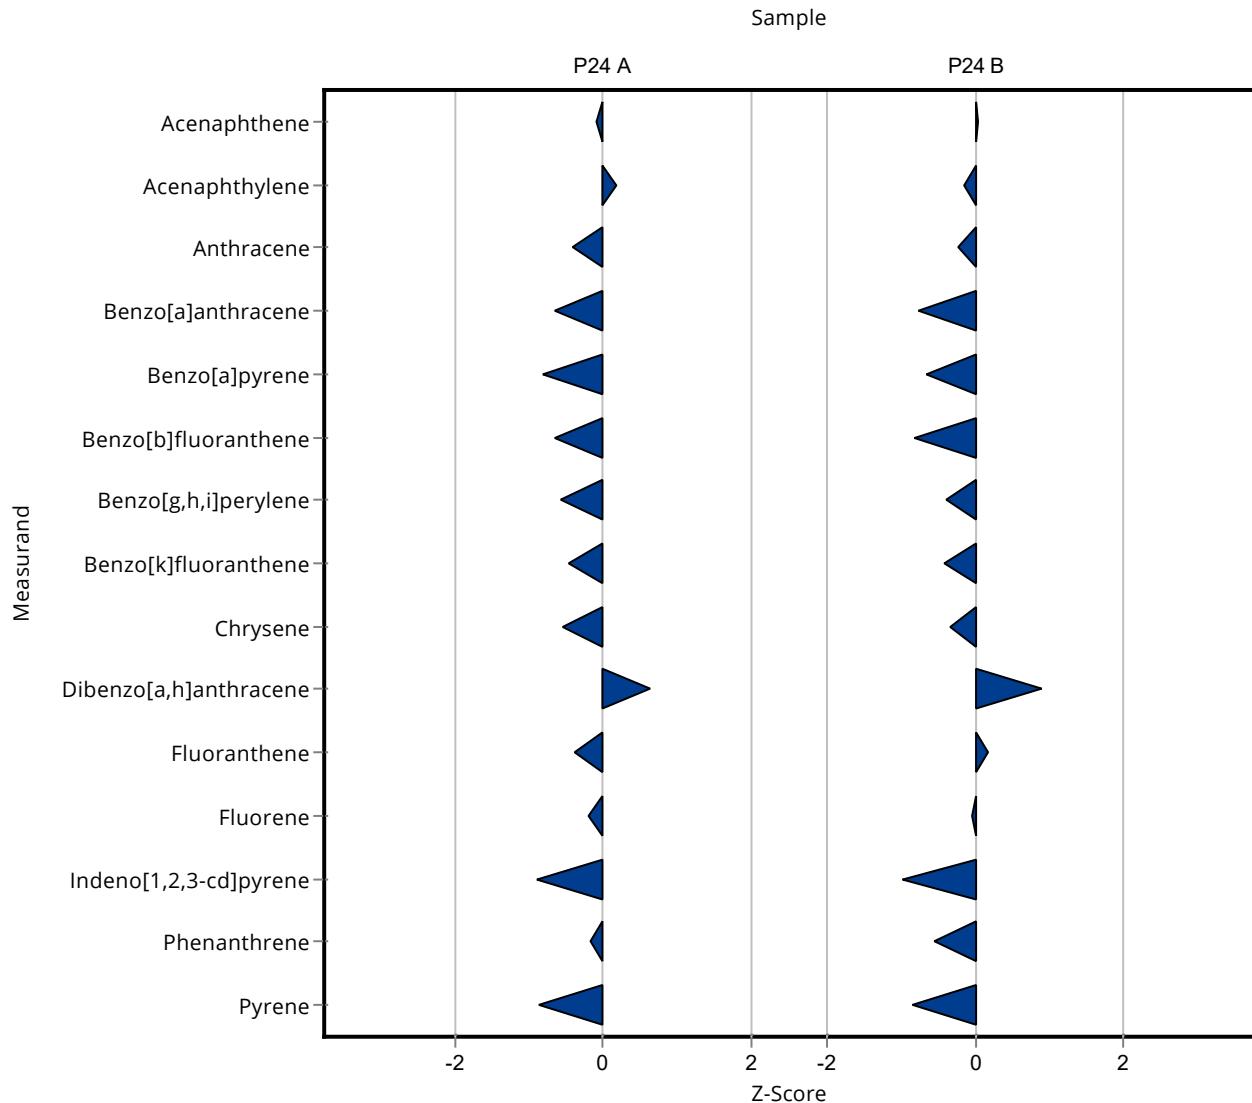


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.2 ± 5.8	5.08	98.1	-0.04
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.6 ± 5.6	5.89	104	0.09
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.9 ± 4.8	6.39	89	-0.28
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	19.6 ± 4.3	4.77	86.2	-0.36
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.7 ± 2.8	3.78	80.6	-0.53
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21.2 ± 4.7	4.05	89.1	-0.27
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18.9 ± 4.2	7.43	81.4	-0.50
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18.9 ± 4.2	5.61	87.6	-0.32
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23.6 ± 5.2	5.91	87.8	-0.31
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30.5 ± 6.7	7.7	119	0.36
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	25.4 ± 5.6	4.9	93.3	-0.16
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.6 ± 5.9	3.83	97.2	-0.06
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17.4 ± 3.8	4.23	82.2	-0.48
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.1 ± 6.2	9.18	94.9	-0.12
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.9 ± 4.8	4.06	86.2	-0.36

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	181 ± 40	34.1	101	0.02
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	138 ± 30	34.4	96.3	-0.09
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	171 ± 38	47.2	94.2	-0.14
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	123 ± 27	30.8	83.9	-0.43
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	124 ± 27	35.4	84.1	-0.43
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	118 ± 26	23.3	86.1	-0.36

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	133 ± 29	48.6	87.6	-0.32
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	137 ± 30	39.9	89.4	-0.27
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	167 ± 37	39.7	92.6	-0.18
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	165 ± 36	39.2	126	0.46
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	185 ± 41	32.3	103	0.07
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	130 ± 29	18.3	99.4	-0.01
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	91.7 ± 20.2	20.1	82.3	-0.48
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	165 ± 36	26.9	91.9	-0.20
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	155 ± 34	28.7	86.4	-0.36

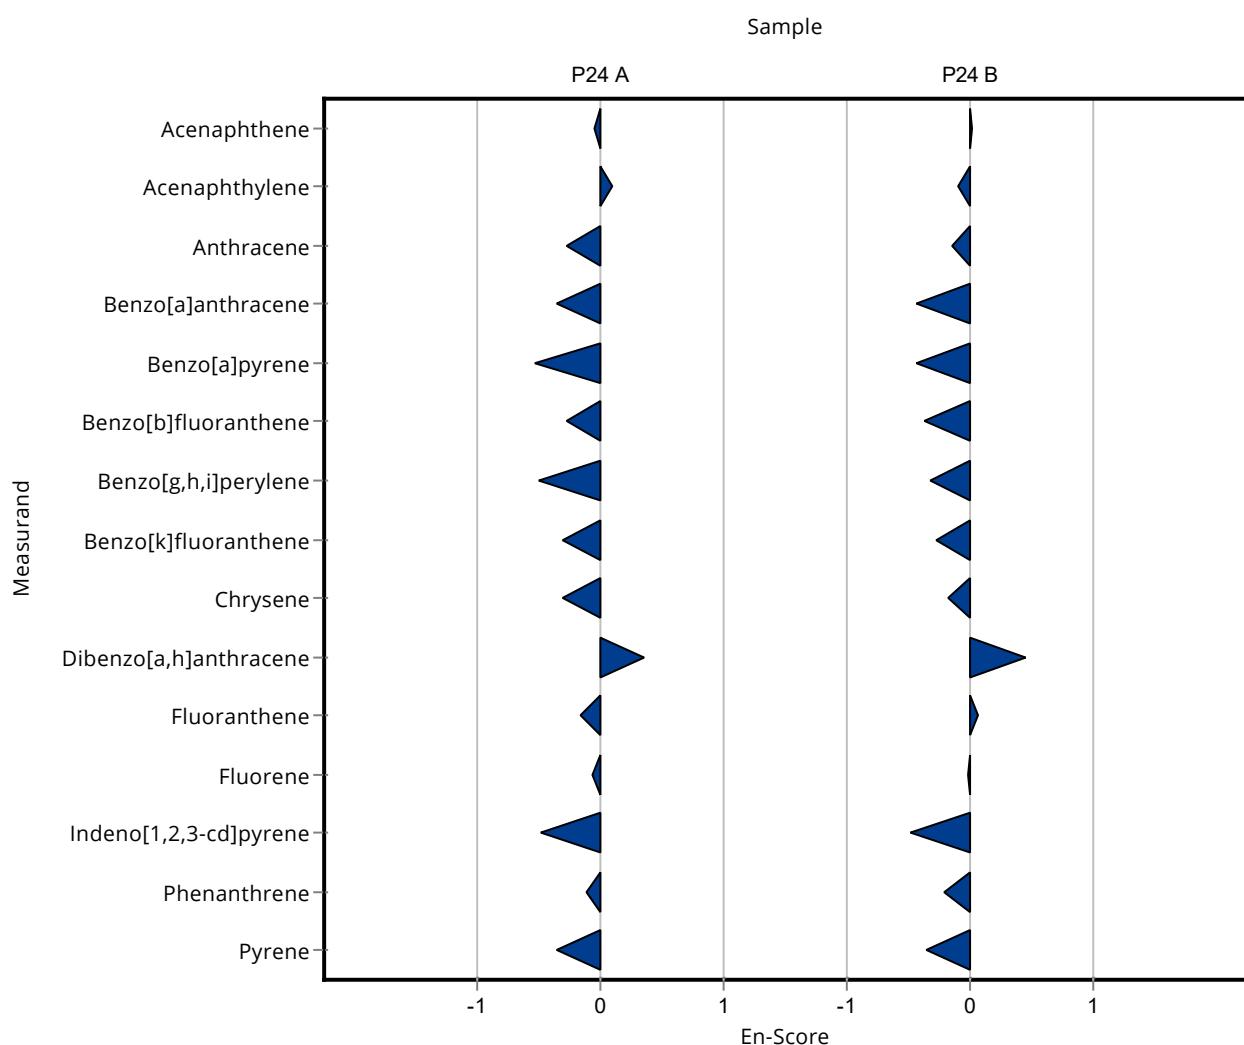


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	38.36 ± 5.754	5.08	144	2.29
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	31.45 ± 4.718	5.89	128	1.17
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.66 ± 3.849	6.39	104	0.17
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.33 ± 3.65	4.77	107	0.33
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.1 ± 2.565	3.78	109	0.36
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	29.06 ± 4.359	4.05	122	1.30
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	28.93 ± 4.34	7.43	125	0.77
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	25.49 ± 3.824	5.61	118	0.70
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	28.34 ± 4.251	5.91	105	0.25
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.2 ± 4.08	7.7	106	0.20
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.25 ± 4.688	4.9	115	0.82
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	32.22 ± 4.833	3.83	118	1.27
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.2 ± 3.63	4.23	114	0.72
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.15 ± 6.623	7.6	122	1.05
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	31.15 ± 4.673	9.18	105	0.17
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.55 ± 4.283	4.06	112	0.77

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	175.86 ± 26.379	34.1	97.9	-0.11
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	142.06 ± 21.309	34.4	99.1	-0.04
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	179.15 ± 26.873	47.2	98.7	-0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	142.02 ± 21.303	30.8	96.9	-0.15
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	139.06 ± 20.859	35.4	94.3	-0.24
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	139.85 ± 20.978	23.3	102	0.12
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	142.37 ± 21.356	48.6	93.8	-0.19
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	143.74 ± 21.561	39.9	93.8	-0.24
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	171.24 ± 25.686	39.7	95	-0.23
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	123.76 ± 18.564	39.2	94.8	-0.17
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	175.33 ± 26.3	32.3	97.6	-0.13
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	125.73 ± 18.86	18.3	96.1	-0.28
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	106.5 ± 15.975	20.1	95.6	-0.24

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	152.7 ± 22.905	38.3	83.7 -0.78
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	168.8 ± 25.32	26.9	94 -0.40
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	176.98 ± 26.547	28.7	98.7 -0.08

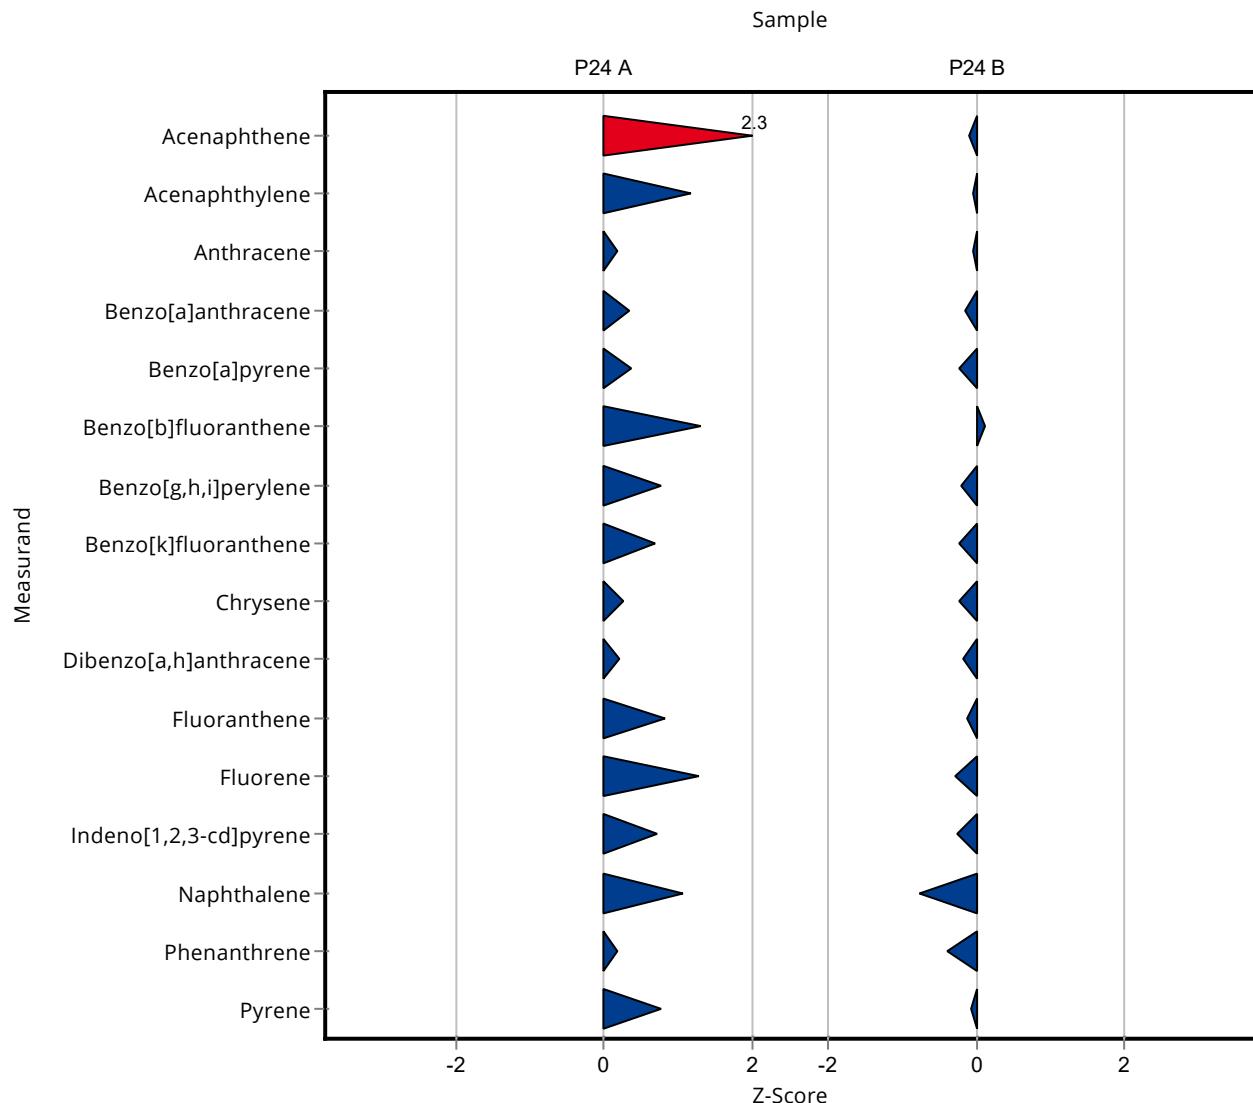


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	38.36 ± 5.754	5.08	144	1.00
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	31.45 ± 4.718	5.89	128	0.70
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.66 ± 3.849	6.39	104	0.14
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.33 ± 3.65	4.77	107	0.21
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.1 ± 2.565	3.78	109	0.25
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	29.06 ± 4.359	4.05	122	0.59
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	28.93 ± 4.34	7.43	125	0.65
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	25.49 ± 3.824	5.61	118	0.51
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	28.34 ± 4.251	5.91	105	0.17
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	27.2 ± 4.08	7.7	106	0.19
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.25 ± 4.688	4.9	115	0.42
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	32.22 ± 4.833	3.83	118	0.50
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.2 ± 3.63	4.23	114	0.41
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.15 ± 6.623	7.6	122	0.58
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	31.15 ± 4.673	9.18	105	0.15
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.55 ± 4.283	4.06	112	0.36

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	175.86 ± 26.379	34.1	97.9	-0.07
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	142.06 ± 21.309	34.4	99.1	-0.03
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	179.15 ± 26.873	47.2	98.7	-0.04
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	142.02 ± 21.303	30.8	96.9	-0.11
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	139.06 ± 20.859	35.4	94.3	-0.20
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	139.85 ± 20.978	23.3	102	0.07

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	142.37 ± 21.356	48.6	93.8	-0.21
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	143.74 ± 21.561	39.9	93.8	-0.22
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	171.24 ± 25.686	39.7	95	-0.17
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	123.76 ± 18.564	39.2	94.8	-0.16
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	175.33 ± 26.3	32.3	97.6	-0.08
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	125.73 ± 18.86	18.3	96.1	-0.13
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	106.5 ± 15.975	20.1	95.6	-0.15
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	152.7 ± 22.905	38.3	83.7	-0.63
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	168.8 ± 25.32	26.9	94	-0.21
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	176.98 ± 26.547	28.7	98.7	-0.04

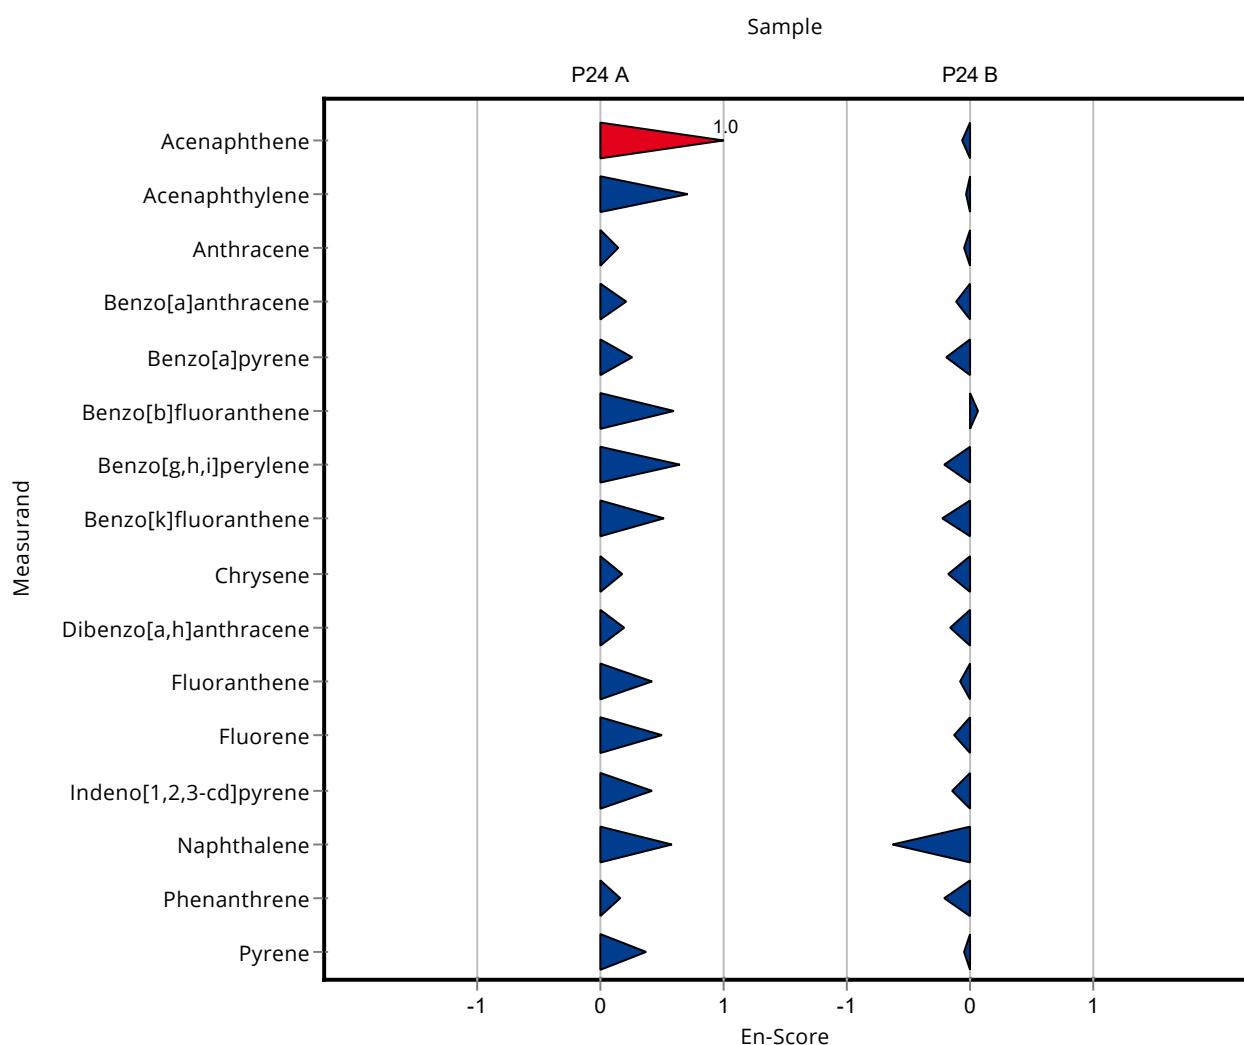


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27 ± 5	5.08	101	0.06
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	17 ± 3	5.89	69.3	-1.28
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	18 ± 4	6.39	73.2	-1.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	15 ± 3	4.77	66	-1.62
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	9 ± 2	3.78	57.1	-1.79
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21 ± 4	4.05	88.2	-0.69
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18 ± 4	7.43	77.5	-0.70
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18 ± 4	5.61	83.4	-0.64
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23 ± 5	5.91	85.6	-0.66
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	17 ± 3	7.7	66.2	-1.13
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27 ± 5	4.9	99.1	-0.05
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	19 ± 4	3.83	69.4	-2.18
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	14 ± 3	4.23	66.2	-1.69
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	23 ± 5	7.6	63.6	-1.74
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	19 ± 4	9.18	64.2	-1.16
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21 ± 4	4.06	82.7	-1.08

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	195 ± 39	34.1	109	0.45
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	130 ± 26	34.4	90.7	-0.39
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	157 ± 31	47.2	86.5	-0.52
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	134 ± 27	30.8	91.4	-0.41
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	122 ± 24	35.4	82.7	-0.72
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	136 ± 27	23.3	99.3	-0.04
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	130 ± 26	48.6	85.6	-0.45
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	128 ± 26	39.9	83.5	-0.63
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	169 ± 34	39.7	93.7	-0.29
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	94 ± 19	39.2	72	-0.93
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	177 ± 35	32.3	98.5	-0.08
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140 ± 28	18.3	107	0.50
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	97 ± 19	20.1	87.1	-0.72

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	192 ± 38	38.3	105
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	181 ± 36	26.9	101
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	191 ± 38	28.7	107

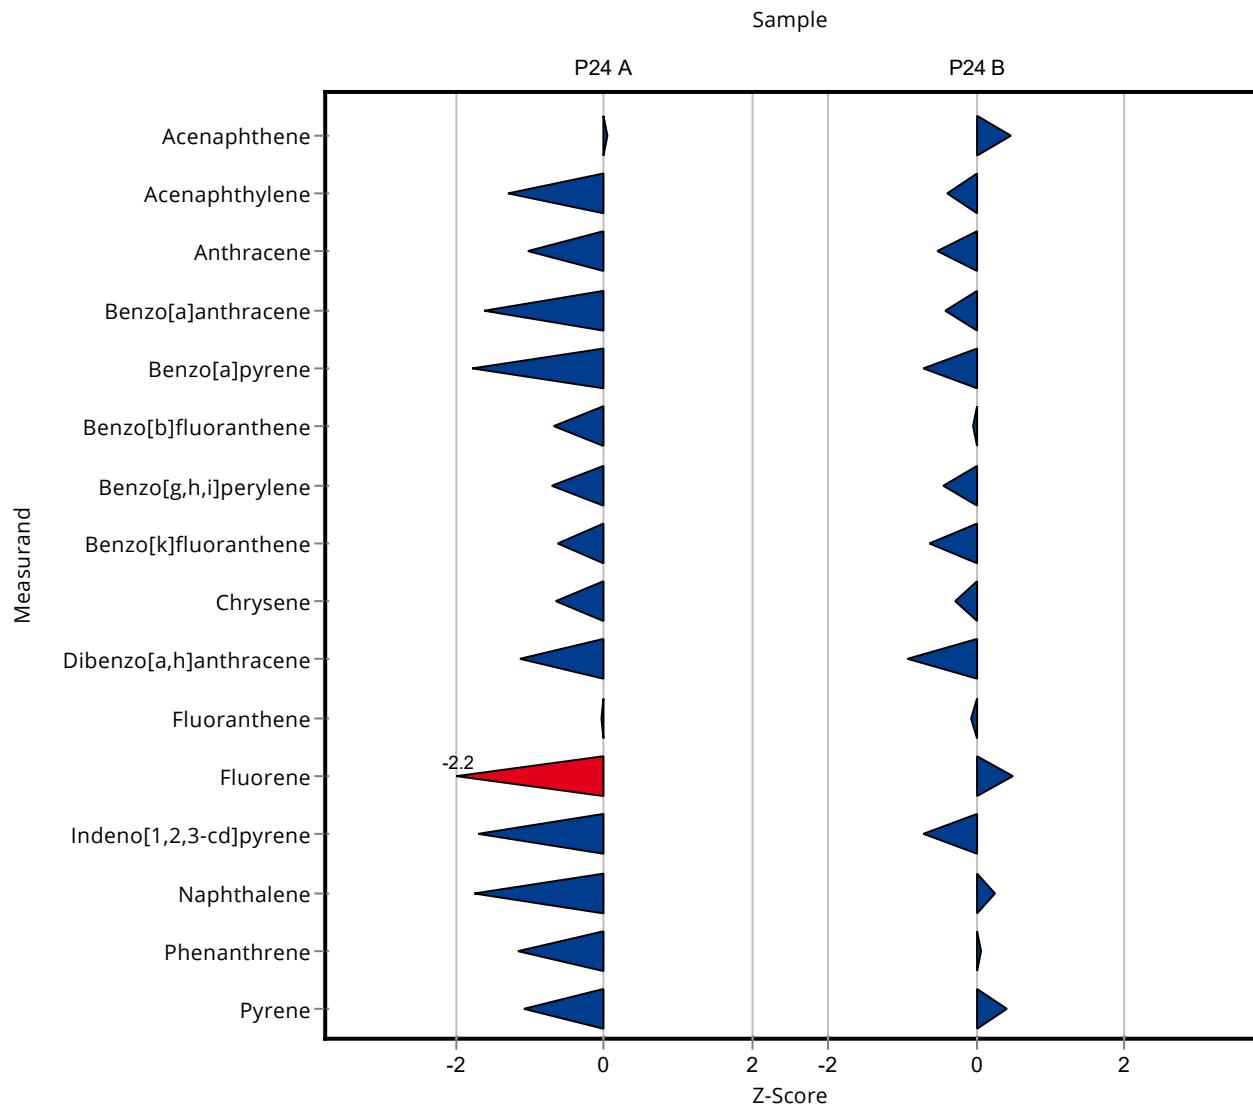


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27 ± 5	5.08	101	0.03
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	17 ± 3	5.89	69.3	-1.14
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	18 ± 4	6.39	73.2	-0.82
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	15 ± 3	4.77	66	-1.25
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	9 ± 2	3.78	57.1	-1.60
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21 ± 4	4.05	88.2	-0.34
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18 ± 4	7.43	77.5	-0.64
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18 ± 4	5.61	83.4	-0.44
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23 ± 5	5.91	85.6	-0.39
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	17 ± 3	7.7	66.2	-1.40
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27 ± 5	4.9	99.1	-0.02
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	19 ± 4	3.83	69.4	-1.03
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	14 ± 3	4.23	66.2	-1.15
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	23 ± 5	7.6	63.6	-1.24
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	19 ± 4	9.18	64.2	-1.21
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21 ± 4	4.06	82.7	-0.54

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	195 ± 39	34.1	109	0.20
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	130 ± 26	34.4	90.7	-0.25
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	157 ± 31	47.2	86.5	-0.39
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	134 ± 27	30.8	91.4	-0.23
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	122 ± 24	35.4	82.7	-0.52
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	136 ± 27	23.3	99.3	-0.02

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	130 ± 26	48.6	85.6	-0.41
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	128 ± 26	39.9	83.5	-0.48
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	169 ± 34	39.7	93.7	-0.17
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	94 ± 19	39.2	72	-0.86
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	177 ± 35	32.3	98.5	-0.04
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140 ± 28	18.3	107	0.16
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	97 ± 19	20.1	87.1	-0.37
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	192 ± 38	38.3	105	0.12
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	181 ± 36	26.9	101	0.02
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	191 ± 38	28.7	107	0.15

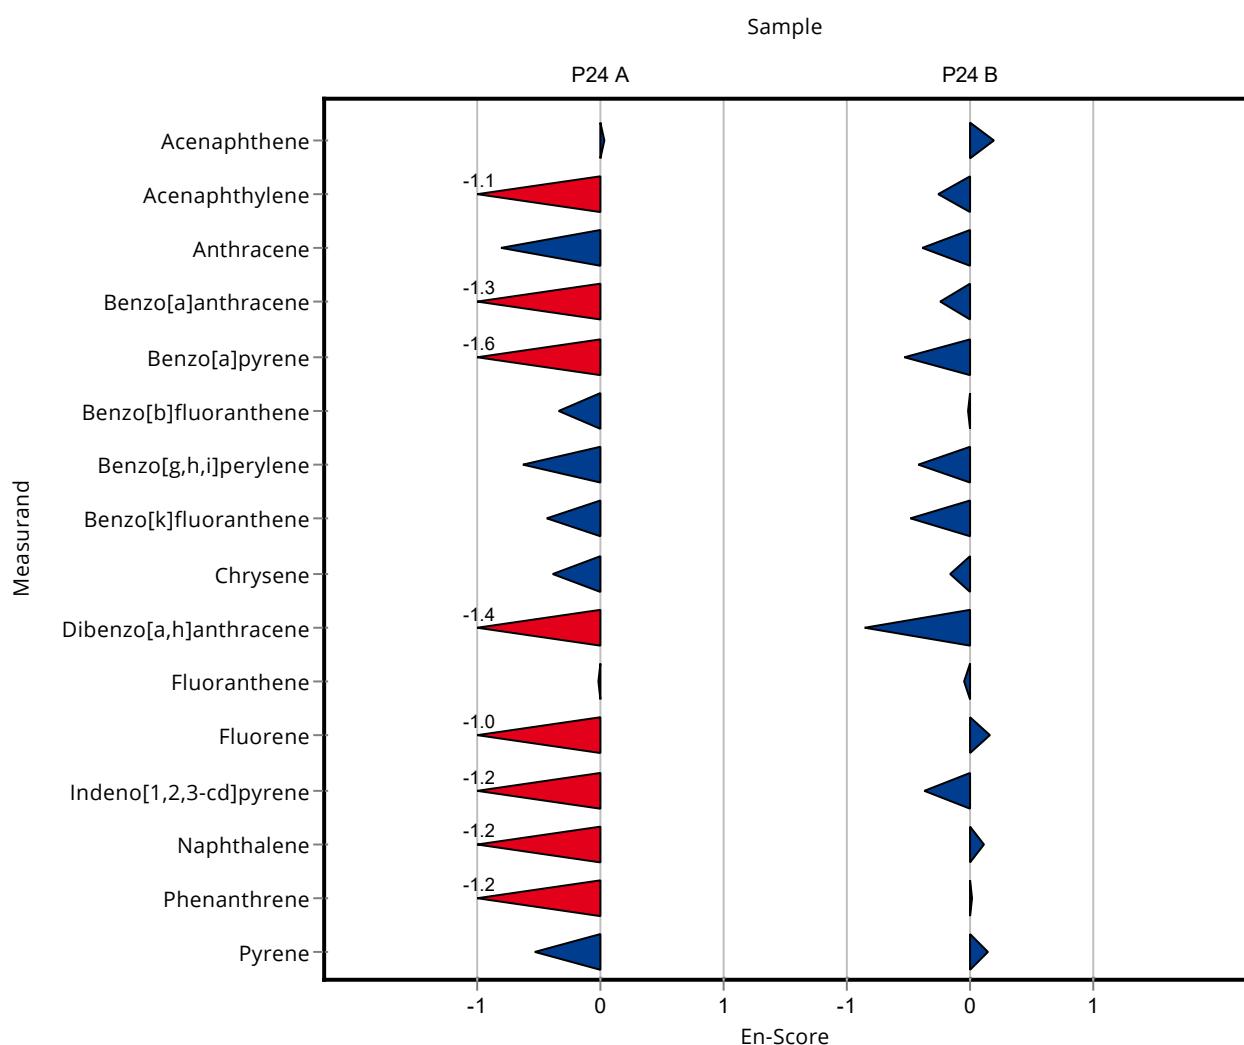


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	23.8 ± 0.63	5.08	89.1	-0.57
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	23.9 ± 1.2	5.89	97.4	-0.11
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.9 ± 0.65	6.39	105	0.20
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	23.5 ± 0.25	4.77	103	0.16
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.1 ± 0.3	3.78	109	0.36
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23.9 ± 0.4	4.05	100	0.03
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.8 ± 0.68	7.43	107	0.21
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.3 ± 0.51	5.61	103	0.13
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	29 ± 0.26	5.91	108	0.36
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.3 ± 1	7.7	98.6	-0.05
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27.8 ± 0.49	4.9	102	0.12
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.7 ± 0.73	3.83	97.6	-0.17
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.2 ± 1.3	4.23	100	0.01
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	24.7 ± 1.3	7.6	68.3	-1.51
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	43.1 ± 1.5	9.18	146	1.47
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 0.53	4.06	105	0.29

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	325 ± 3	34.1	181	4.26
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	260 ± 5.7	34.4	181	3.39
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	361 ± 11	47.2	199	3.81
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	293 ± 11	30.8	200	4.75
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	290 ± 12	35.4	197	4.03
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	272 ± 12	23.3	199	5.80
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	307 ± 40	48.6	202	3.19
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	316 ± 15	39.9	206	4.08
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	410 ± 16	39.7	227	5.79
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	239 ± 40	39.2	183	2.77
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	363 ± 9.2	32.3	202	5.67
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	239 ± 8.9	18.3	183	5.91
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	232 ± 18	20.1	208	6.02

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	282 ± 2	38.3	155 2.60
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	412 ± 8.4	26.9	229 8.63
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	362 ± 13	28.7	202 6.37

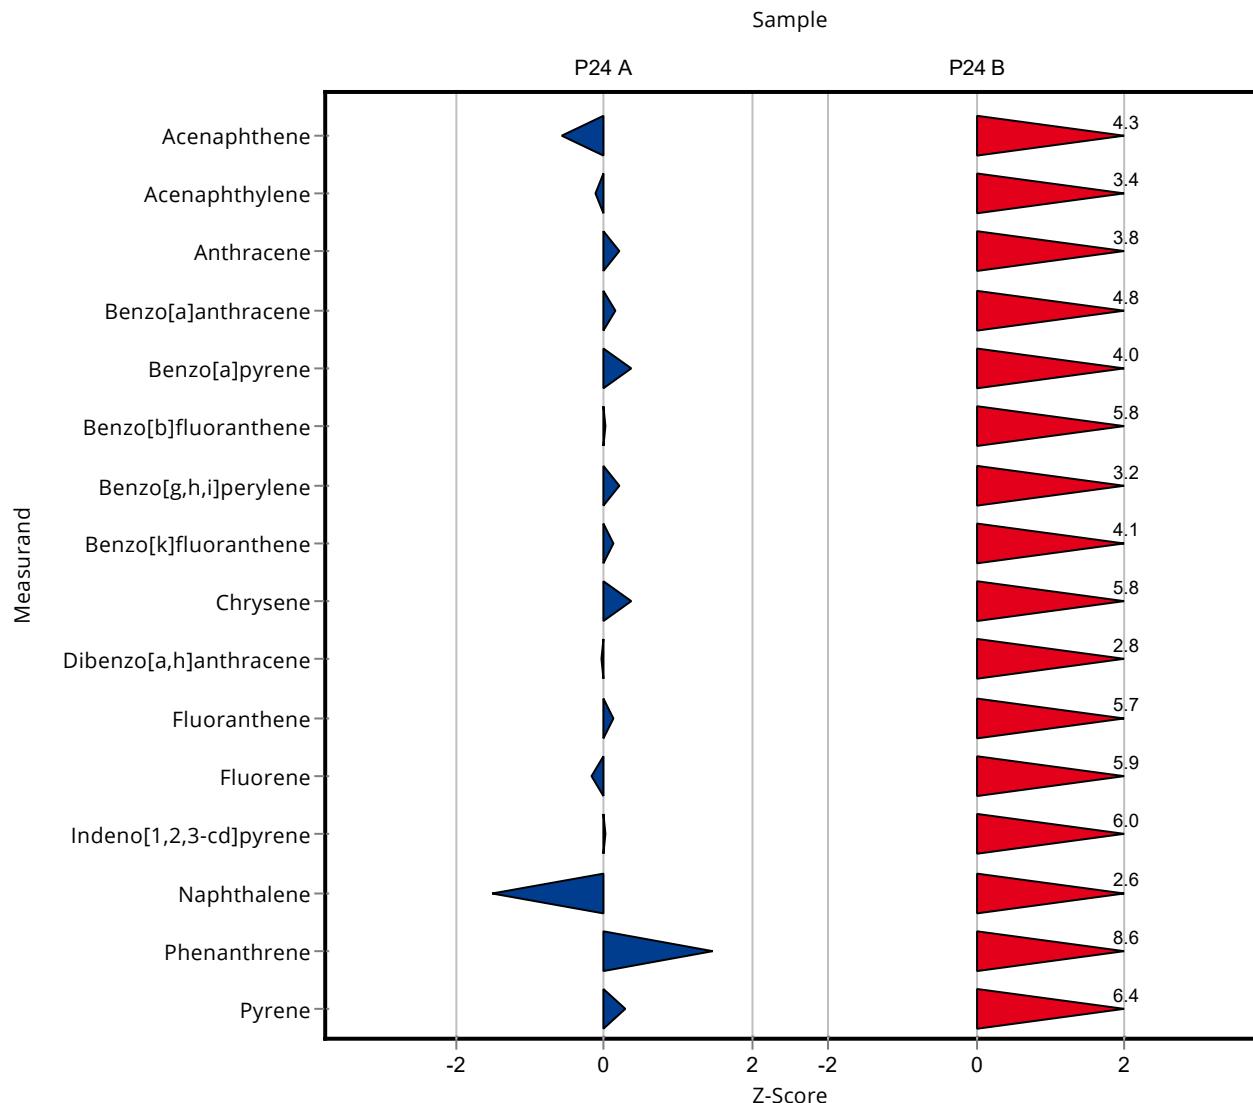


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	23.8 ± 0.63	5.08	89.1	-1.52
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	23.9 ± 1.2	5.89	97.4	-0.17
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.9 ± 0.65	6.39	105	0.77
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	23.5 ± 0.25	4.77	103	0.50
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.1 ± 0.3	3.78	109	0.91
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	23.9 ± 0.4	4.05	100	0.06
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.8 ± 0.68	7.43	107	0.72
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.3 ± 0.51	5.61	103	0.48
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	29 ± 0.26	5.91	108	1.63
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.3 ± 1	7.7	98.6	-0.14
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27.8 ± 0.49	4.9	102	0.32
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.7 ± 0.73	3.83	97.6	-0.35
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.2 ± 1.3	4.23	100	0.01
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	24.7 ± 1.3	7.6	68.3	-2.61
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	43.1 ± 1.5	9.18	146	2.86
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 0.53	4.06	105	0.63

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	325 ± 3	34.1	181	12.46
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	260 ± 5.7	34.4	181	7.57
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	361 ± 11	47.2	199	7.71
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	293 ± 11	30.8	200	6.28
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	290 ± 12	35.4	197	5.59
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	272 ± 12	23.3	199	5.33

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	307 ± 40	48.6	202	1.92
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	316 ± 15	39.9	206	5.22
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	410 ± 16	39.7	227	6.97
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	239 ± 40	39.2	183	1.32
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	363 ± 9.2	32.3	202	9.02
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	239 ± 8.9	18.3	183	5.59
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	232 ± 18	20.1	208	3.28
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	282 ± 2	38.3	155	7.50
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	412 ± 8.4	26.9	229	10.72
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	362 ± 13	28.7	202	6.71

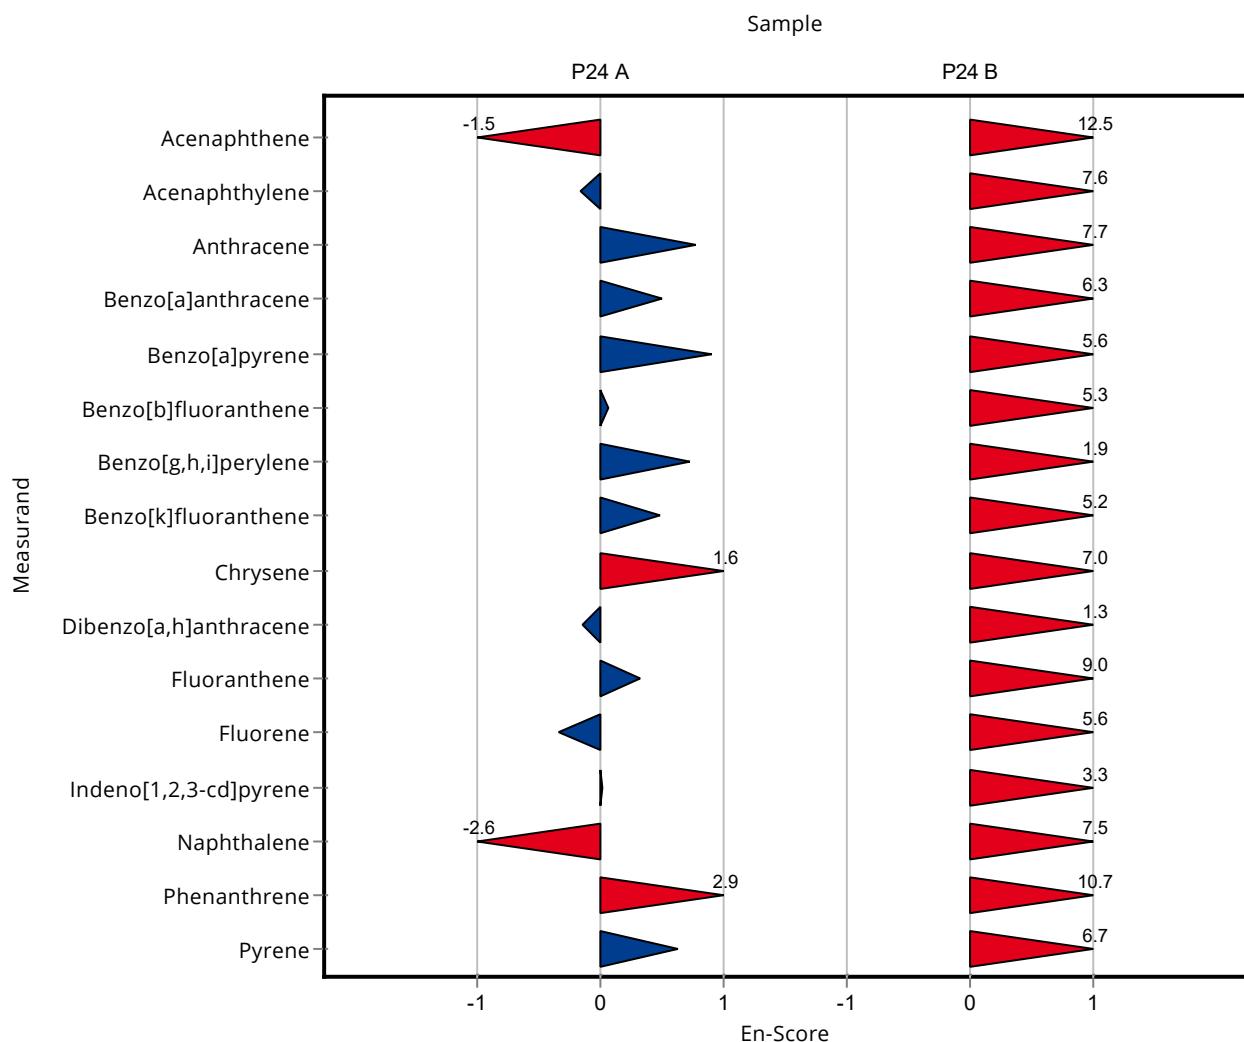


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.65 ± 9.53	6.39	88	-0.46
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	19.83 ± 8.73	4.77	87.2	-0.61
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.15 ± 5.35	3.78	77.2	-0.95
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21.03 ± 9.25	4.05	88.4	-0.68
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18.48 ± 8.13	7.43	79.6	-0.64
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18.3 ± 8.05	5.61	84.8	-0.58
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.15 ± 11.95	5.91	101	0.05
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	29.55 ± 13	7.7	115	0.51
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	25.29 ± 11.13	4.9	92.9	-0.40
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17.08 ± 7.52	4.23	80.7	-0.96
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.4 ± 9.4	4.06	84.2	-0.99

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	177.6 ± 78.1	47.2	97.9	-0.08
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	126.2 ± 55.5	30.8	86.1	-0.66
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	126.4 ± 55.6	35.4	85.7	-0.60
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	116.7 ± 51.3	23.3	85.2	-0.87
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	132.9 ± 58.5	48.6	87.5	-0.39
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	135.3 ± 59.5	39.9	88.3	-0.45
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	191.5 ± 84.3	39.7	106	0.28
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	170.7 ± 75.1	39.2	131	1.02
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	178.5 ± 78.5	32.3	99.4	-0.04
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	95.2 ± 41.9	20.1	85.5	-0.81

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	157.7 ± 69.4	28.7	87.9 -0.75

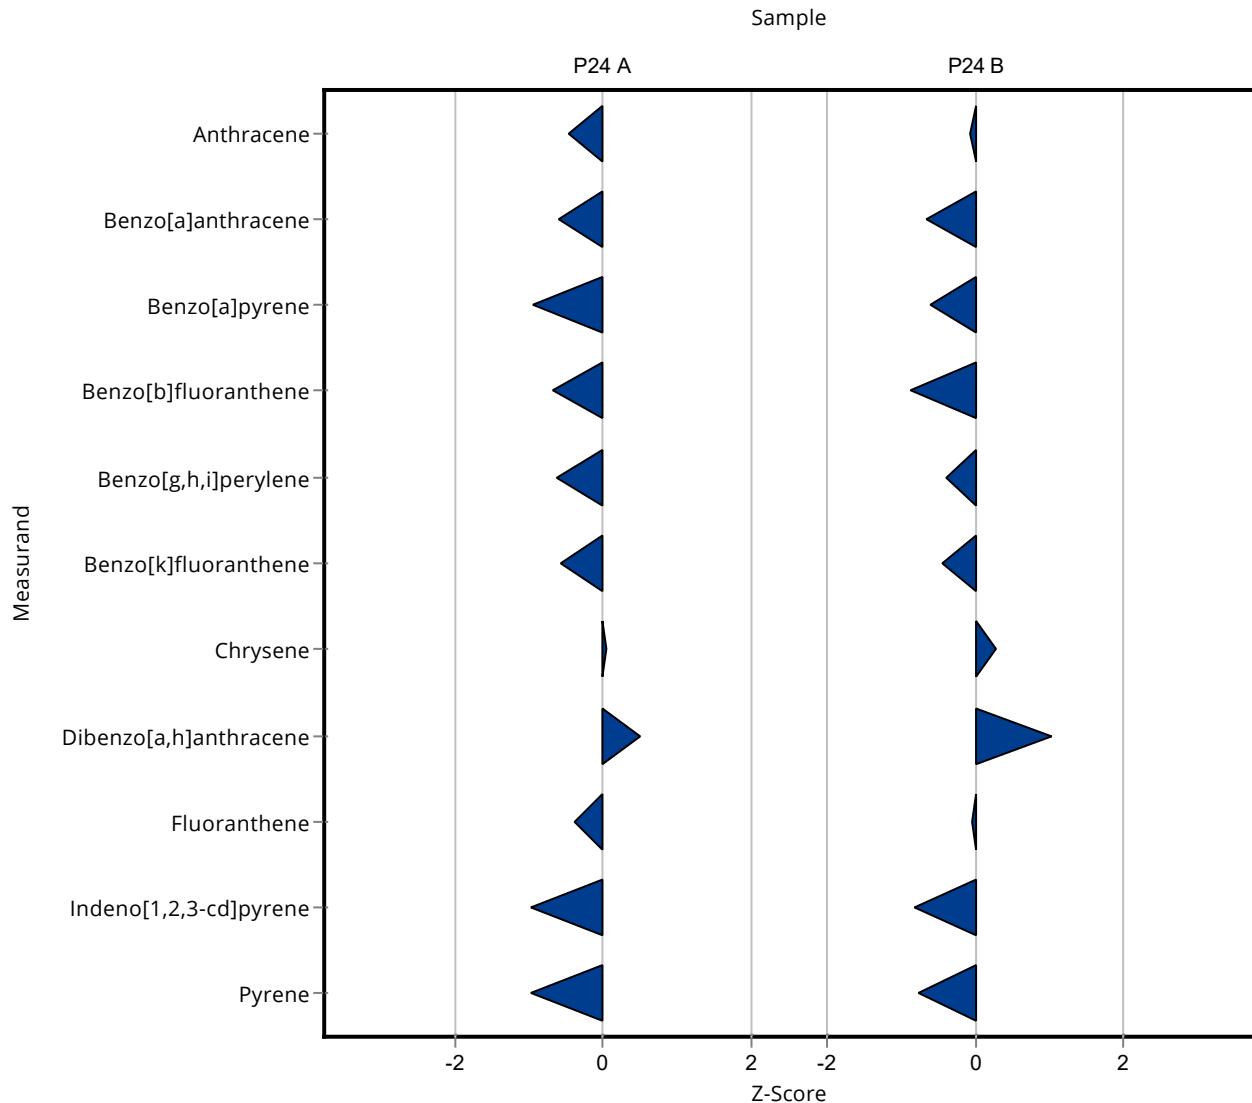


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.65 ± 9.53	6.39	88	-0.15
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	19.83 ± 8.73	4.77	87.2	-0.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.15 ± 5.35	3.78	77.2	-0.33
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21.03 ± 9.25	4.05	88.4	-0.15
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	18.48 ± 8.13	7.43	79.6	-0.29
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	18.3 ± 8.05	5.61	84.8	-0.20
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.15 ± 11.95	5.91	101	0.01
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	29.55 ± 13	7.7	115	0.15
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	25.29 ± 11.13	4.9	92.9	-0.09
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17.08 ± 7.52	4.23	80.7	-0.27
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.4 ± 9.4	4.06	84.2	-0.21

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	177.6 ± 78.1	47.2	97.9	-0.02
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	126.2 ± 55.5	30.8	86.1	-0.18
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	126.4 ± 55.6	35.4	85.7	-0.19
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	116.7 ± 51.3	23.3	85.2	-0.20

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	132.9 ± 58.5	48.6	87.5	-0.16
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	135.3 ± 59.5	39.9	88.3	-0.15
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	191.5 ± 84.3	39.7	106	0.07
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	170.7 ± 75.1	39.2	131	0.26
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	178.5 ± 78.5	32.3	99.4	-0.01
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	95.2 ± 41.9	20.1	85.5	-0.19
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	-	-
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	157.7 ± 69.4	28.7	87.9	-0.16

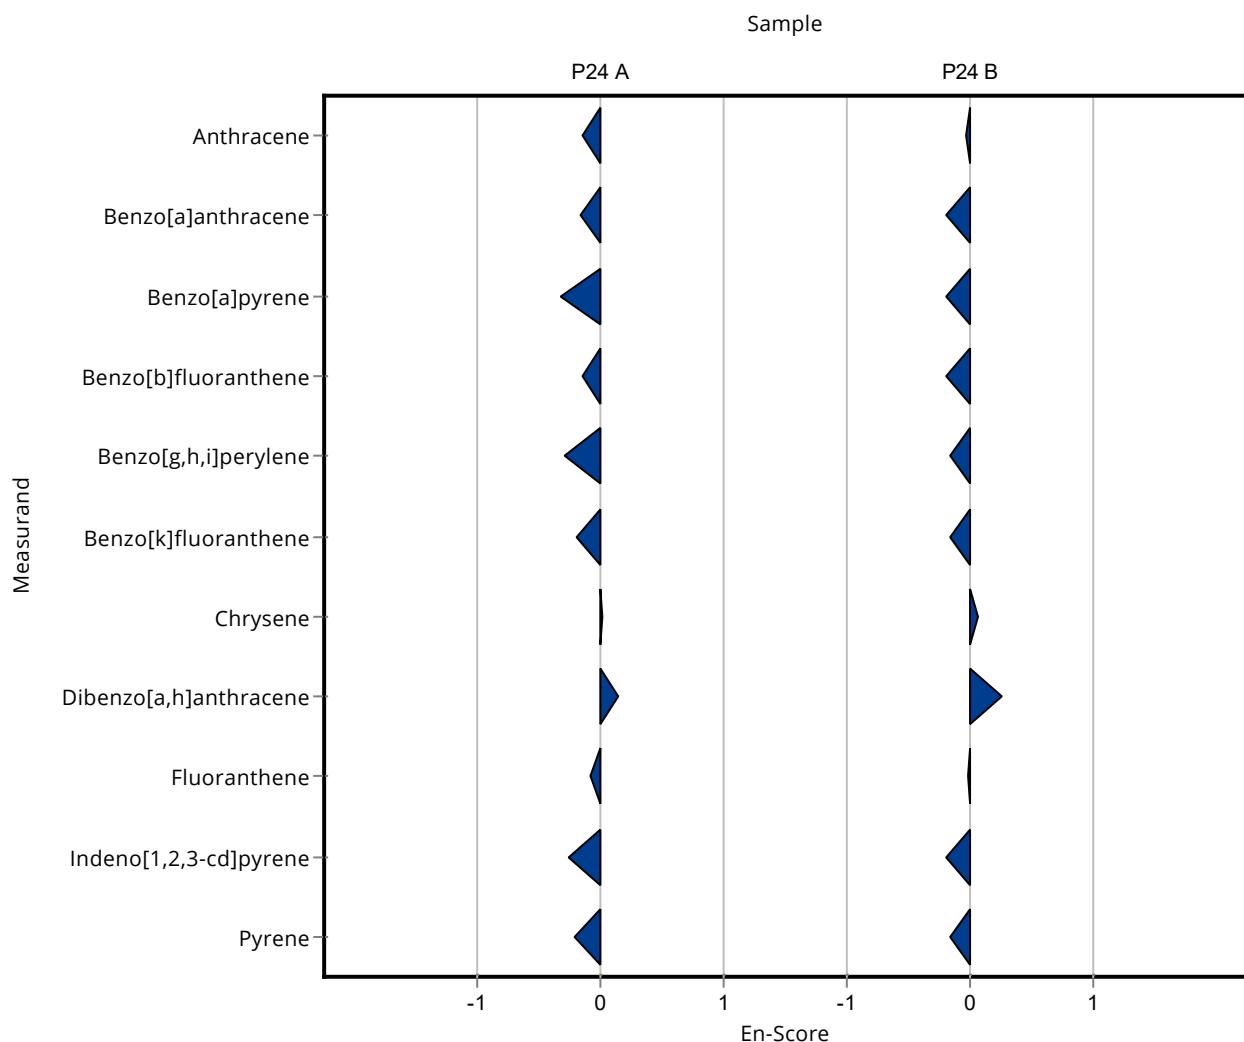


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.7 ± 3.59	3.78	119	0.78
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.3 ± 4.53	4.05	106	0.37
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	28.1 ± 9.06	7.43	121	0.66
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.5 ± 2.93	5.61	109	0.34
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	26.4 ± 5.93	4.23	125	1.24
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153 ± 29.5	35.4	104	0.16
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	139 ± 25	23.3	101	0.09
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	174 ± 56.1	48.6	115	0.46
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	161 ± 20.1	39.9	105	0.19
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126 ± 28.1	20.1	113	0.73

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	- -

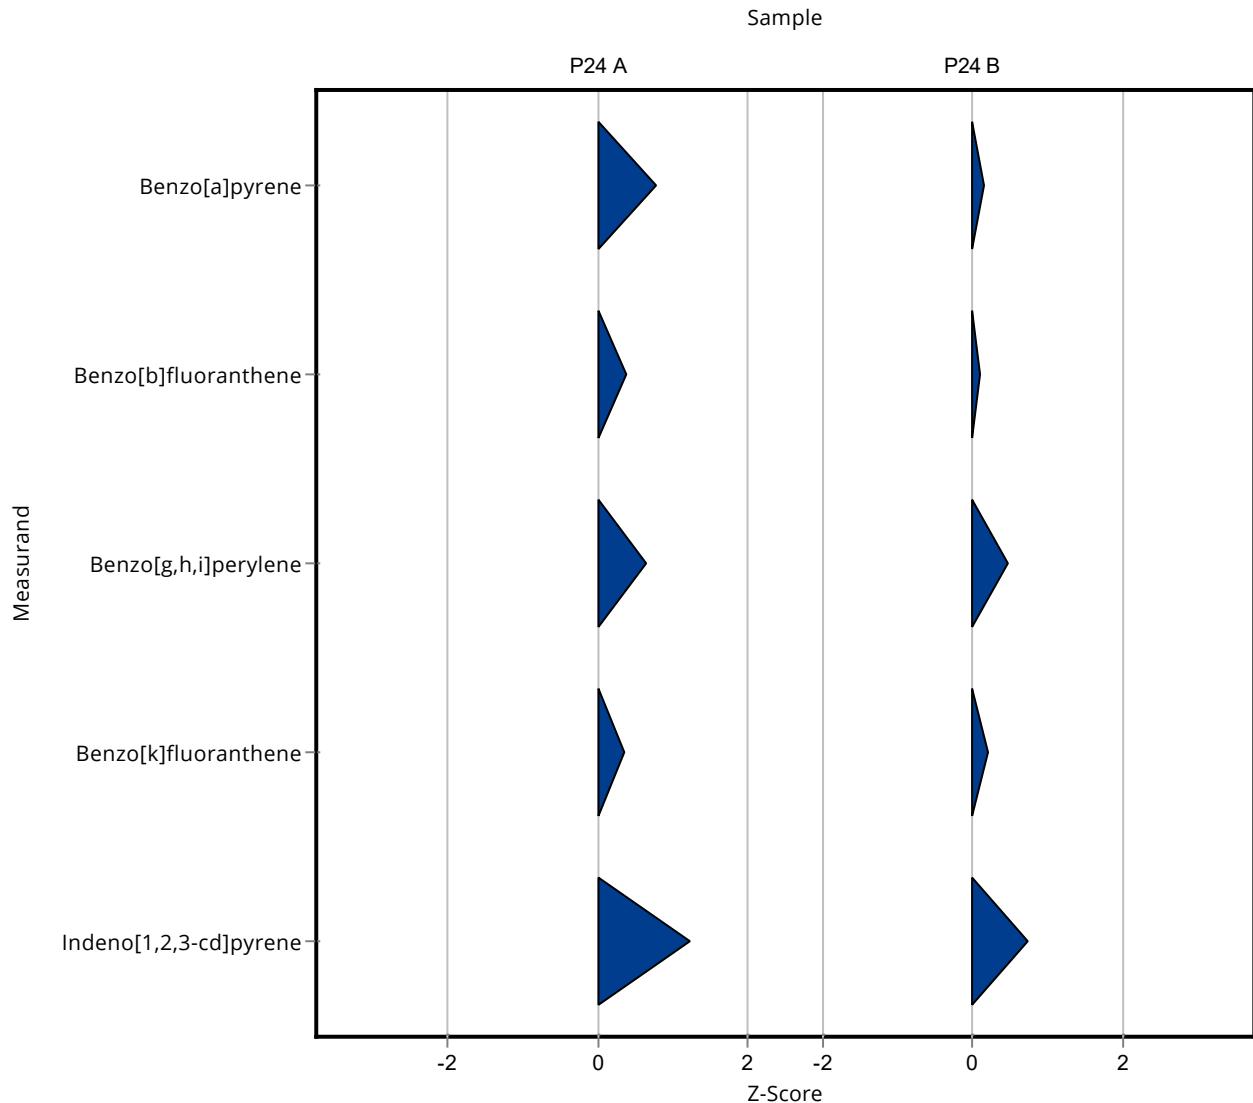


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.7 ± 3.59	3.78	119	0.40
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.3 ± 4.53	4.05	106	0.16
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	28.1 ± 9.06	7.43	121	0.27
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.5 ± 2.93	5.61	109	0.32
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	26.4 ± 5.93	4.23	125	0.44
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153 ± 29.5	35.4	104	0.09
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	139 ± 25	23.3	101	0.04

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	174 ± 56.1	48.6	115	0.20
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	161 ± 20.1	39.9	105	0.19
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126 ± 28.1	20.1	113	0.26
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	-	-
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	-	-

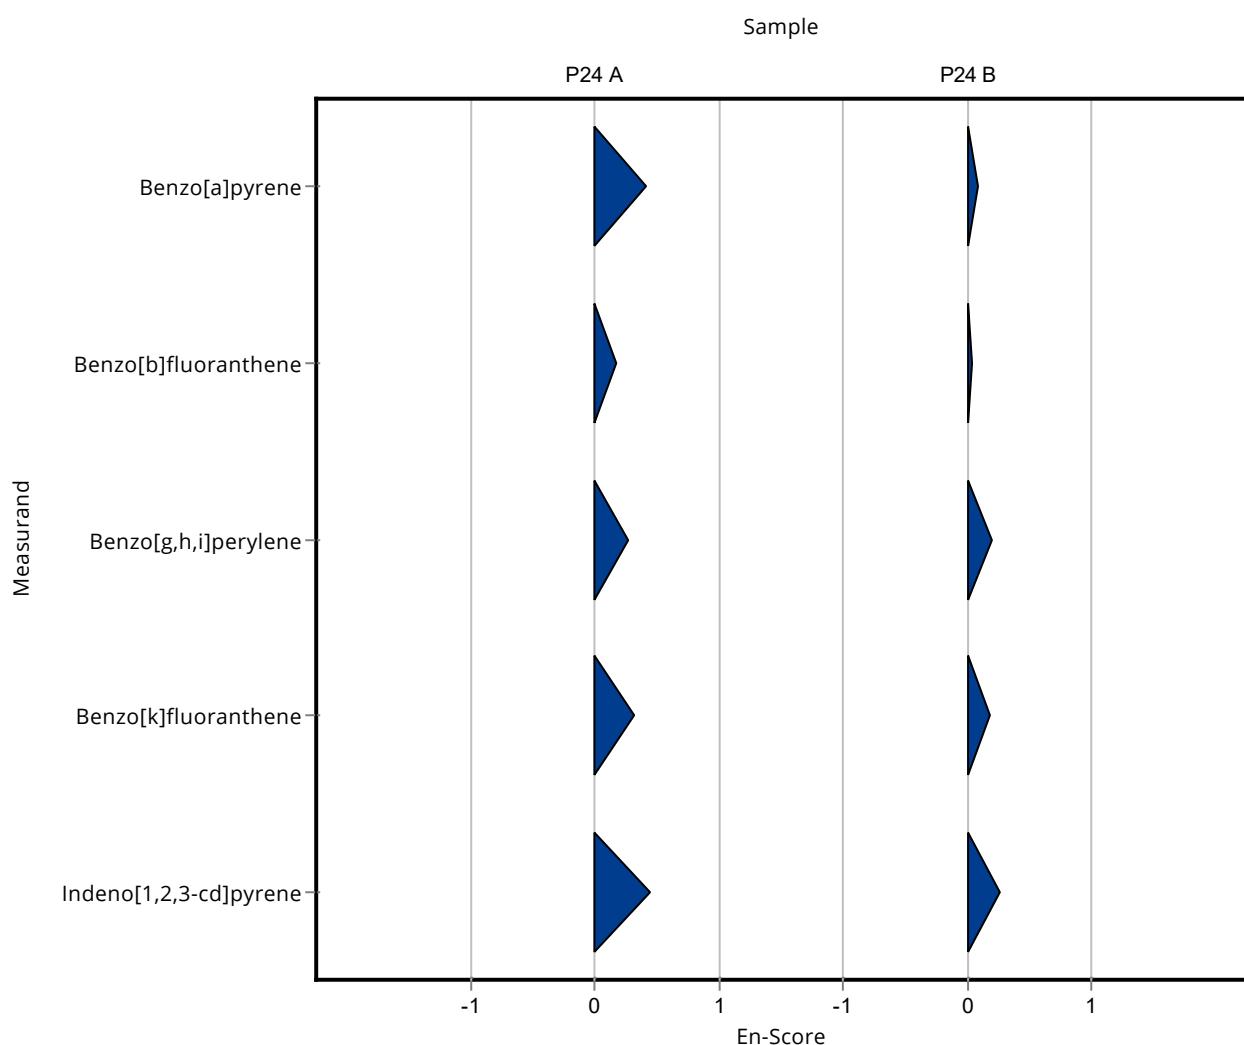


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	33.55 ± 14.76	5.08	126	1.35
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	87.24 ± 38.385	5.89	355	10.64
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	31.29 ± 13.769	6.39	127	1.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	31.02 ± 13.65	4.77	136	1.74
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	23.26 ± 10.233	3.78	148	1.99
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	32.31 ± 14.218	4.05	136	2.10
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	32 ± 14.081	7.43	138	1.18
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	25 ± 10.999	5.61	116	0.61
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	40.63 ± 17.879	5.91	151	2.32
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	33.5 ± 14.739	7.7	131	1.02
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	47.15 ± 20.744	4.9	173	4.06
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.75 ± 13.529	3.83	112	0.88
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	30.02 ± 13.21	4.23	142	2.09
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	57.29 ± 25.209	7.6	158	2.78
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	61.62 ± 27.115	9.18	208	3.49
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	39.86 ± 17.54	4.06	157	3.56

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	180.51 ± 79.425	34.1	101	0.03
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	259.36 ± 114.119	34.4	181	3.37
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	178.24 ± 78.427	47.2	98.2	-0.07
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	178.37 ± 78.485	30.8	122	1.03
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177.73 ± 78.202	35.4	121	0.86
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	169.17 ± 74.433	23.3	123	1.38
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	182.91 ± 80.481	48.6	120	0.64
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	187.59 ± 82.541	39.9	122	0.86
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	218.9 ± 96.314	39.7	121	0.97
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	159.32 ± 70.102	39.2	122	0.73
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	195.77 ± 86.14	32.3	109	0.50
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	157.42 ± 69.265	18.3	120	1.45
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	138.4 ± 60.897	20.1	124	1.35

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	176.82 ± 77.801	38.3	96.9 -0.15
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	190.81 ± 83.956	26.9	106 0.42
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	202.21 ± 88.971	28.7	113 0.80

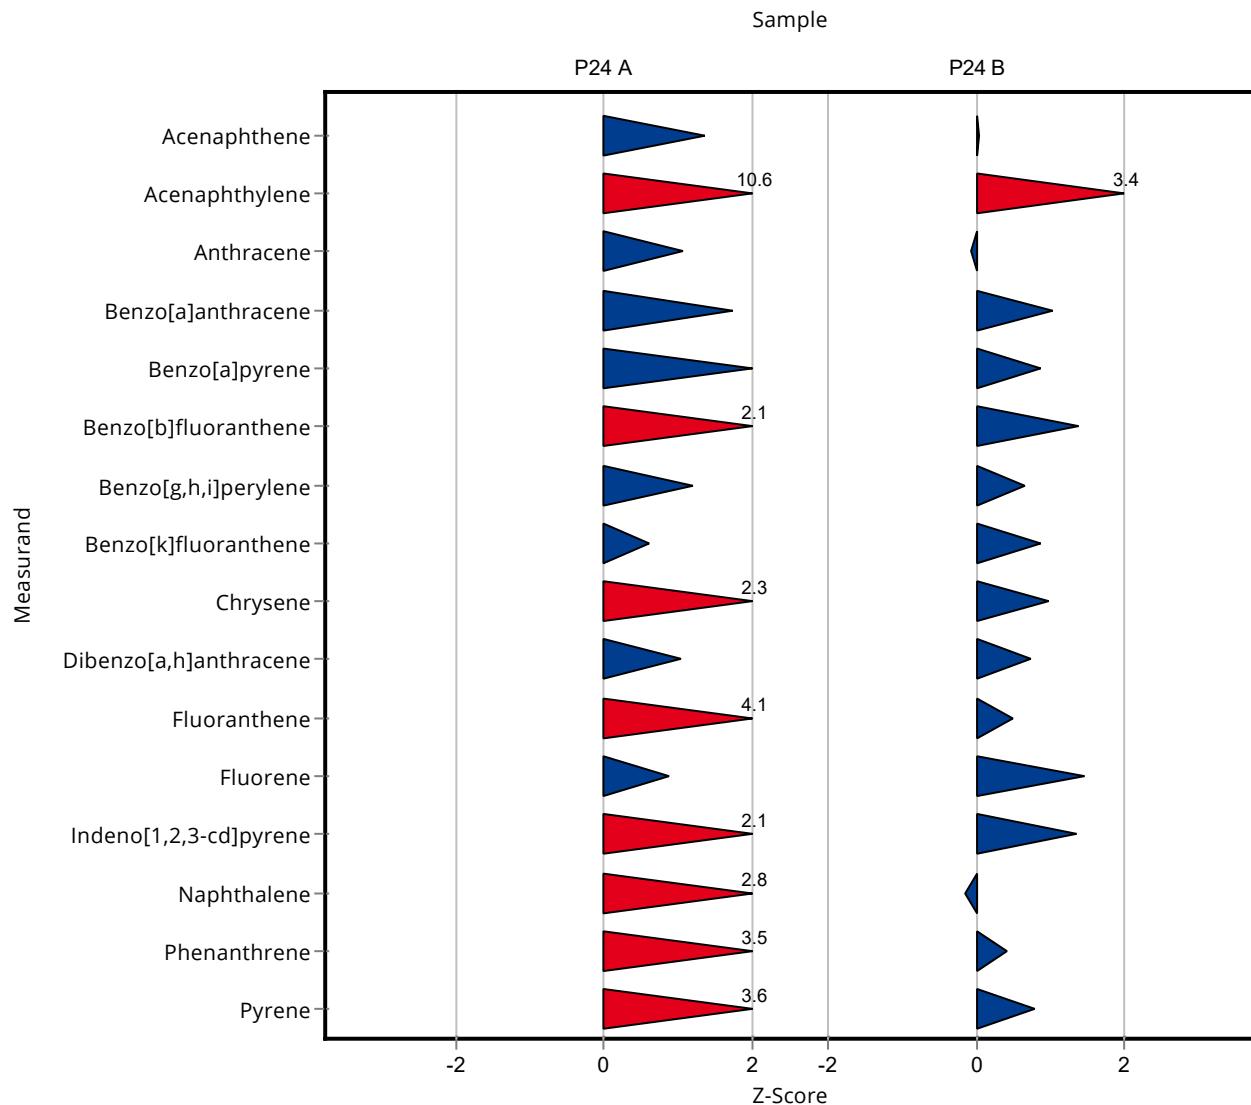


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	33.55 ± 14.76	5.08	126	0.23
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	87.24 ± 38.385	5.89	355	0.82
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	31.29 ± 13.769	6.39	127	0.24
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	31.02 ± 13.65	4.77	136	0.30
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	23.26 ± 10.233	3.78	148	0.37
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	32.31 ± 14.218	4.05	136	0.30
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	32 ± 14.081	7.43	138	0.31
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	25 ± 10.999	5.61	116	0.16
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	40.63 ± 17.879	5.91	151	0.38
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	33.5 ± 14.739	7.7	131	0.27
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	47.15 ± 20.744	4.9	173	0.48
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.75 ± 13.529	3.83	112	0.12
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	30.02 ± 13.21	4.23	142	0.33
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	57.29 ± 25.209	7.6	158	0.42
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	61.62 ± 27.115	9.18	208	0.59
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	39.86 ± 17.54	4.06	157	0.41

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	180.51 ± 79.425	34.1	101	0.01
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	259.36 ± 114.119	34.4	181	0.51
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	178.24 ± 78.427	47.2	98.2	-0.02
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	178.37 ± 78.485	30.8	122	0.20
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177.73 ± 78.202	35.4	121	0.19
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	169.17 ± 74.433	23.3	123	0.22

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	182.91 ± 80.481	48.6	120	0.19
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	187.59 ± 82.541	39.9	122	0.21
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	218.9 ± 96.314	39.7	121	0.20
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	159.32 ± 70.102	39.2	122	0.20
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	195.77 ± 86.14	32.3	109	0.09
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	157.42 ± 69.265	18.3	120	0.19
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	138.4 ± 60.897	20.1	124	0.22
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	176.82 ± 77.801	38.3	96.9	-0.04
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	190.81 ± 83.956	26.9	106	0.07
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	202.21 ± 88.971	28.7	113	0.13

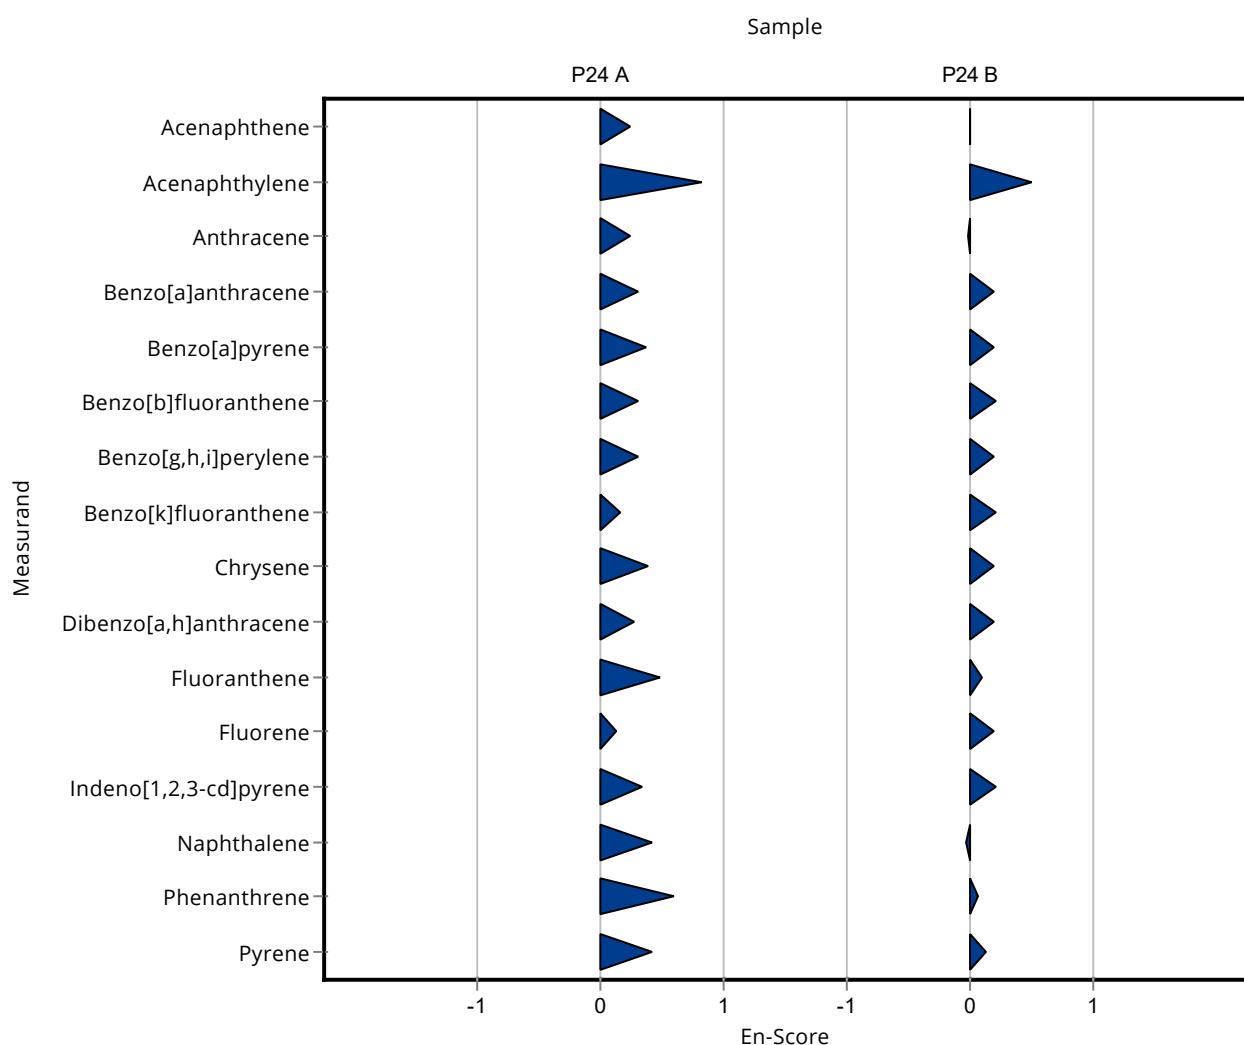


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<0.5 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<0.5 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	9.55 ± 0.1	6.39	38.8	-2.35
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	5.59 ± 0.24	4.77	24.6	-3.59
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	1.29 ± 0.36	3.78	8.19	-3.83
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	1.33 ± 0.55	4.05	5.59	-5.55
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	1.43 ± 0.49	7.43	6.16	-2.93
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	1.37 ± 0.15	5.61	6.35	-3.60
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	41.93 ± 1.24	5.91	156	2.54
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	1.67 ± 0.25	7.7	6.51	-3.12
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	59.59 ± 3.21	4.9	219	6.60
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<0.5 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	1.57 ± 0.29	4.23	7.42	-4.63
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<0.5 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	12.61 ± 1.21	9.18	42.6	-1.85
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	58.54 ± 2.14	4.06	230	8.15

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	<0.5 (LOQ) ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	<0.5 (LOQ) ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	339.5212 ± 0.1	47.2	187	3.35
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	20.9314 ± 0.24	30.8	14.3	-4.08
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	10.272 ± 0.36	35.4	6.97	-3.88
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	12.0203 ± 0.55	23.3	8.77	-5.37
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	3.24 ± 0.49	48.6	2.13	-3.06
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	13.4306 ± 0.15	39.9	8.76	-3.51
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	291.73 ± 0.15	39.7	162	2.81
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	3.1903 ± 0.15	39.2	2.44	-3.25
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	457.401 ± 3.21	32.3	255	8.59
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	<0.5 (LOQ) ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	9.5503 ± 0.29	20.1	8.57	-5.08

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]		
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	<0.5 (LOQ) ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	274.38 ± 1.21	26.9	153	3.52
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	449.25 ± 2.14	28.7	251	9.41

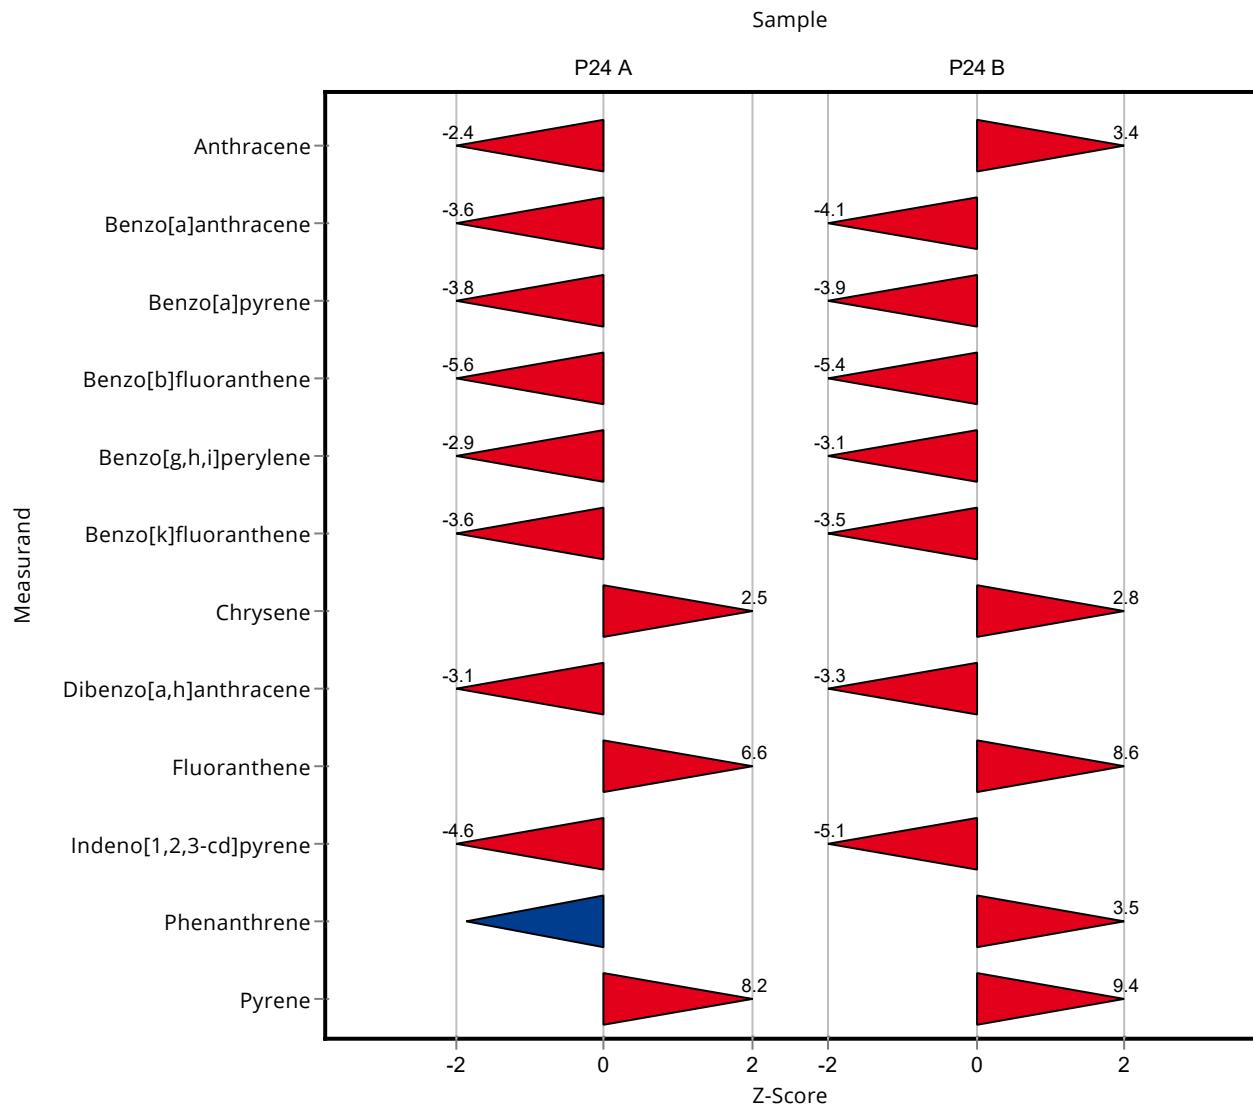


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<0.5 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<0.5 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	9.55 ± 0.1	6.39	38.8	-13.52
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	5.59 ± 0.24	4.77	24.6	-11.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	1.29 ± 0.36	3.78	8.19	-9.36
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	1.33 ± 0.55	4.05	5.59	-12.00
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	1.43 ± 0.49	7.43	6.16	-10.88
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	1.37 ± 0.15	5.61	6.35	-17.54
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	41.93 ± 1.24	5.91	156	5.47
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	1.67 ± 0.25	7.7	6.51	-14.60
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	59.59 ± 3.21	4.9	219	4.91
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<0.5 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	1.57 ± 0.29	4.23	7.42	-11.67
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<0.5 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	12.61 ± 1.21	9.18	42.6	-3.90
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	58.54 ± 2.14	4.06	230	7.27

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	<0.5 (LOQ) ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	<0.5 (LOQ) ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	339.5212 ± 0.1	47.2	187	20.64
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	20.9314 ± 0.24	30.8	14.3	-16.34
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	10.272 ± 0.36	35.4	6.97	-15.86
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	12.0203 ± 0.55	23.3	8.77	-15.18

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	3.24 ± 0.49	48.6	2.13 -12.73
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	13.4306 ± 0.15	39.9	8.76 -16.63
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	291.73 ± 0.15	39.7	162 14.28
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	3.1903 ± 0.15	39.2	2.44 -6.62
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	457.401 ± 3.21	32.3	255 25.85
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	<0.5 (LOQ) ± -	18.3	- -
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	9.5503 ± 0.29	20.1	8.57 -13.67
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	<0.5 (LOQ) ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	274.38 ± 1.21	26.9	153 6.82
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	449.25 ± 2.14	28.7	251 29.50

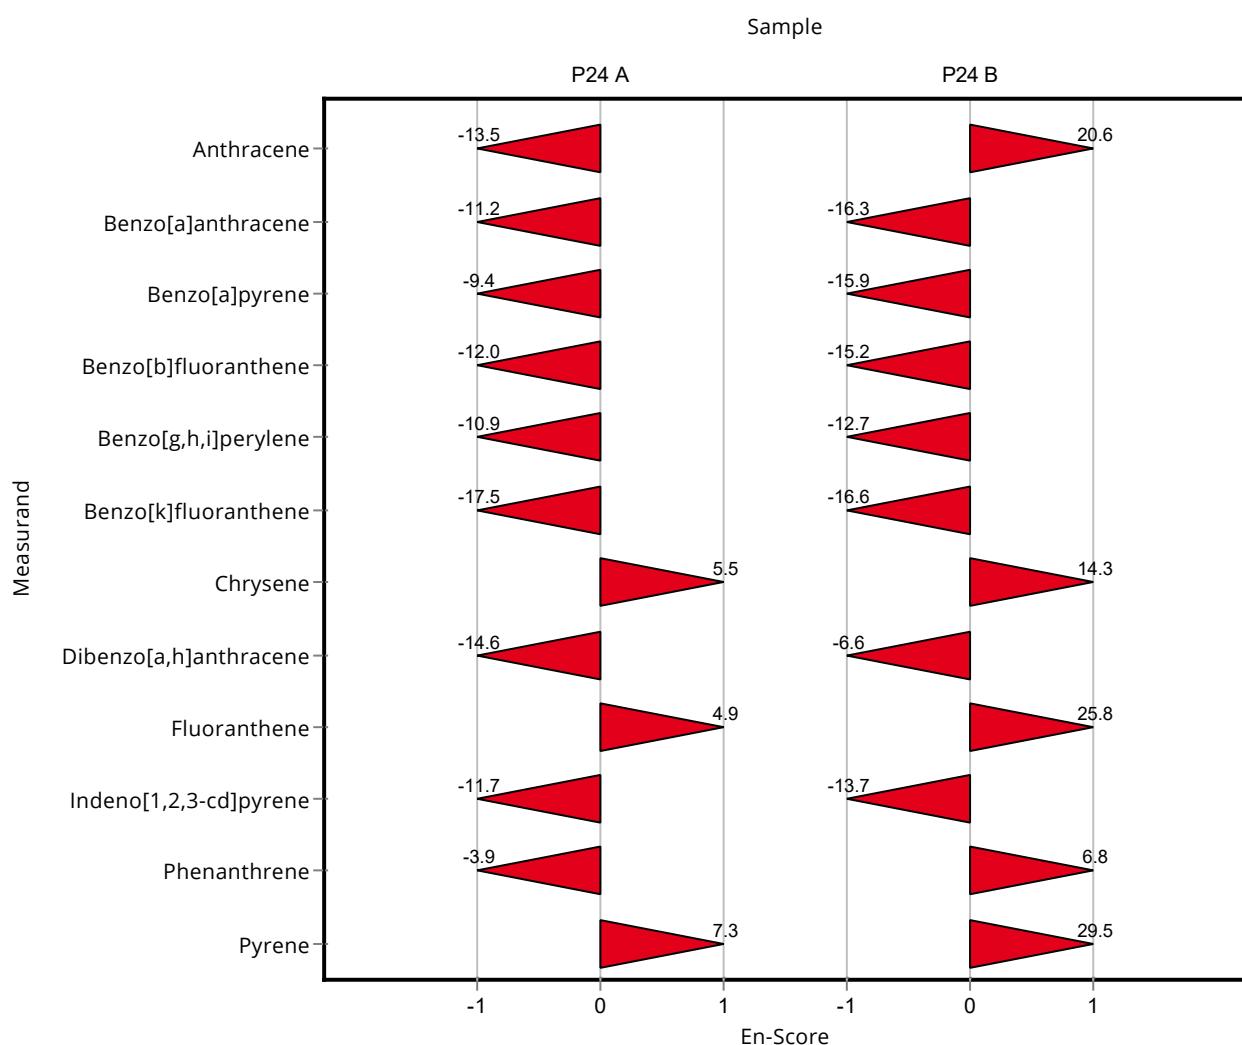


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.35 ± 0.49	5.08	98.6	-0.07
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.78 ± 0.65	5.89	105	0.21
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.2 ± 0.14	6.39	102	0.09
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.06 ± 0.44	4.77	106	0.28
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<20 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.26 ± 0.19	4.05	106	0.36
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.02 ± 0.86	7.43	99.2	-0.03
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.91 ± 0.6	5.61	102	0.06
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<30 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.32 ± 1	7.7	98.7	-0.04
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.81 ± 1.06	4.9	106	0.32
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.99 ± 0.49	3.83	98.6	-0.10
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.13 ± 0.42	4.23	99.9	-0.01
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33.51 ± 0.72	7.6	92.6	-0.35
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	27.34 ± 0.77	9.18	92.3	-0.25
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.51 ± 0.8	4.06	108	0.52

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	166.7 ± 3.17	34.1	92.8	-0.38
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	134.6 ± 1.82	34.4	93.9	-0.25
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	172 ± 2.25	47.2	94.8	-0.20
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152.4 ± 1.45	30.8	104	0.19
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153.7 ± 3.44	35.4	104	0.18
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	145.3 ± 1.67	23.3	106	0.36
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	160 ± 0.93	48.6	105	0.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	156.9 ± 0.69	39.9	102	0.09
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	172.1 ± 5.44	39.7	95.4	-0.21
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	152 ± 1.47	39.2	116	0.55
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	181.4 ± 4.04	32.3	101	0.05
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	119 ± 2.2	18.3	91	-0.64
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	109.7 ± 0.88	20.1	98.5	-0.08

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	172.9 ± 1.31	38.3	94.8
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	158.2 ± 2.24	26.9	88.1
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	181.4 ± 3.73	28.7	101

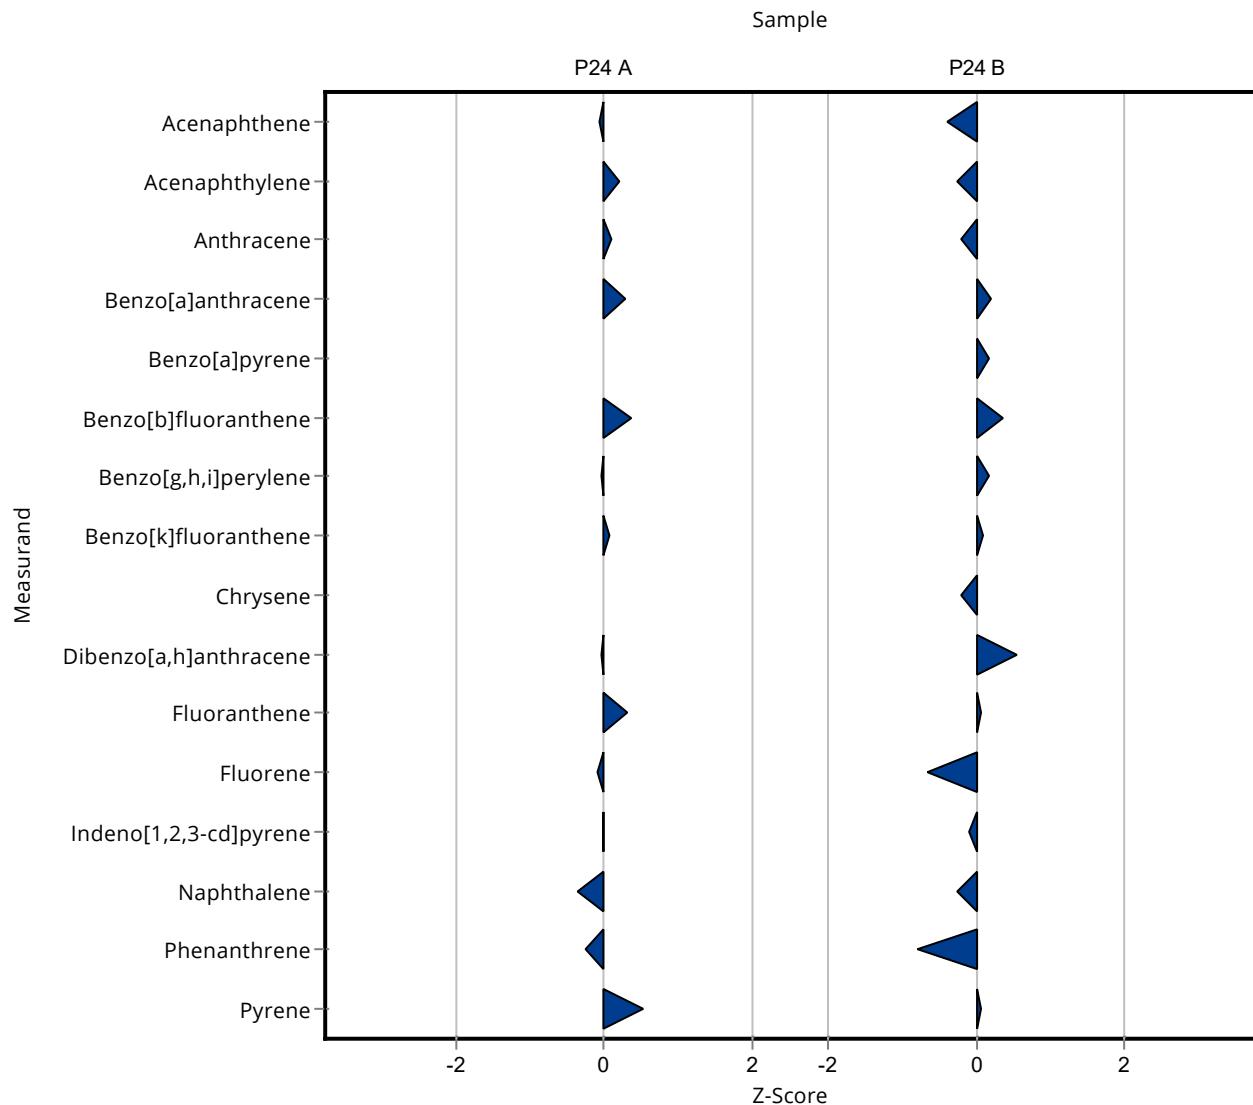


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.35 ± 0.49	5.08	98.6	-0.21
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.78 ± 0.65	5.89	105	0.40
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.2 ± 0.14	6.39	102	0.54
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.06 ± 0.44	4.77	106	0.78
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<20 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.26 ± 0.19	4.05	106	0.94
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.02 ± 0.86	7.43	99.2	-0.08
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.91 ± 0.6	5.61	102	0.20
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<30 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.32 ± 1	7.7	98.7	-0.13
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.81 ± 1.06	4.9	106	0.61
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.99 ± 0.49	3.83	98.6	-0.24
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.13 ± 0.42	4.23	99.9	-0.02
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33.51 ± 0.72	7.6	92.6	-0.70
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	27.34 ± 0.77	9.18	92.3	-0.58
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.51 ± 0.8	4.06	108	0.94

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	166.7 ± 3.17	34.1	92.8	-1.09
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	134.6 ± 1.82	34.4	93.9	-0.80
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	172 ± 2.25	47.2	94.8	-1.07
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152.4 ± 1.45	30.8	104	0.70
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153.7 ± 3.44	35.4	104	0.57
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	145.3 ± 1.67	23.3	106	0.94

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	160 ± 0.93	48.6	105	0.69
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	156.9 ± 0.69	39.9	102	0.42
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	172.1 ± 5.44	39.7	95.4	-0.61
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	152 ± 1.47	39.2	116	1.10
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	181.4 ± 4.04	32.3	101	0.15
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	119 ± 2.2	18.3	91	-1.34
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	109.7 ± 0.88	20.1	98.5	-0.22
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	172.9 ± 1.31	38.3	94.8	-0.74
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	158.2 ± 2.24	26.9	88.1	-1.48
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	181.4 ± 3.73	28.7	101	0.19

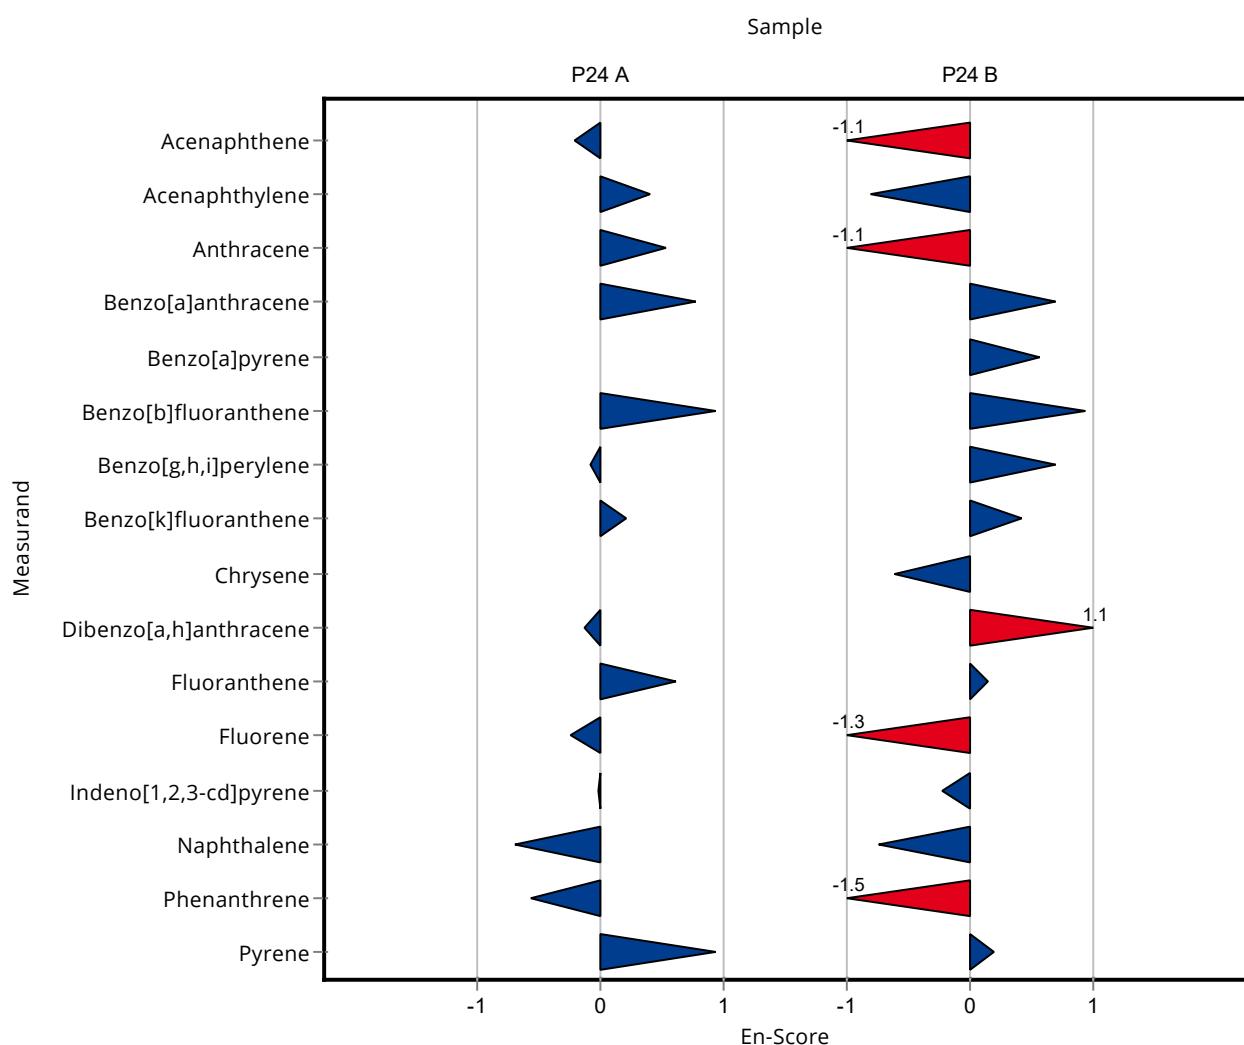


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	21.27 ± 18.29	3.78	135	1.46
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	- ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	- ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	- ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenz[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	- ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	165.27 ± 142.14	35.4	112	0.50
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	- ± -	23.3	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	- ± -	48.6	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	- ± -	39.9	-	-
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenz[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	- ± -	20.1	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	- -

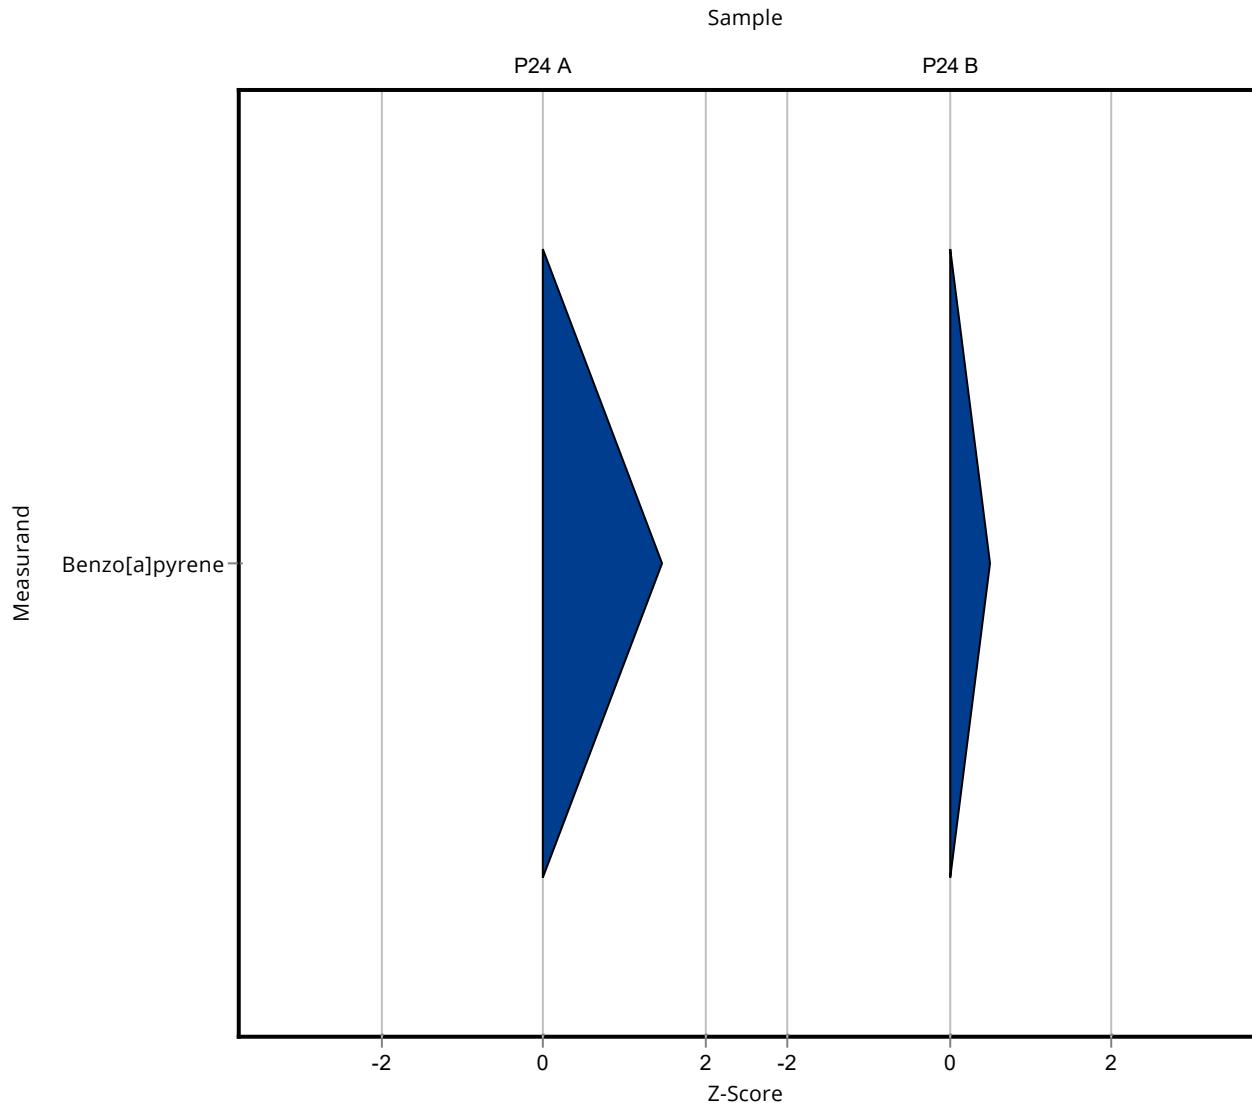


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	21.27 ± 18.29	3.78	135	0.15
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	- ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	- ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	- ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	- ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	165.27 ± 142.14	35.4	112	0.06
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	- ± -	23.3	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	- ± -	48.6	- -
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	- ± -	39.9	- -
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	- -
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	- -
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	- -
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	- -
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	- ± -	20.1	- -
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	- -

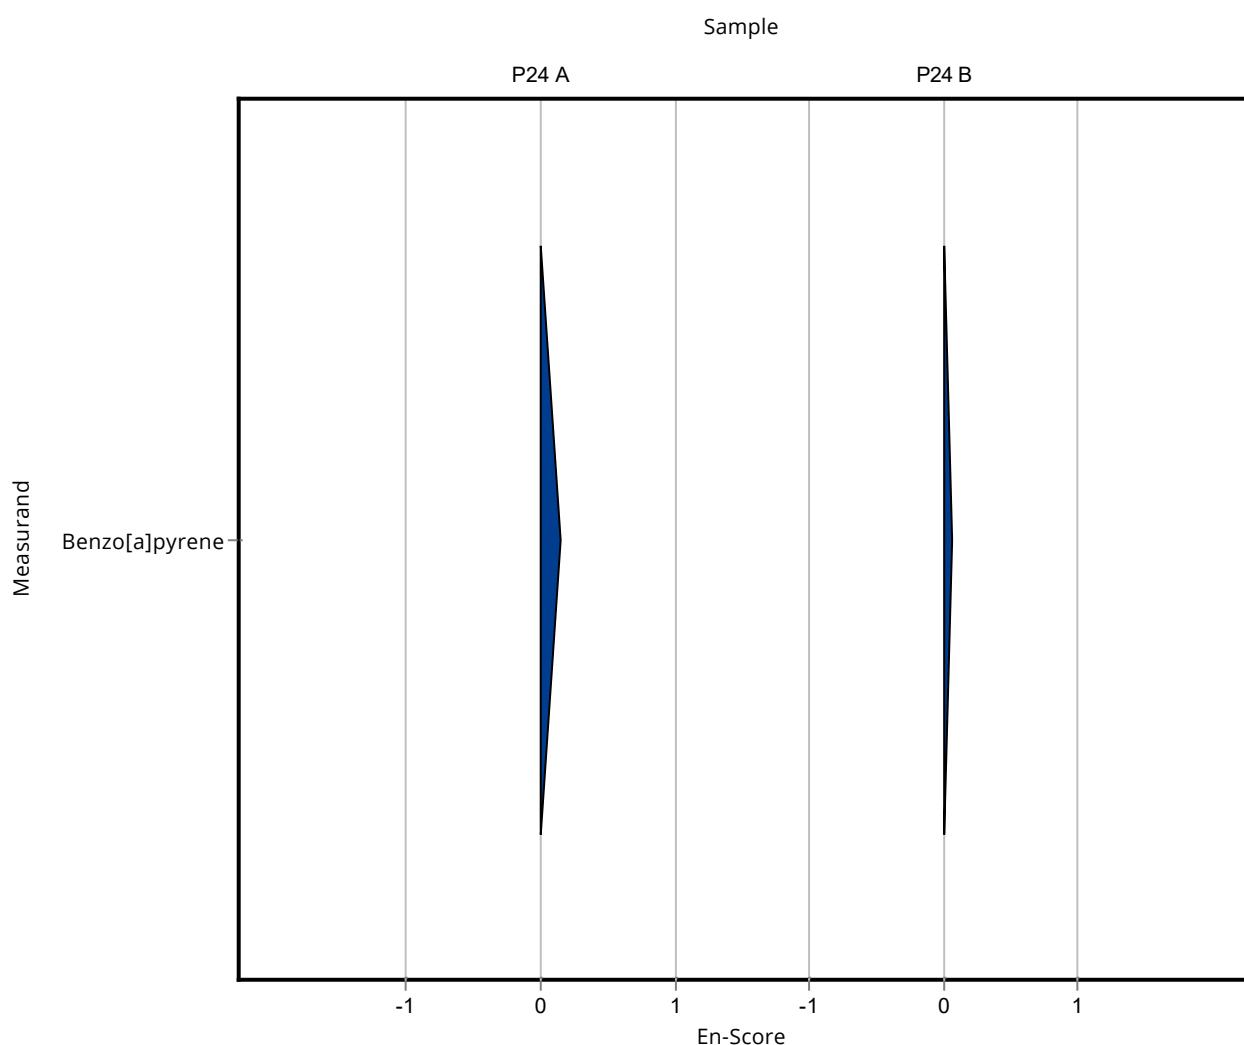


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28 ± 7	5.08	105	0.25
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	27 ± 7	5.89	110	0.42
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	26 ± 7	6.39	106	0.22
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	17 ± 4	4.77	74.8	-1.20
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	13 ± 3	3.78	82.5	-0.73
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19 ± 5	4.05	79.8	-1.19
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	17 ± 4	7.43	73.2	-0.84
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	17 ± 4	5.61	78.8	-0.82
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23 ± 6	5.91	85.6	-0.66
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	17 ± 4	7.7	66.2	-1.13
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	24 ± 6	4.9	88.1	-0.66
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27 ± 7	3.83	98.7	-0.10
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17 ± 4	4.23	80.3	-0.98
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35 ± 8	7.6	96.7	-0.16
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	27 ± 7	9.18	91.2	-0.28
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24 ± 6	4.06	94.5	-0.35

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	206 ± 49	34.1	115	0.78
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	157 ± 38	34.4	110	0.40
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	198 ± 48	47.2	109	0.35
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	136 ± 33	30.8	92.8	-0.34
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	134 ± 32	35.4	90.9	-0.38
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	126 ± 30	23.3	92	-0.47
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	147 ± 35	48.6	96.8	-0.10
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	145 ± 35	39.9	94.6	-0.21
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	179 ± 43	39.7	99.3	-0.03
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	116 ± 28	39.2	88.8	-0.37
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	183 ± 44	32.3	102	0.10
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	136 ± 33	18.3	104	0.28
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	100 ± 24	20.1	89.8	-0.57

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	204 ± 49	38.3	112
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	191 ± 46	26.9	106
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	187 ± 45	28.7	104

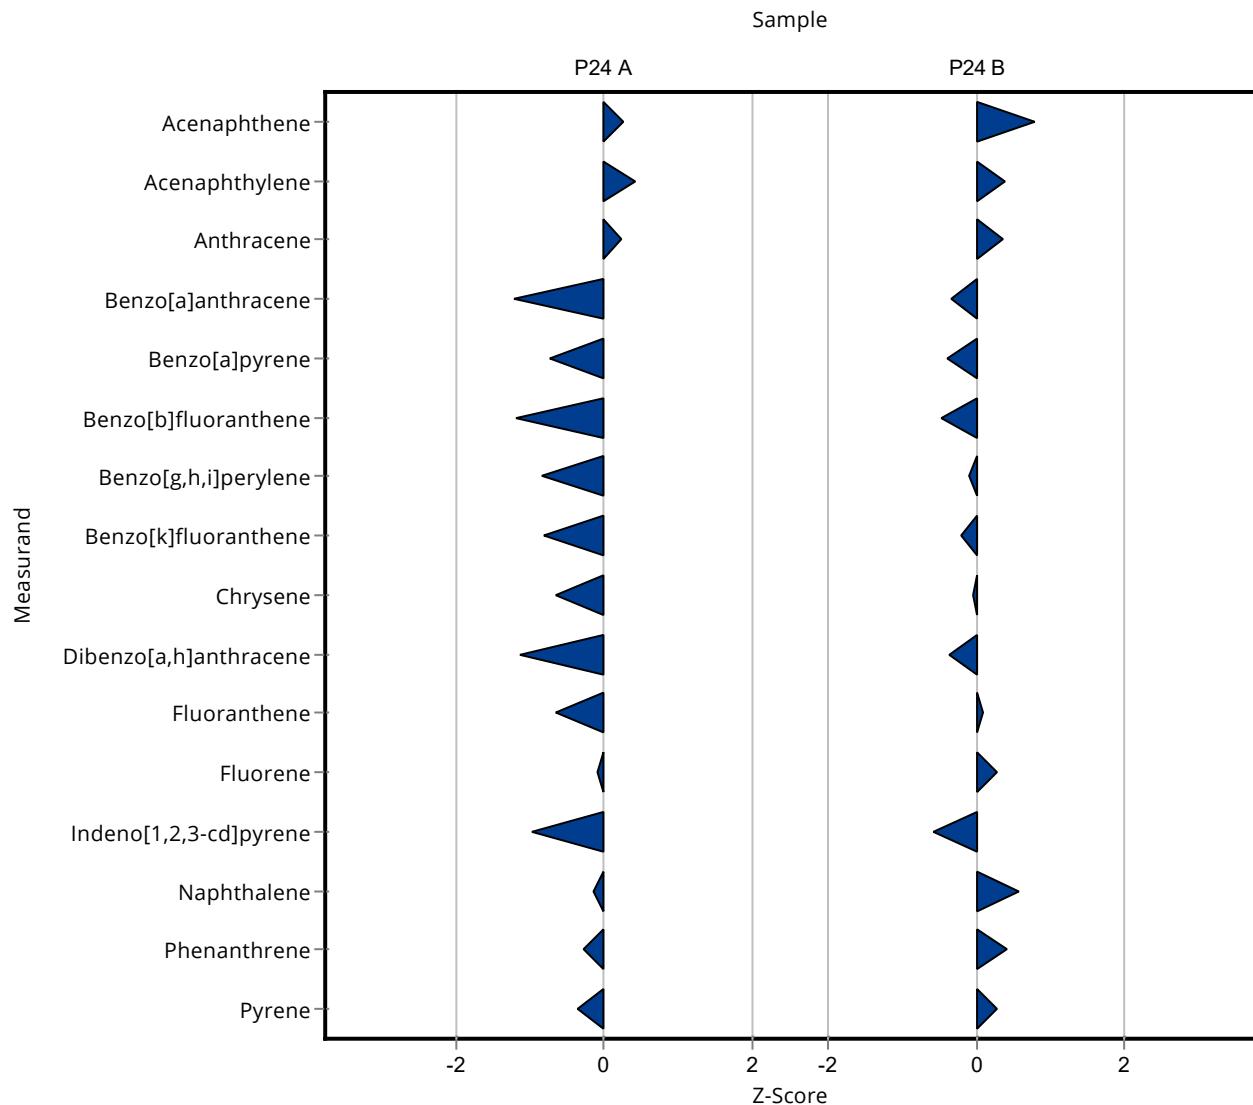


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28 ± 7	5.08	105	0.09
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	27 ± 7	5.89	110	0.17
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	26 ± 7	6.39	106	0.10
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	17 ± 4	4.77	74.8	-0.71
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	13 ± 3	3.78	82.5	-0.45
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19 ± 5	4.05	79.8	-0.47
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	17 ± 4	7.43	73.2	-0.76
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	17 ± 4	5.61	78.8	-0.57
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23 ± 6	5.91	85.6	-0.32
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	17 ± 4	7.7	66.2	-1.06
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	24 ± 6	4.9	88.1	-0.27
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27 ± 7	3.83	98.7	-0.03
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	17 ± 4	4.23	80.3	-0.51
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35 ± 8	7.6	96.7	-0.07
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	27 ± 7	9.18	91.2	-0.18
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24 ± 6	4.06	94.5	-0.12

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	206 ± 49	34.1	115	0.27
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	157 ± 38	34.4	110	0.18
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	198 ± 48	47.2	109	0.17
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	136 ± 33	30.8	92.8	-0.16
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	134 ± 32	35.4	90.9	-0.21
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	126 ± 30	23.3	92	-0.18

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	147 ± 35	48.6	96.8	-0.07
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	145 ± 35	39.9	94.6	-0.12
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	179 ± 43	39.7	99.3	-0.02
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	116 ± 28	39.2	88.8	-0.25
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	183 ± 44	32.3	102	0.04
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	136 ± 33	18.3	104	0.08
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	100 ± 24	20.1	89.8	-0.23
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	204 ± 49	38.3	112	0.22
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	191 ± 46	26.9	106	0.12
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	187 ± 45	28.7	104	0.09

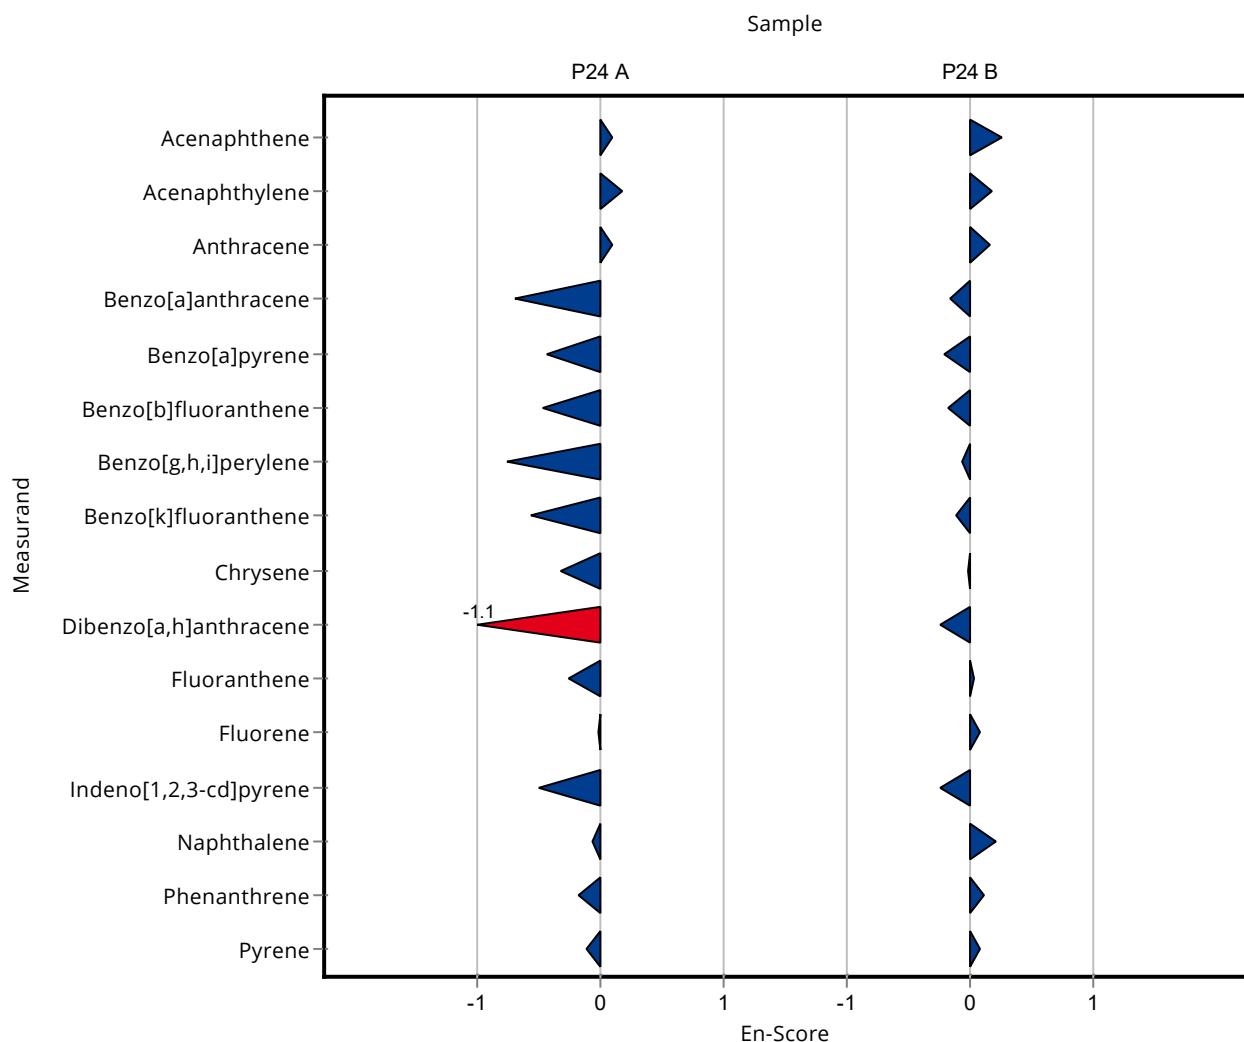


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.1 ± 1.18	5.08	97.7	-0.12
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	89.5 ± 1.57	5.89	365	11.03
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	22.5 ± 1.37	6.39	91.5	-0.33
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.2 ± 1.55	4.77	106	0.31
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15.4 ± 1.36	3.78	97.8	-0.09
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	26.2 ± 1.04	4.05	110	0.59
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.8 ± 1.05	7.43	120	0.62
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.4 ± 1	5.61	108	0.32
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.1 ± 1.17	5.91	101	0.04
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	28.3 ± 0.89	7.7	110	0.34
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.3 ± 1.21	4.9	104	0.22
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27.5 ± 1.42	3.83	100	0.03
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.4 ± 1.05	4.23	115	0.77
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.2 ± 1.61	7.6	122	1.05
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	29 ± 1.27	9.18	97.9	-0.07
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.2 ± 0.98	4.06	107	0.44

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	180 ± 4.81	34.1	100	0.01
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	211 ± 5.19	34.4	147	1.97
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	199 ± 5.65	47.2	110	0.37
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	159 ± 6.22	30.8	108	0.40
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	169 ± 5.41	35.4	115	0.61
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	154 ± 4.17	23.3	112	0.73
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	189 ± 4.29	48.6	124	0.76
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	170 ± 4.04	39.9	111	0.42
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	192 ± 4.77	39.7	106	0.29
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	162 ± 3.58	39.2	124	0.80
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194 ± 5	32.3	108	0.44
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	131 ± 5.67	18.3	100	0.01
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126 ± 4.18	20.1	113	0.73

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score	
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	197 ± 6.69	38.3	108	0.38
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	182 ± 5.18	26.9	101	0.09
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	201 ± 3.9	28.7	112	0.76

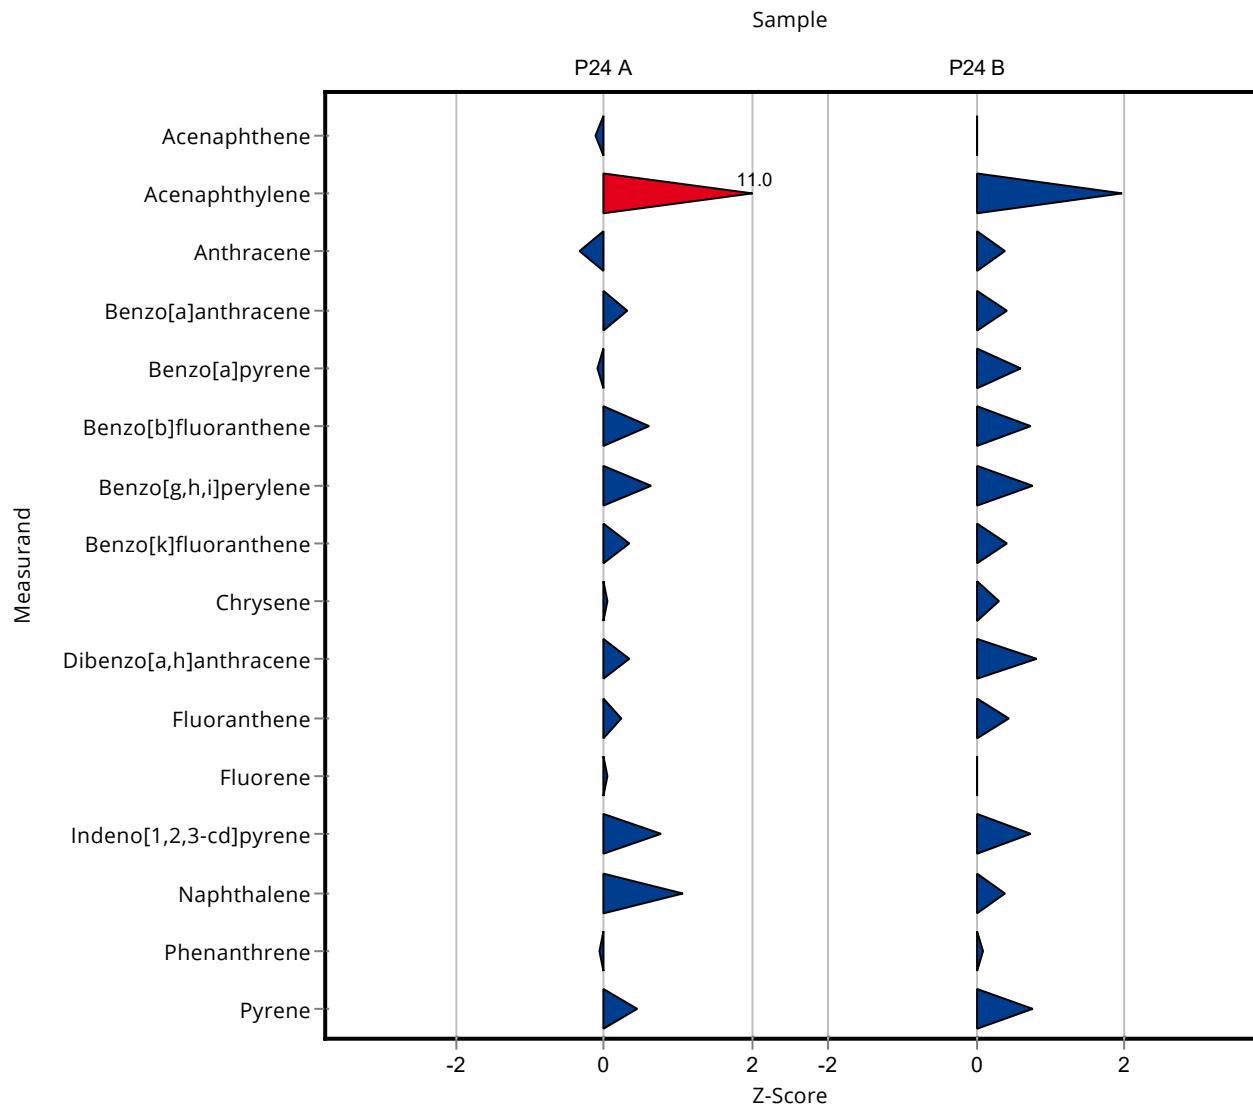


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	26.1 ± 1.18	5.08	97.7	-0.22
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	89.5 ± 1.57	5.89	365	15.34
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	22.5 ± 1.37	6.39	91.5	-0.71
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.2 ± 1.55	4.77	106	0.43
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15.4 ± 1.36	3.78	97.8	-0.11
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	26.2 ± 1.04	4.05	110	0.93
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.8 ± 1.05	7.43	120	1.68
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.4 ± 1	5.61	108	0.80
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.1 ± 1.17	5.91	101	0.08
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	28.3 ± 0.89	7.7	110	1.11
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.3 ± 1.21	4.9	104	0.38
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	27.5 ± 1.42	3.83	100	0.04
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.4 ± 1.05	4.23	115	1.23
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	44.2 ± 1.61	7.6	122	1.67
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	29 ± 1.27	9.18	97.9	-0.14
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.2 ± 0.98	4.06	107	0.71

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	180 ± 4.81	34.1	100	0.03
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	211 ± 5.19	34.4	147	4.61
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	199 ± 5.65	47.2	110	1.29
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	159 ± 6.22	30.8	108	0.85
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	169 ± 5.41	35.4	115	1.56
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	154 ± 4.17	23.3	112	1.46

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	189 ± 4.29	48.6	124	2.57
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	170 ± 4.04	39.9	111	1.43
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	192 ± 4.77	39.7	106	0.95
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	162 ± 3.58	39.2	124	1.53
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194 ± 5	32.3	108	1.09
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	131 ± 5.67	18.3	100	0.01
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126 ± 4.18	20.1	113	1.31
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	197 ± 6.69	38.3	108	0.79
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	182 ± 5.18	26.9	101	0.14
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	201 ± 3.9	28.7	112	1.93

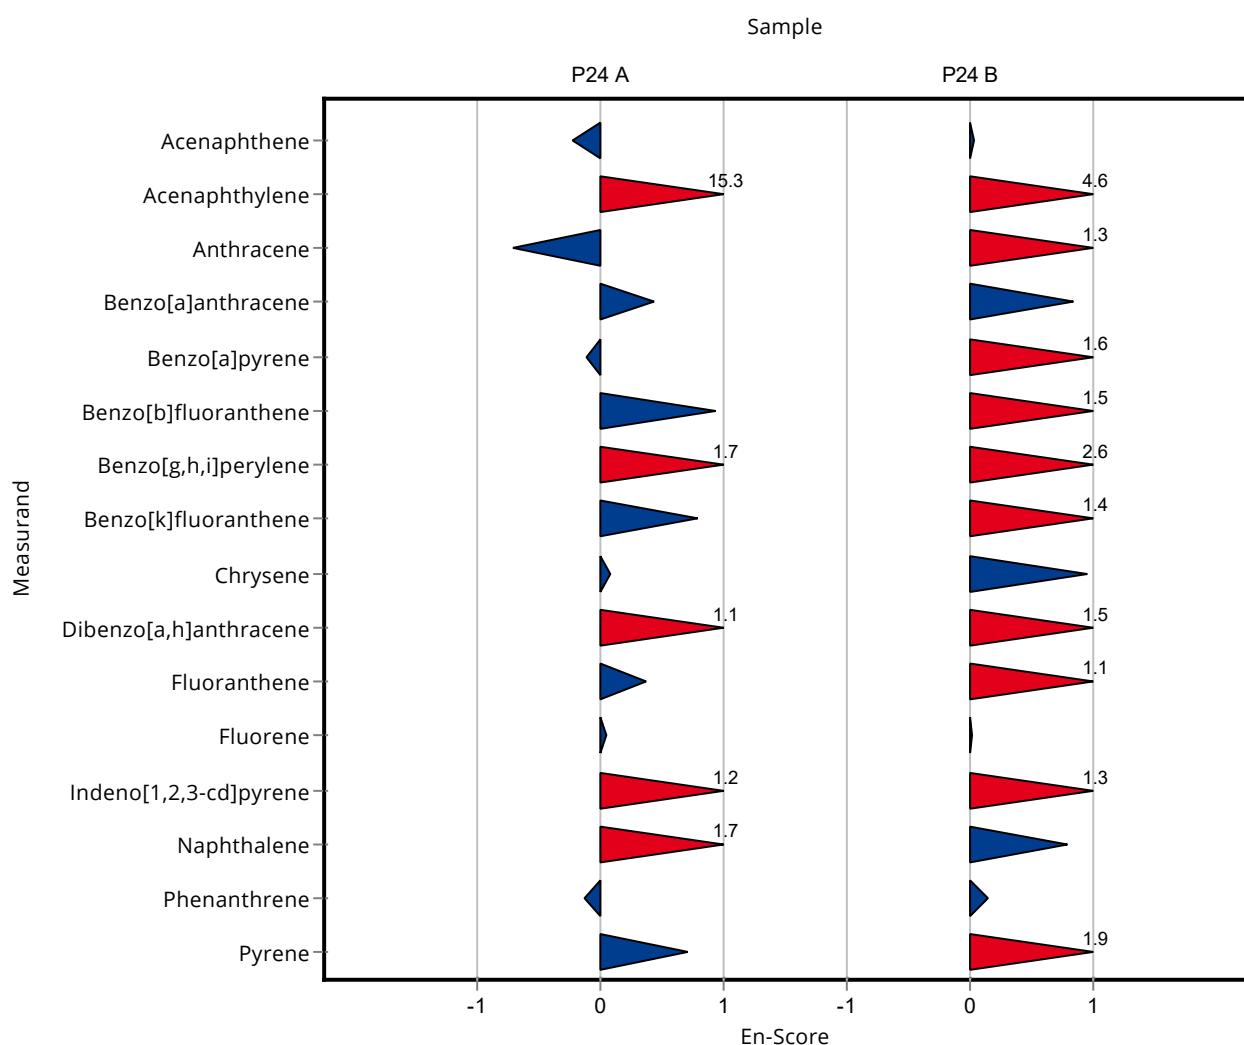


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28.5 ± 5.7	5.08	107	0.35
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.3 ± 5.7	5.89	115	0.64
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.7 ± 5.1	6.39	105	0.17
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.4 ± 4.9	4.77	107	0.35
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.8 ± 3.6	3.78	113	0.54
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.5 ± 5.1	4.05	107	0.42
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	26.4 ± 5.3	7.43	114	0.43
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.2 ± 4.8	5.61	112	0.47
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	29 ± 5.8	5.91	108	0.36
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	26.6 ± 5.3	7.7	104	0.12
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	30.4 ± 6.1	4.9	112	0.65
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.5 ± 5.9	3.83	108	0.56
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.6 ± 4.9	4.23	116	0.81
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.7 ± 7.5	7.6	104	0.20
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	35.9 ± 7.2	9.18	121	0.69
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	34.6 ± 6.9	4.06	136	2.26

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	178.3 ± 35.7	34.1	99.3	-0.04
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	142.4 ± 28.5	34.4	99.3	-0.03
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	186.1 ± 37.2	47.2	103	0.10
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152.8 ± 30.6	30.8	104	0.20
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	156.6 ± 31.3	35.4	106	0.26
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	133.2 ± 26.6	23.3	97.2	-0.16
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	173.6 ± 34.7	48.6	114	0.45
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	160.1 ± 32	39.9	104	0.17
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	189.8 ± 38	39.7	105	0.24
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	149.1 ± 29.8	39.2	114	0.47
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	182.5 ± 36.5	32.3	102	0.09
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	127.8 ± 25.6	18.3	97.7	-0.16
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126.1 ± 25.2	20.1	113	0.73

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	181.7 ± 36.3	38.3	99.6 -0.02
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	179.5 ± 35.9	26.9	100 0.00
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	185.3 ± 37.1	28.7	103 0.21

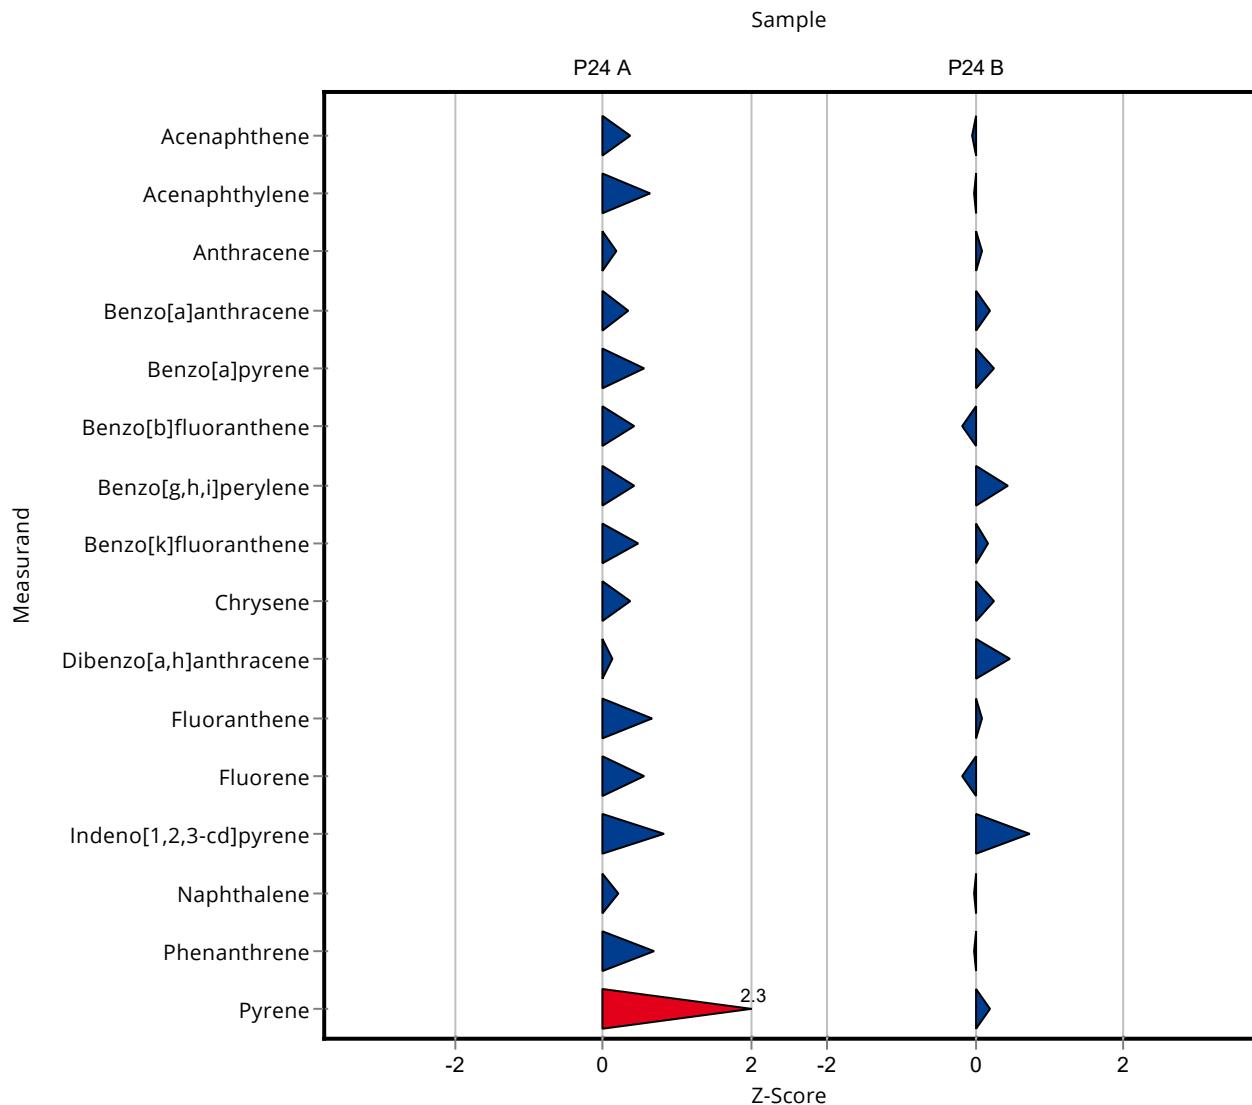


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28.5 ± 5.7	5.08	107	0.16
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.3 ± 5.7	5.89	115	0.32
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.7 ± 5.1	6.39	105	0.11
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.4 ± 4.9	4.77	107	0.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17.8 ± 3.6	3.78	113	0.28
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.5 ± 5.1	4.05	107	0.17
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	26.4 ± 5.3	7.43	114	0.30
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.2 ± 4.8	5.61	112	0.27
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	29 ± 5.8	5.91	108	0.18
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	26.6 ± 5.3	7.7	104	0.09
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	30.4 ± 6.1	4.9	112	0.26
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.5 ± 5.9	3.83	108	0.18
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	24.6 ± 4.9	4.23	116	0.35
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.7 ± 7.5	7.6	104	0.10
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	35.9 ± 7.2	9.18	121	0.42
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	34.6 ± 6.9	4.06	136	0.66

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	178.3 ± 35.7	34.1	99.3	-0.02
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	142.4 ± 28.5	34.4	99.3	-0.02
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	186.1 ± 37.2	47.2	103	0.06
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152.8 ± 30.6	30.8	104	0.10
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	156.6 ± 31.3	35.4	106	0.14
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	133.2 ± 26.6	23.3	97.2	-0.07

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	173.6 ± 34.7	48.6	114	0.31
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	160.1 ± 32	39.9	104	0.11
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	189.8 ± 38	39.7	105	0.12
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	149.1 ± 29.8	39.2	114	0.30
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	182.5 ± 36.5	32.3	102	0.04
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	127.8 ± 25.6	18.3	97.7	-0.06
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	126.1 ± 25.2	20.1	113	0.29
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	181.7 ± 36.3	38.3	99.6	-0.01
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	179.5 ± 35.9	26.9	100	0.00
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	185.3 ± 37.1	28.7	103	0.08

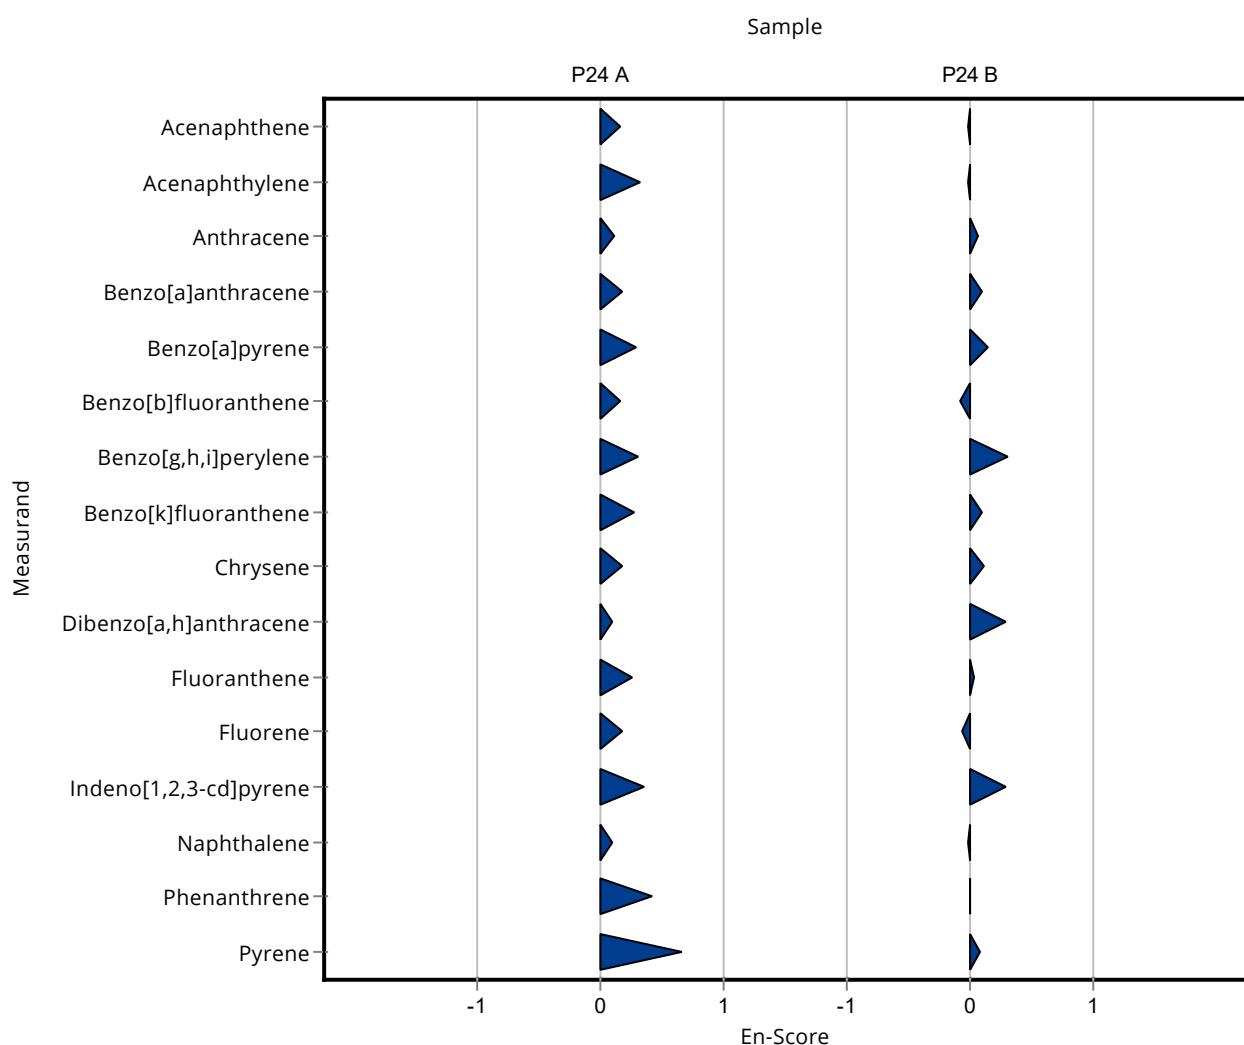


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	22.6 ± 7.91	5.08	84.6	-0.81
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.3 ± 9.21	5.89	107	0.30
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	23.7 ± 8.3	6.39	96.4	-0.14
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.7 ± 7.95	4.77	99.8	-0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16 ± 5.6	3.78	102	0.07
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	22.6 ± 7.91	4.05	95	-0.30
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	20.3 ± 7.11	7.43	87.4	-0.39
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	20.4 ± 7.14	5.61	94.5	-0.21
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	24.1 ± 8.44	5.91	89.7	-0.47
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.7 ± 8.3	7.7	92.4	-0.25
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	24.1 ± 8.44	4.9	88.5	-0.64
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	25.5 ± 8.93	3.83	93.2	-0.49
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	20.5 ± 7.18	4.23	96.9	-0.16
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	30.8 ± 10.8	7.6	85.1	-0.71
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	25.3 ± 8.86	9.18	85.4	-0.47
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24.1 ± 8.44	4.06	94.9	-0.32

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	157 ± 55	34.1	87.4	-0.66
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	143 ± 50.1	34.4	99.8	-0.01
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	175 ± 61.3	47.2	96.4	-0.14
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	144 ± 50.4	30.8	98.2	-0.09
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	157 ± 55	35.4	106	0.27
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	141 ± 49.4	23.3	103	0.17
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	136 ± 47.6	48.6	89.6	-0.33
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	150 ± 52.5	39.9	97.9	-0.08
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	175 ± 61.3	39.7	97.1	-0.13
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	105 ± 36.8	39.2	80.4	-0.65
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	178 ± 62.3	32.3	99.1	-0.05
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	118 ± 41.3	18.3	90.2	-0.70
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	110 ± 38.5	20.1	98.7	-0.07

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	161 ± 56.4	38.3	88.3 -0.56
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	158 ± 55.3	26.9	88 -0.80
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	174 ± 60.9	28.7	97 -0.19

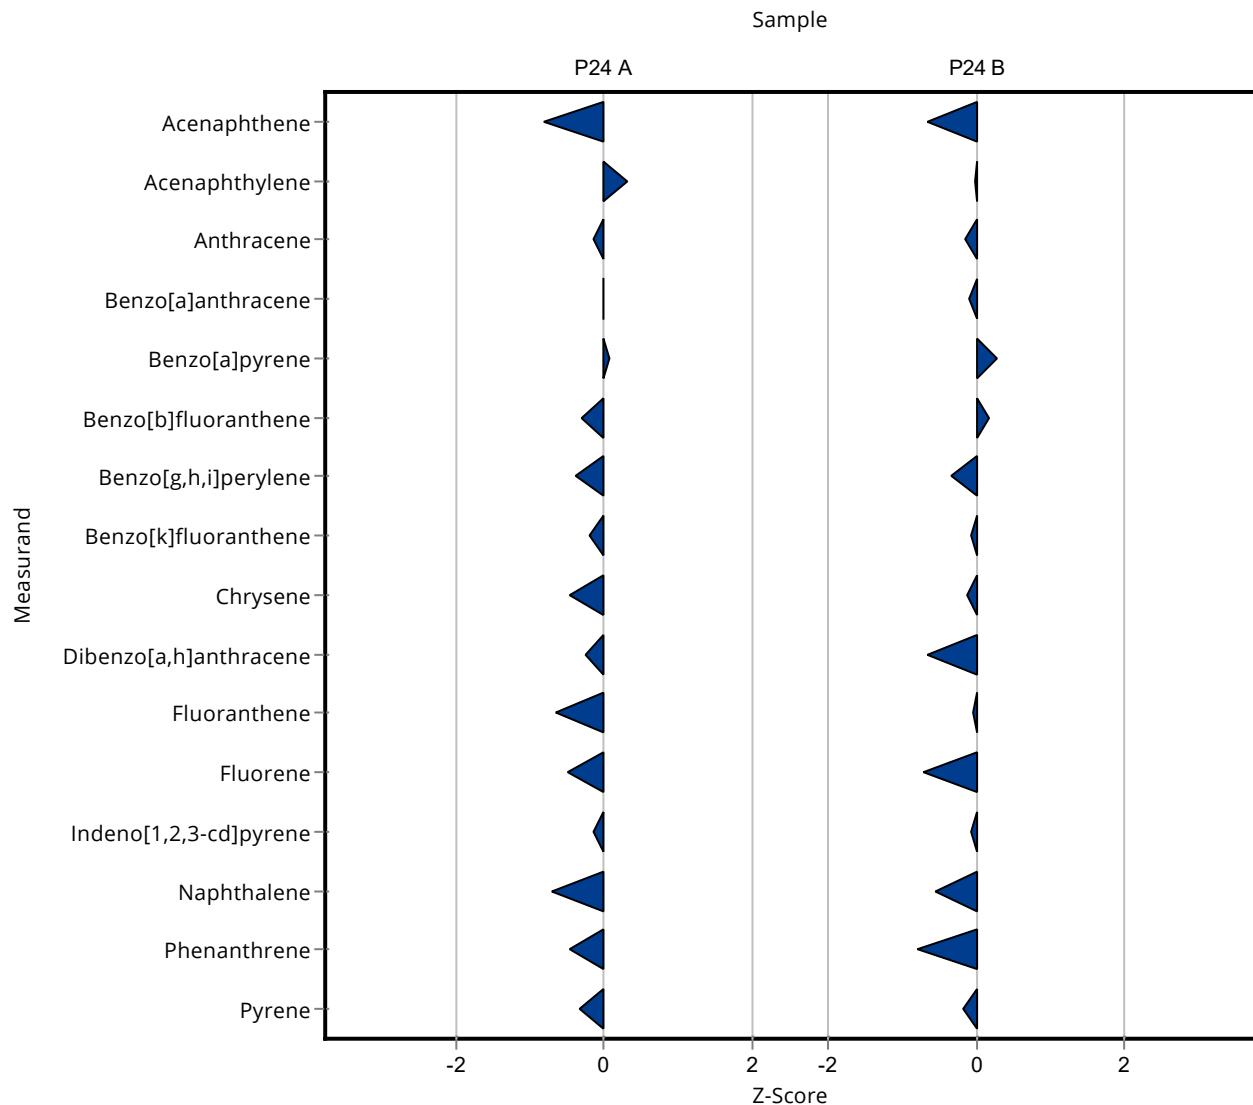


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	22.6 ± 7.91	5.08	84.6	-0.26
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.3 ± 9.21	5.89	107	0.09
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	23.7 ± 8.3	6.39	96.4	-0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.7 ± 7.95	4.77	99.8	0.00
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16 ± 5.6	3.78	102	0.02
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	22.6 ± 7.91	4.05	95	-0.08
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	20.3 ± 7.11	7.43	87.4	-0.20
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	20.4 ± 7.14	5.61	94.5	-0.08
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	24.1 ± 8.44	5.91	89.7	-0.16
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.7 ± 8.3	7.7	92.4	-0.12
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	24.1 ± 8.44	4.9	88.5	-0.18
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	25.5 ± 8.93	3.83	93.2	-0.10
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	20.5 ± 7.18	4.23	96.9	-0.05
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	30.8 ± 10.8	7.6	85.1	-0.25
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	25.3 ± 8.86	9.18	85.4	-0.24
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24.1 ± 8.44	4.06	94.9	-0.08

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	157 ± 55	34.1	87.4	-0.20
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	143 ± 50.1	34.4	99.8	0.00
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	175 ± 61.3	47.2	96.4	-0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	144 ± 50.4	30.8	98.2	-0.03
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	157 ± 55	35.4	106	0.09
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	141 ± 49.4	23.3	103	0.04

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	136 ± 47.6	48.6	89.6	-0.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	150 ± 52.5	39.9	97.9	-0.03
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	175 ± 61.3	39.7	97.1	-0.04
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	105 ± 36.8	39.2	80.4	-0.34
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	178 ± 62.3	32.3	99.1	-0.01
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	118 ± 41.3	18.3	90.2	-0.15
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	110 ± 38.5	20.1	98.7	-0.02
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	161 ± 56.4	38.3	88.3	-0.19
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	158 ± 55.3	26.9	88	-0.19
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	174 ± 60.9	28.7	97	-0.04

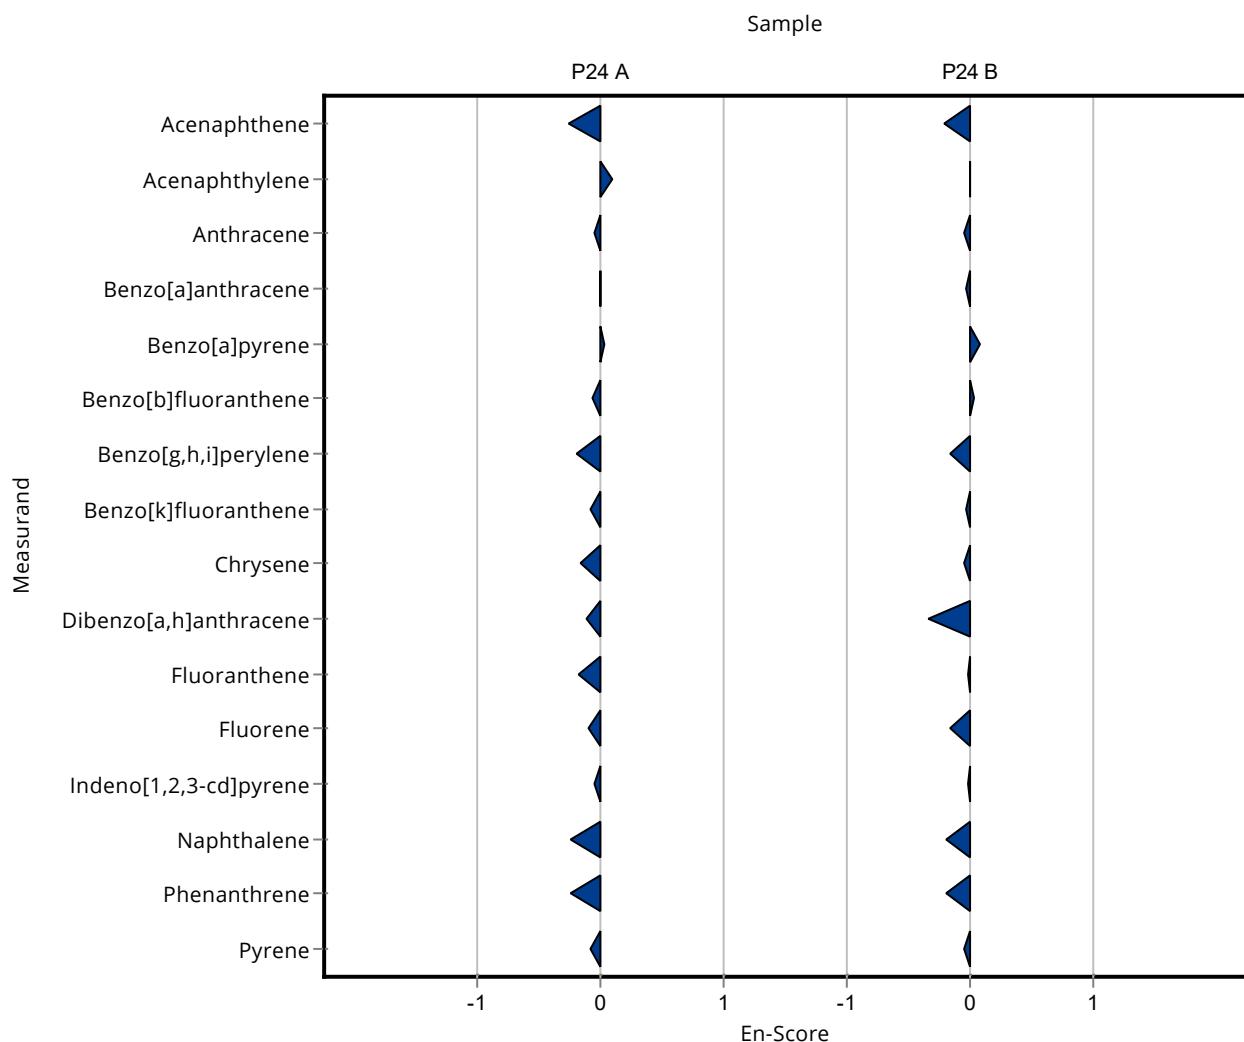


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	10.47 ± 2.3	5.08	39.2	-3.20
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	8.53 ± 1.88	5.89	34.8	-2.72
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	9.91 ± 2.18	6.39	40.3	-2.30
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	10.97 ± 2.41	3.78	69.7	-1.26
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	16.07 ± 3.54	4.05	67.5	-1.91
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	11.21 ± 2.24	7.43	48.3	-1.62
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	8.34 ± 1.83	5.61	38.6	-2.36
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	12.95 ± 2.85	7.7	50.5	-1.65
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	8.11 ± 1.78	4.9	29.8	-3.90
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	1.97 ± 0.43	3.83	7.2	-6.63
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	6.18 ± 1.36	4.23	29.2	-3.54
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	9.59 ± 2.11	7.6	26.5	-3.50
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	11.41 ± 2.28	9.18	38.5	-1.98
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	3.02 ± 0.66	4.06	11.9	-5.51

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	163.15 ± 35.89	34.1	90.9	-0.48
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	130.54 ± 28.72	34.4	91.1	-0.37
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	170.43 ± 37.49	47.2	93.9	-0.23
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	113.93 ± 25.06	35.4	77.3	-0.95
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	130.57 ± 28.73	23.3	95.3	-0.28
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	129.95 ± 28.59	48.6	85.6	-0.45
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	136.59 ± 30.05	39.9	89.1	-0.42
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	93.22 ± 20.51	39.2	71.4	-0.95
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	139.2 ± 30.62	32.3	77.5	-1.25
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	113.79 ± 25.03	18.3	87	-0.93
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	114.04 ± 25.09	20.1	102	0.13

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score [%]
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	135.14 ± 29.73	38.3	74.1 -1.23
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	137.9 ± 30.34	26.9	76.8 -1.55
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	168.92 ± 37.16	28.7	94.2 -0.36

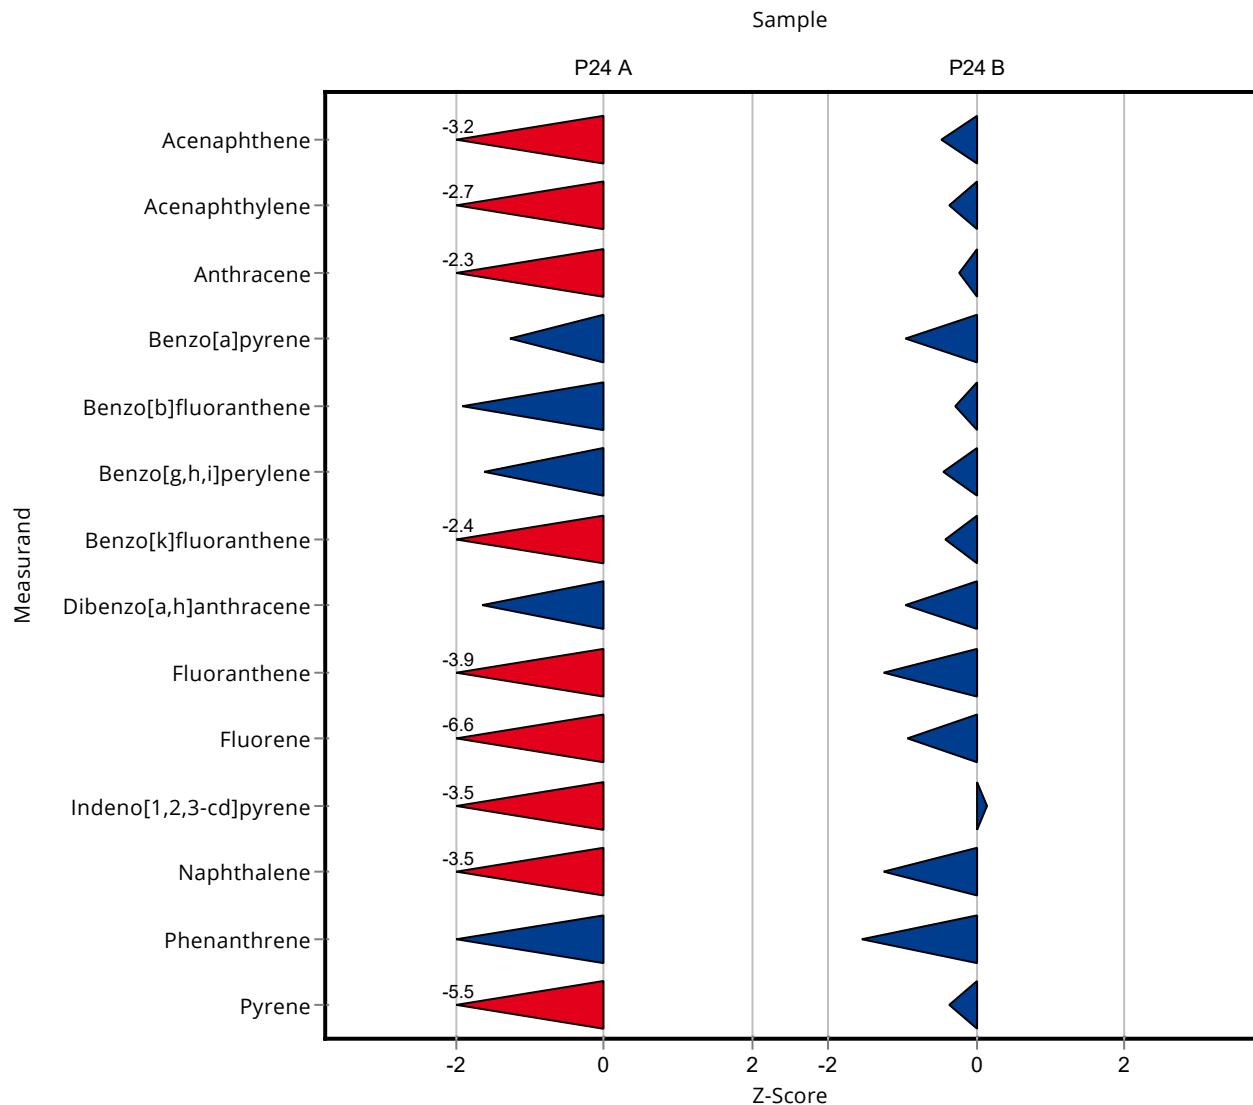


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	10.47 ± 2.3	5.08	39.2	-3.37
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	8.53 ± 1.88	5.89	34.8	-3.40
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	9.91 ± 2.18	6.39	40.3	-3.27
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	10.97 ± 2.41	3.78	69.7	-0.95
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	16.07 ± 3.54	4.05	67.5	-1.07
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	11.21 ± 2.24	7.43	48.3	-2.50
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	8.34 ± 1.83	5.61	38.6	-3.46
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	12.95 ± 2.85	7.7	50.5	-2.15
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	8.11 ± 1.78	4.9	29.8	-4.96
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	1.97 ± 0.43	3.83	7.2	-16.86
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	6.18 ± 1.36	4.23	29.2	-4.77
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	9.59 ± 2.11	7.6	26.5	-4.82
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	11.41 ± 2.28	9.18	38.5	-3.12
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	3.02 ± 0.66	4.06	11.9	-10.91

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	163.15 ± 35.89	34.1	90.9	-0.23
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	130.54 ± 28.72	34.4	91.1	-0.22
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	170.43 ± 37.49	47.2	93.9	-0.15
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	113.93 ± 25.06	35.4	77.3	-0.66
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	130.57 ± 28.73	23.3	95.3	-0.11

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	129.95 ± 28.59	48.6	85.6	-0.38
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	136.59 ± 30.05	39.9	89.1	-0.28
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	93.22 ± 20.51	39.2	71.4	-0.82
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	139.2 ± 30.62	32.3	77.5	-0.65
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	113.79 ± 25.03	18.3	87	-0.34
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	114.04 ± 25.09	20.1	102	0.05
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	135.14 ± 29.73	38.3	74.1	-0.78
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	137.9 ± 30.34	26.9	76.8	-0.67
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	168.92 ± 37.16	28.7	94.2	-0.14

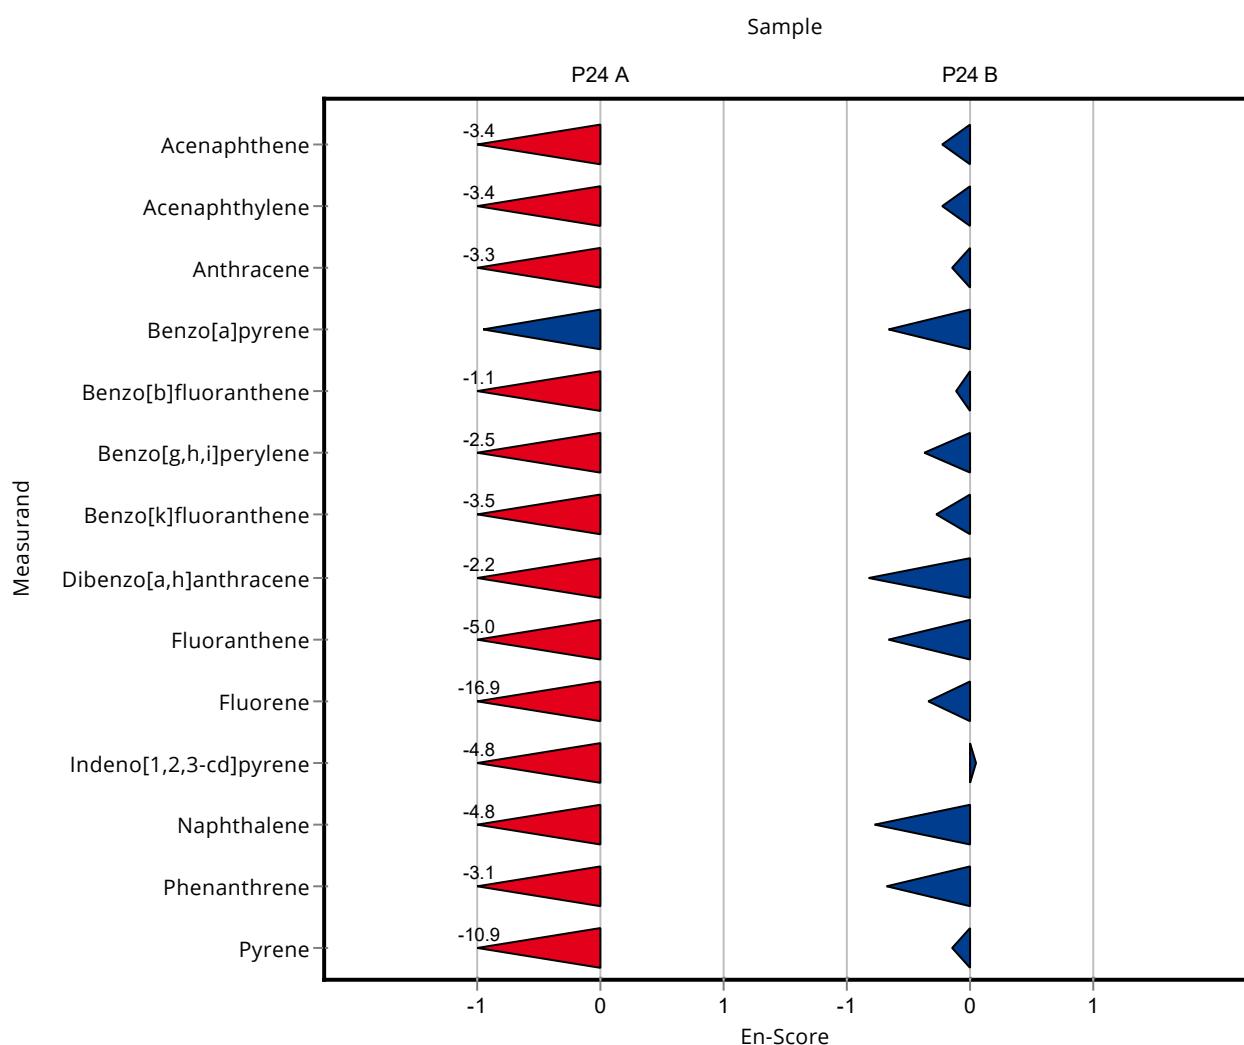


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	14.6 ± 3.6	3.78	92.7	-0.30
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19.2 ± 7.3	4.05	80.7	-1.14
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	21.8 ± 5.9	7.43	93.9	-0.19
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.5 ± 4.5	5.61	90.4	-0.37
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.6 ± 8.7	4.23	112	0.58
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	141.5 ± 35	35.4	96	-0.17
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	105.2 ± 40	23.3	76.8	-1.37
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	126.3 ± 34	48.6	83.2	-0.53
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	174.9 ± 40	39.9	114	0.54
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	104.1 ± 39	20.1	93.5	-0.36

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery	z-Score [%]
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	- -

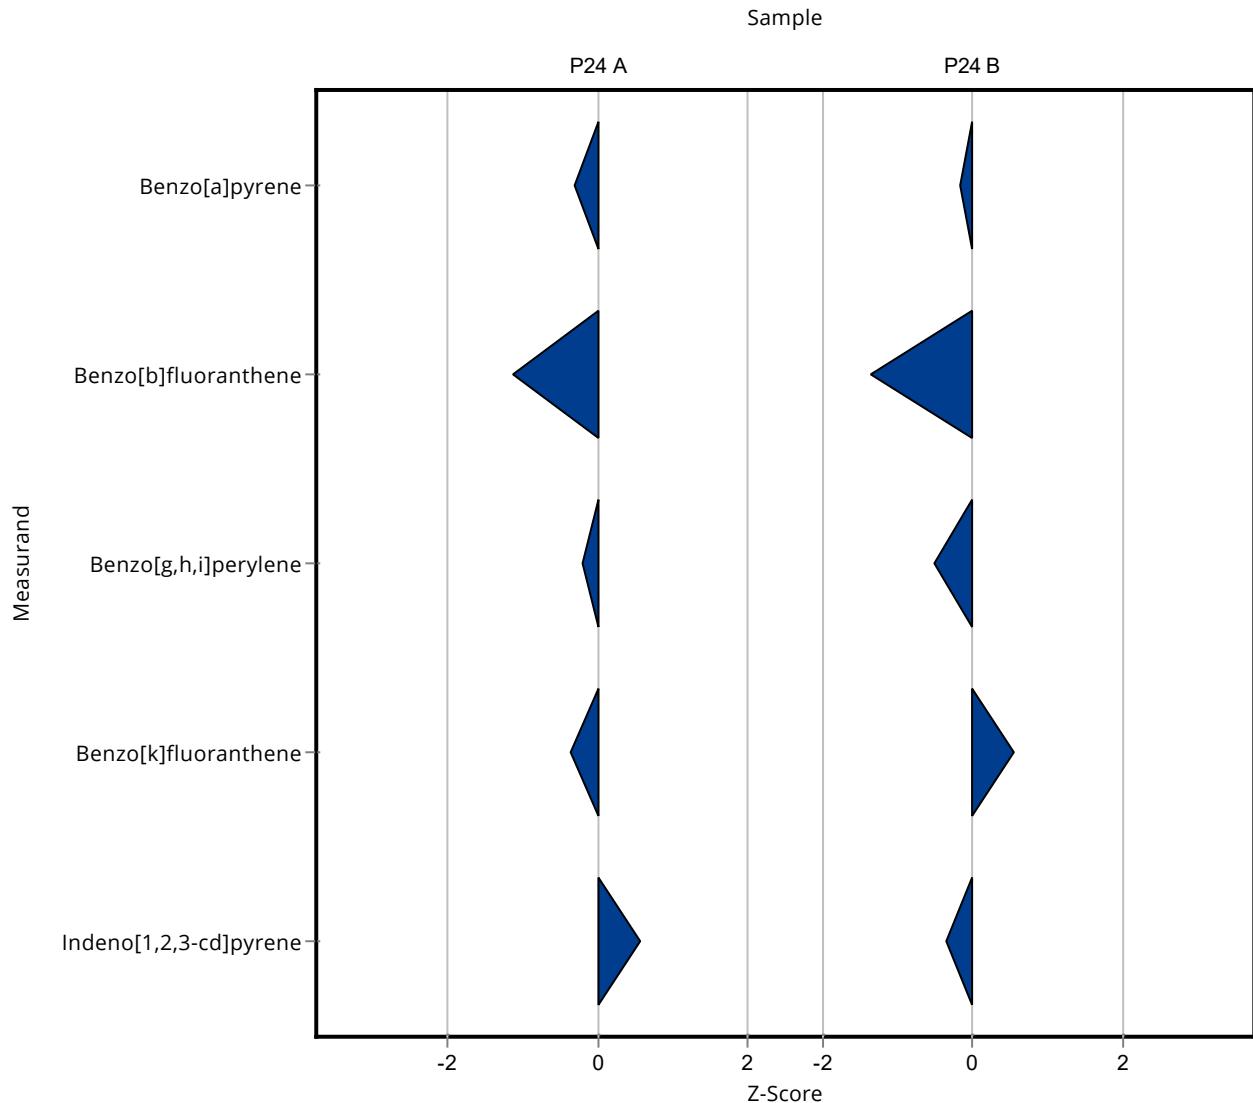


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	14.6 ± 3.6	3.78	92.7	-0.16
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19.2 ± 7.3	4.05	80.7	-0.31
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	21.8 ± 5.9	7.43	93.9	-0.12
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.5 ± 4.5	5.61	90.4	-0.23
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.6 ± 8.7	4.23	112	0.14
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	141.5 ± 35	35.4	96	-0.08
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	105.2 ± 40	23.3	76.8	-0.40

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	126.3 ± 34	48.6	83.2	-0.37
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	174.9 ± 40	39.9	114	0.27
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	104.1 ± 39	20.1	93.5	-0.09
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	-	-
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	-	-

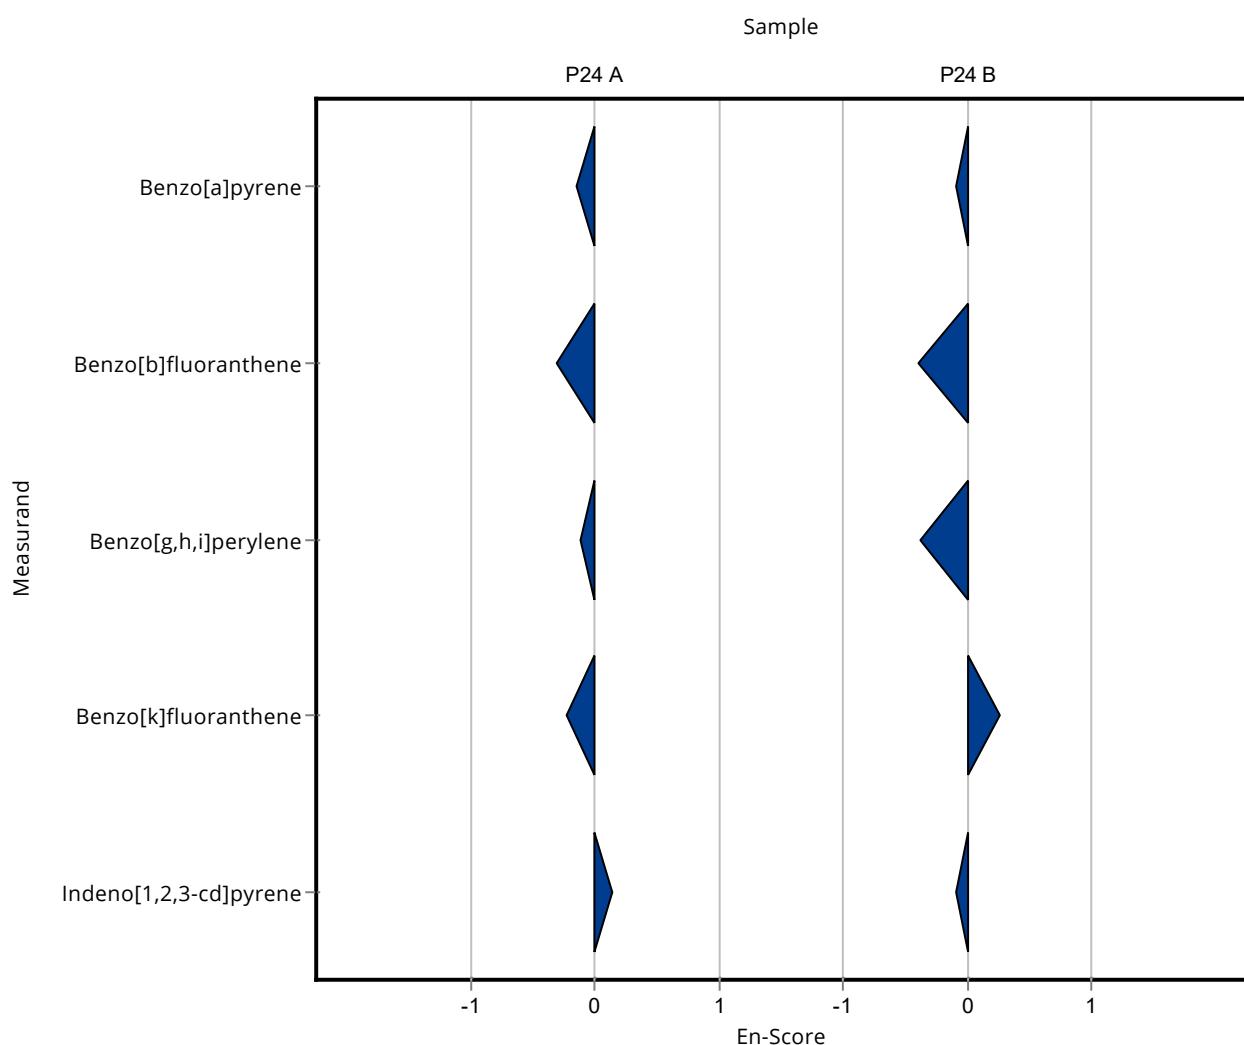


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	20.1 ± 6.04	3.78	128	1.15
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	26.3 ± 7.89	4.05	111	0.62
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.3 ± 6.99	7.43	100	0.01
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.8 ± 7.14	5.61	110	0.40
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.6 ± 6.78	4.23	107	0.34
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	160 ± 48	35.4	109	0.35
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	154 ± 46.2	23.3	112	0.73
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	103 ± 30.9	48.6	67.8	-1.01
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	162 ± 48.7	39.9	106	0.22
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	116 ± 34.8	20.1	104	0.23

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	- -
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	- -

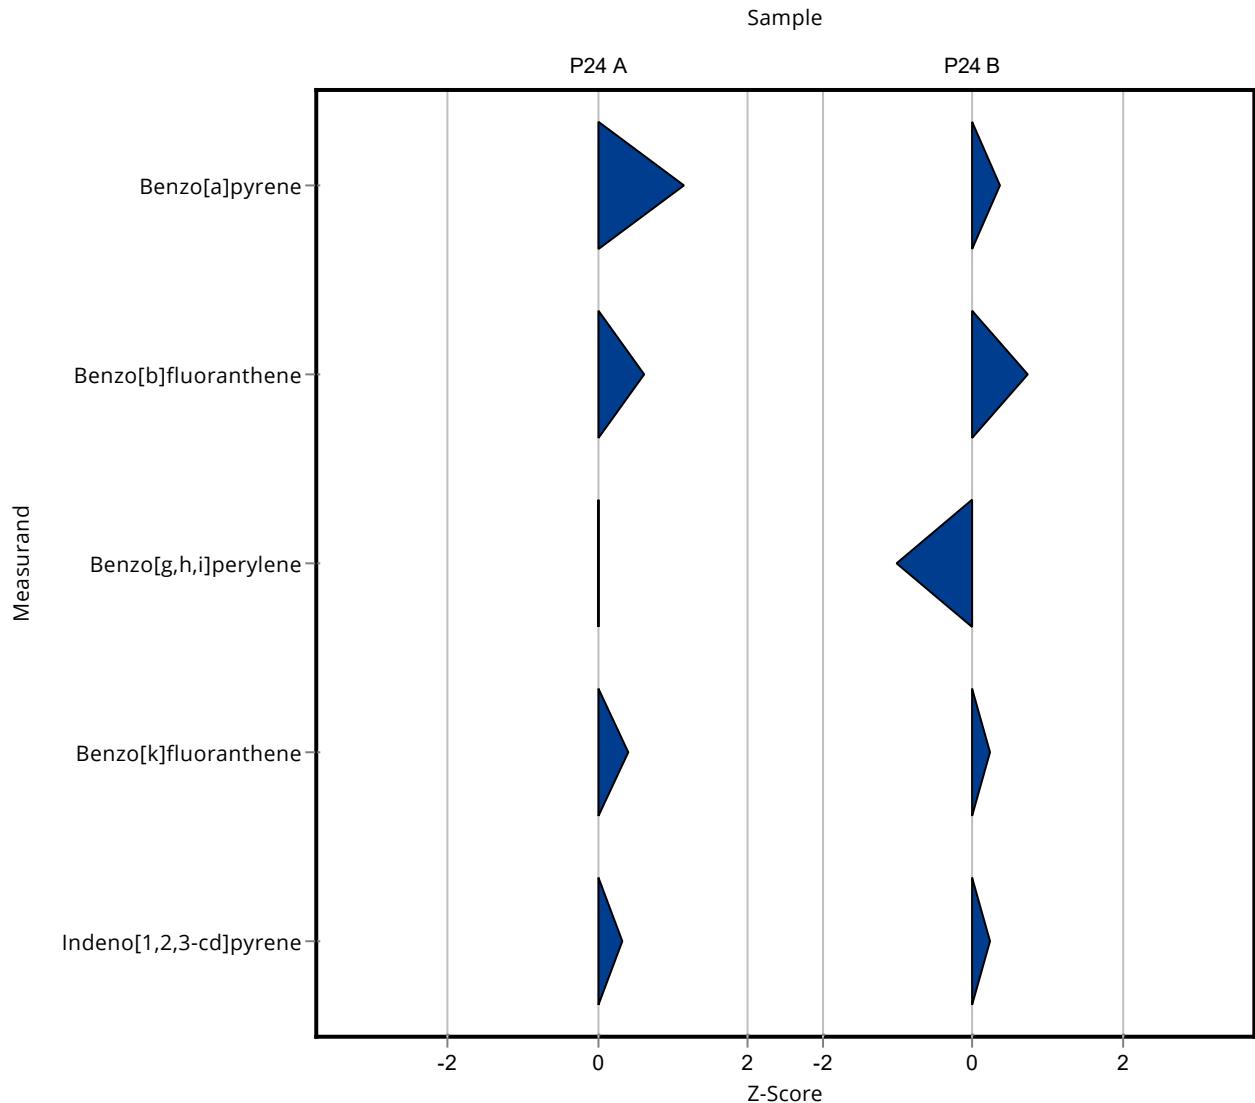


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	- ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	- ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	- ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	20.1 ± 6.04	3.78	128	0.36
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	26.3 ± 7.89	4.05	111	0.16
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.3 ± 6.99	7.43	100	0.01
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.8 ± 7.14	5.61	110	0.16
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	- ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	- ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	- ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	- ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.6 ± 6.78	4.23	107	0.11
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	- ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	- ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	- ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	- ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	- ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	- ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	160 ± 48	35.4	109	0.13
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	154 ± 46.2	23.3	112	0.18

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	103 ± 30.9	48.6	67.8	-0.78
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	162 ± 48.7	39.9	106	0.09
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	- ± -	39.7	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	- ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	- ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	- ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	116 ± 34.8	20.1	104	0.07
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	- ± -	38.3	-	-
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	- ± -	26.9	-	-
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	- ± -	28.7	-	-

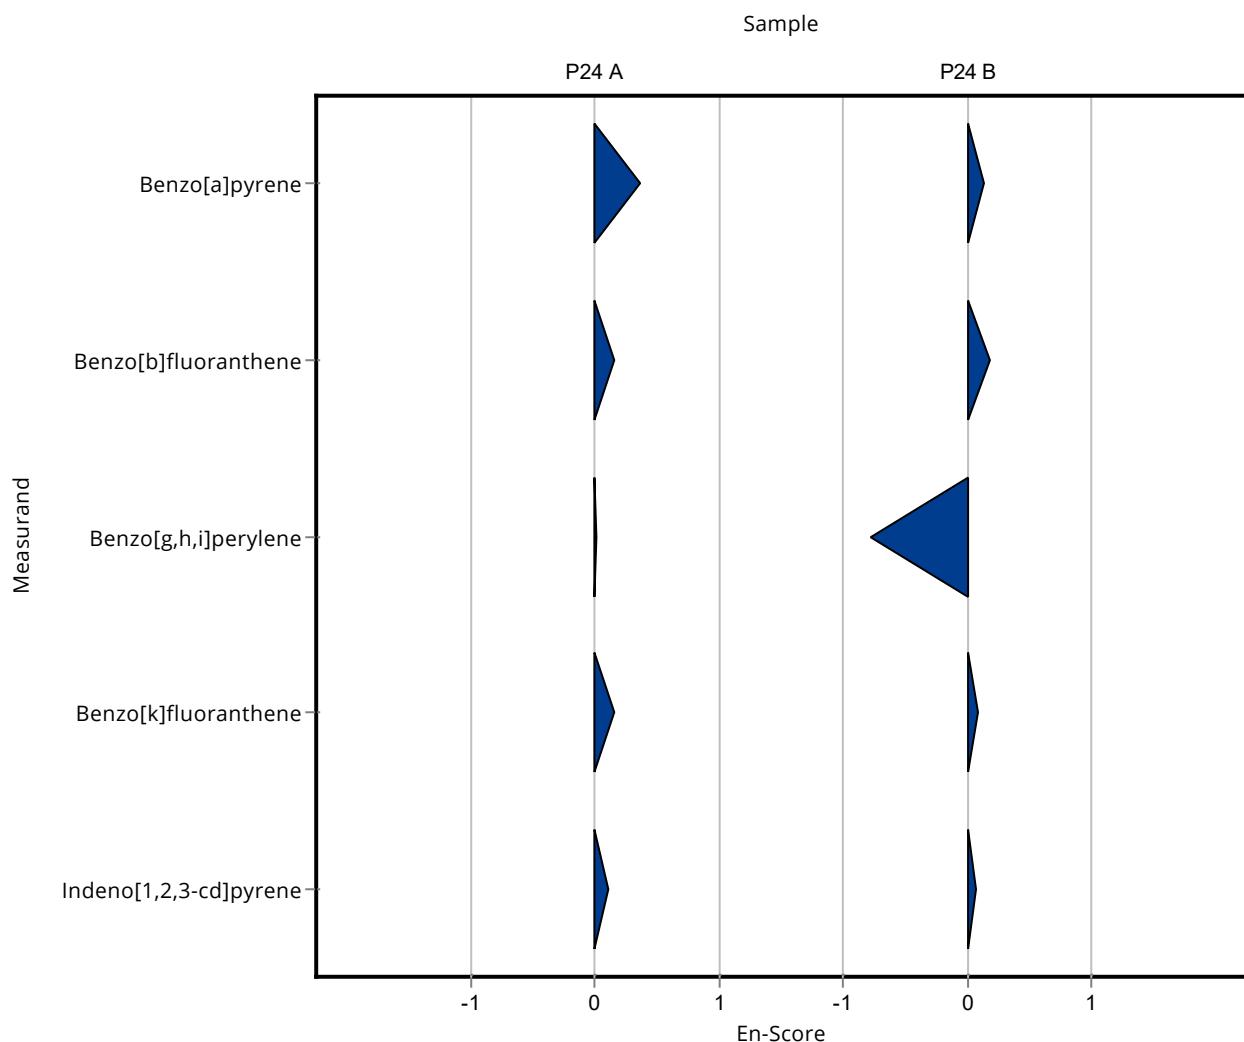


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.5 ± 5.5	5.08	103	0.15
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	34.4 ± 6.9	5.89	140	1.67
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	29.1 ± 5.8	6.39	118	0.70
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	27.6 ± 5.5	4.77	121	1.02
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	21.1 ± 4.2	3.78	134	1.42
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	28.7 ± 5.7	4.05	121	1.21
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	29.8 ± 6	7.43	128	0.89
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	26.7 ± 5.3	5.61	124	0.91
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	32.3 ± 6.5	5.91	120	0.92
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30.6 ± 6.1	7.7	119	0.64
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	32.9 ± 5	4.9	121	1.16
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	31.2 ± 6.2	3.83	114	1.00
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	27.9 ± 5.6	4.23	132	1.59
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<50 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	30.6 ± 6.1	9.18	103	0.11
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.7 ± 5.7	4.06	113	0.81

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	185 ± 37	34.1	103	0.16
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	154 ± 30.8	34.4	107	0.31
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	210 ± 42	47.2	116	0.60
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	168 ± 33.4	30.8	115	0.69
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	179 ± 35.8	35.4	121	0.89
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	166 ± 33.2	23.3	121	1.24
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	201 ± 40.2	48.6	132	1.01
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	189 ± 37.8	39.9	123	0.90
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	208 ± 41.6	39.7	115	0.70
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	196 ± 39.2	39.2	150	1.67
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	205 ± 30.8	32.3	114	0.78
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140 ± 28	18.3	107	0.50
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	143 ± 18.6	20.1	128	1.58

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	169 ± 50.7	38.3	92.6 -0.35
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	189 ± 37.8	26.9	105 0.35
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	206 ± 41.2	28.7	115 0.93

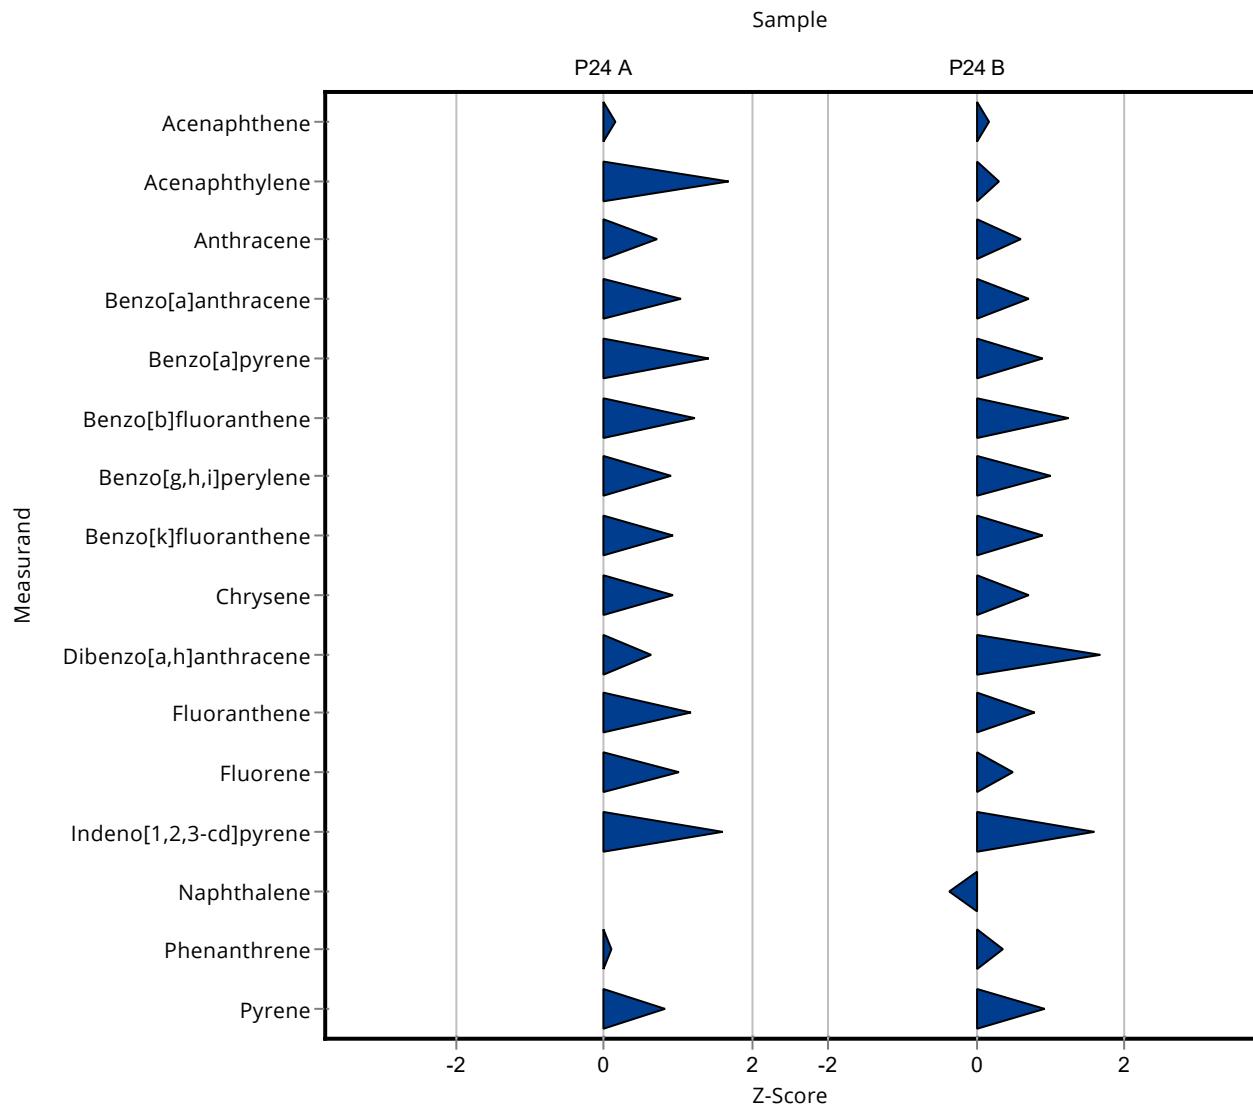


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.5 ± 5.5	5.08	103	0.07
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	34.4 ± 6.9	5.89	140	0.70
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	29.1 ± 5.8	6.39	118	0.39
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	27.6 ± 5.5	4.77	121	0.44
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	21.1 ± 4.2	3.78	134	0.63
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	28.7 ± 5.7	4.05	121	0.43
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	29.8 ± 6	7.43	128	0.54
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	26.7 ± 5.3	5.61	124	0.48
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	32.3 ± 6.5	5.91	120	0.42
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30.6 ± 6.1	7.7	119	0.40
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	32.9 ± 5	4.9	121	0.56
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	31.2 ± 6.2	3.83	114	0.31
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	27.9 ± 5.6	4.23	132	0.60
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<50 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	30.6 ± 6.1	9.18	103	0.08
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	28.7 ± 5.7	4.06	113	0.29

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	185 ± 37	34.1	103	0.07
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	154 ± 30.8	34.4	107	0.17
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	210 ± 42	47.2	116	0.34
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	168 ± 33.4	30.8	115	0.32
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	179 ± 35.8	35.4	121	0.44
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	166 ± 33.2	23.3	121	0.43

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	201 ± 40.2	48.6	132	0.61
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	189 ± 37.8	39.9	123	0.47
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	208 ± 41.6	39.7	115	0.33
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	196 ± 39.2	39.2	150	0.81
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	205 ± 30.8	32.3	114	0.41
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140 ± 28	18.3	107	0.16
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	143 ± 18.6	20.1	128	0.83
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	169 ± 50.7	38.3	92.6	-0.13
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	189 ± 37.8	26.9	105	0.12
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	206 ± 41.2	28.7	115	0.32

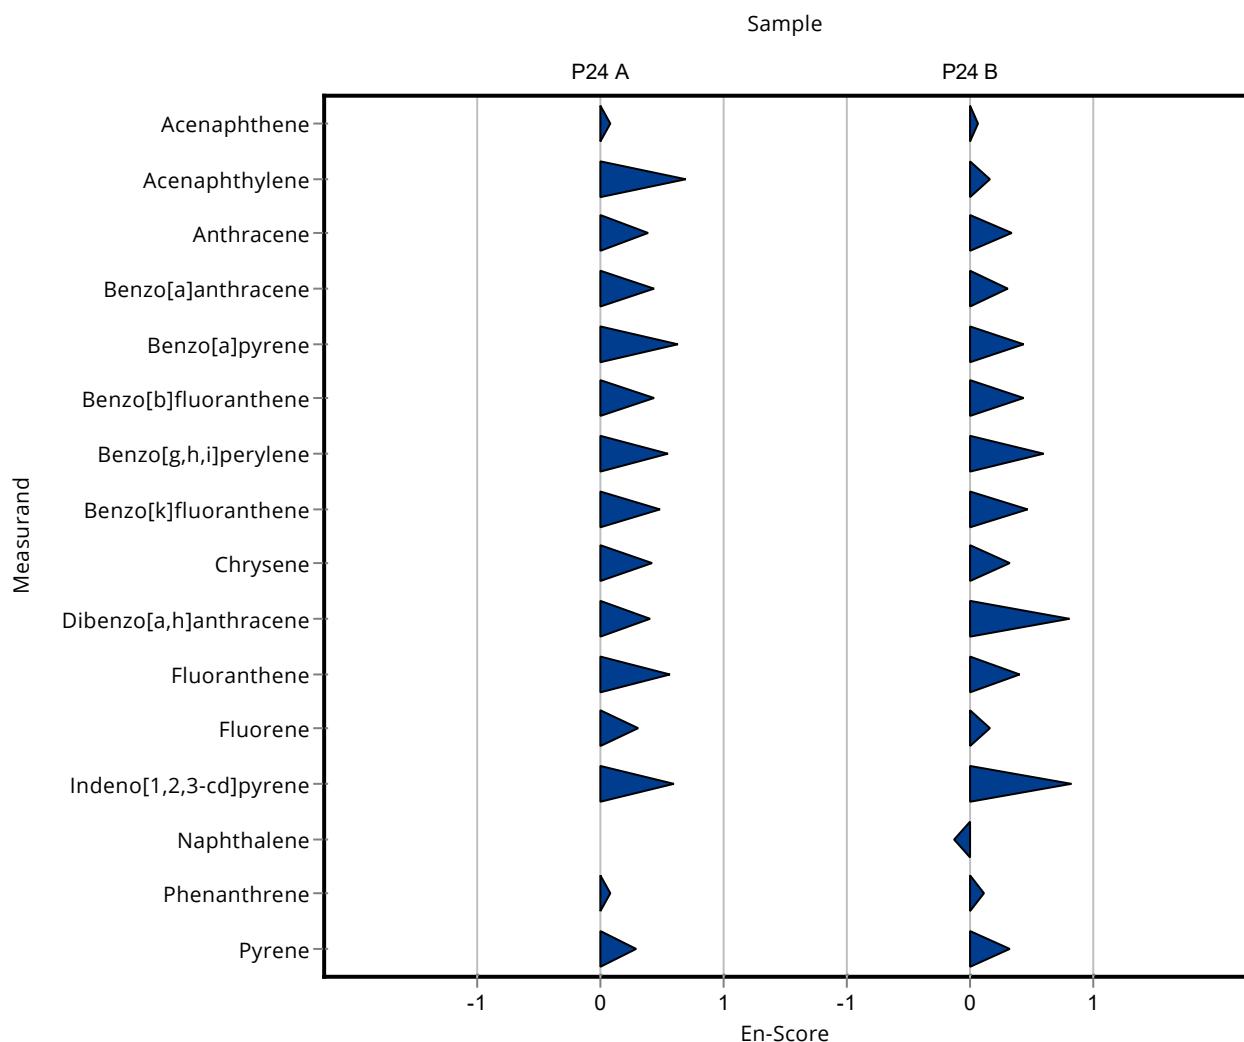


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	20.36 ± 6.5	5.08	76.2	-1.25
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.46 ± 7.6	5.89	104	0.16
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.44 ± 6.3	6.39	103	0.13
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.7 ± 6.4	4.77	109	0.41
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.71 ± 5.6	3.78	119	0.78
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.03 ± 5.1	4.05	105	0.30
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	22.74 ± 5.1	7.43	98	-0.06
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.32 ± 5.3	5.61	108	0.31
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	30.14 ± 5.4	5.91	112	0.55
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.98 ± 4.8	7.7	93.4	-0.22
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.5 ± 6.7	4.9	116	0.87
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	23.12 ± 5.7	3.83	84.5	-1.11
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.33 ± 5.6	4.23	101	0.04
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	32.02 ± 7.2	7.6	88.5	-0.55
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	34.4 ± 7.1	9.18	116	0.52
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.43 ± 5.7	4.06	108	0.50

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	98.27 ± 17.8	34.1	54.7	-2.38
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	110.7 ± 19.2	34.4	77.2	-0.95
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	148.1 ± 22.6	47.2	81.6	-0.71
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	131.5 ± 14.6	30.8	89.7	-0.49
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	106.1 ± 18.8	35.4	72	-1.17
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	86.83 ± 8.2	23.3	63.4	-2.15
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	156.1 ± 16.4	48.6	103	0.09
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	97.52 ± 14.3	39.9	63.6	-1.40
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	167.4 ± 15.6	39.7	92.8	-0.33
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	113.2 ± 11.3	39.2	86.7	-0.44
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	135.7 ± 13.9	32.3	75.5	-1.36
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	83.25 ± 12.9	18.3	63.6	-2.60
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	65.53 ± 12.4	20.1	58.8	-2.29

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	105.1 ± 19.8	38.3	57.6 -2.02
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	154.4 ± 14.7	26.9	86 -0.93
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	144.7 ± 23.8	28.7	80.7 -1.21

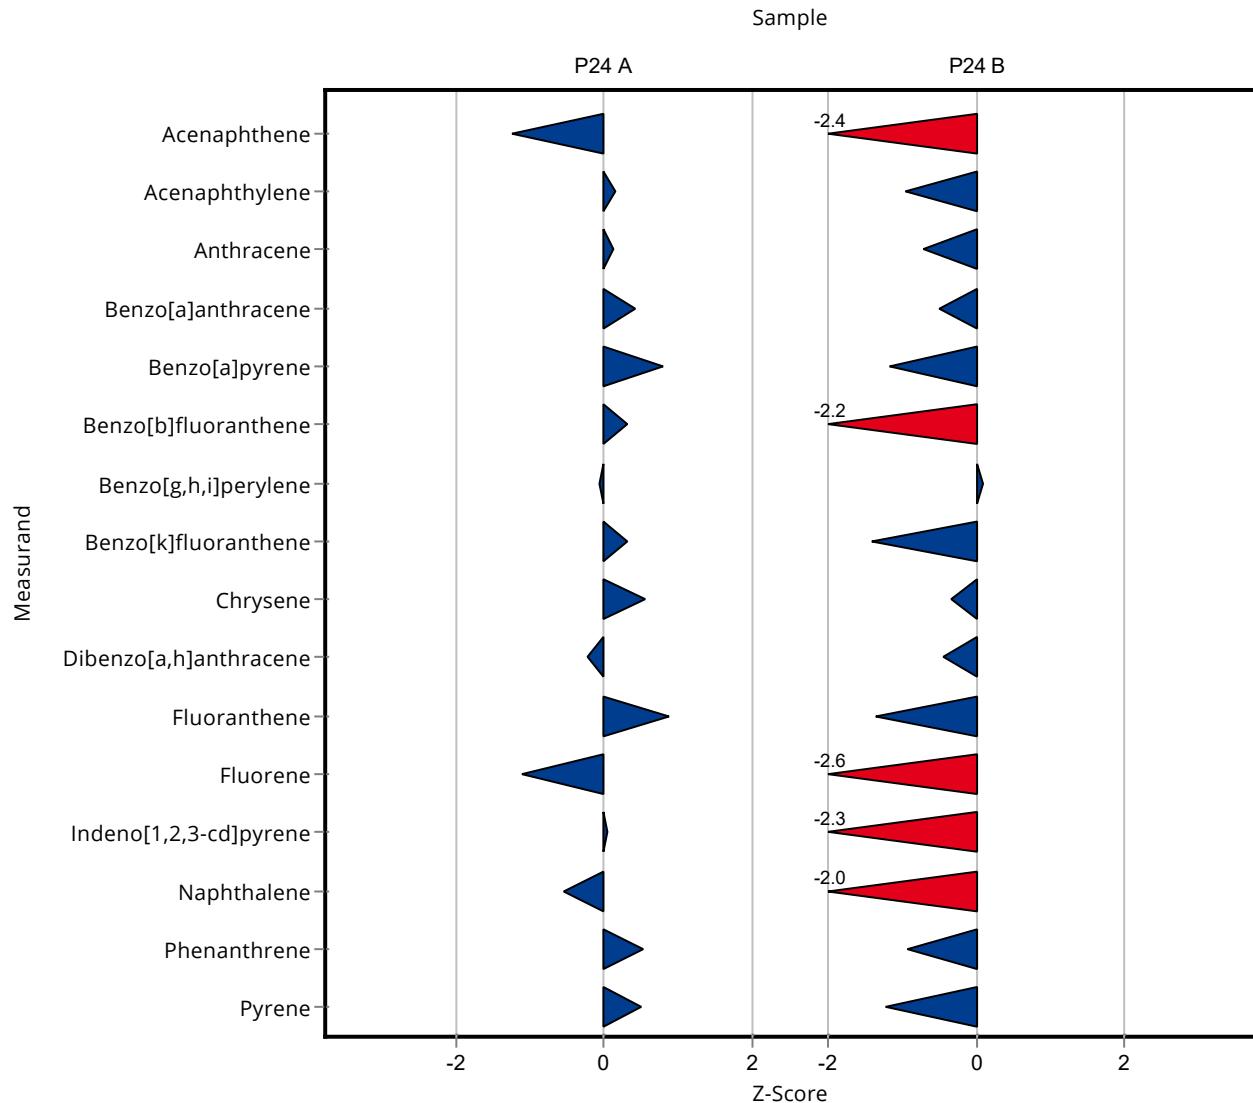


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	20.36 ± 6.5	5.08	76.2	-0.49
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	25.46 ± 7.6	5.89	104	0.06
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.44 ± 6.3	6.39	103	0.07
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	24.7 ± 6.4	4.77	109	0.15
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.71 ± 5.6	3.78	119	0.26
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	25.03 ± 5.1	4.05	105	0.12
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	22.74 ± 5.1	7.43	98	-0.05
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	23.32 ± 5.3	5.61	108	0.16
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	30.14 ± 5.4	5.91	112	0.30
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.98 ± 4.8	7.7	93.4	-0.17
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	31.5 ± 6.7	4.9	116	0.32
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	23.12 ± 5.7	3.83	84.5	-0.37
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	21.33 ± 5.6	4.23	101	0.02
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	32.02 ± 7.2	7.6	88.5	-0.28
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	34.4 ± 7.1	9.18	116	0.33
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	27.43 ± 5.7	4.06	108	0.18

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	98.27 ± 17.8	34.1	54.7	-2.20
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	110.7 ± 19.2	34.4	77.2	-0.82
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	148.1 ± 22.6	47.2	81.6	-0.73
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	131.5 ± 14.6	30.8	89.7	-0.50
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	106.1 ± 18.8	35.4	72	-1.07
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	86.83 ± 8.2	23.3	63.4	-2.74

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	156.1 ± 16.4	48.6	103	0.12
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	97.52 ± 14.3	39.9	63.6	-1.87
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	167.4 ± 15.6	39.7	92.8	-0.40
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	113.2 ± 11.3	39.2	86.7	-0.59
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	135.7 ± 13.9	32.3	75.5	-1.51
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	83.25 ± 12.9	18.3	63.6	-1.77
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	65.53 ± 12.4	20.1	58.8	-1.77
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	105.1 ± 19.8	38.3	57.6	-1.86
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	154.4 ± 14.7	26.9	86	-0.78
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	144.7 ± 23.8	28.7	80.7	-0.72

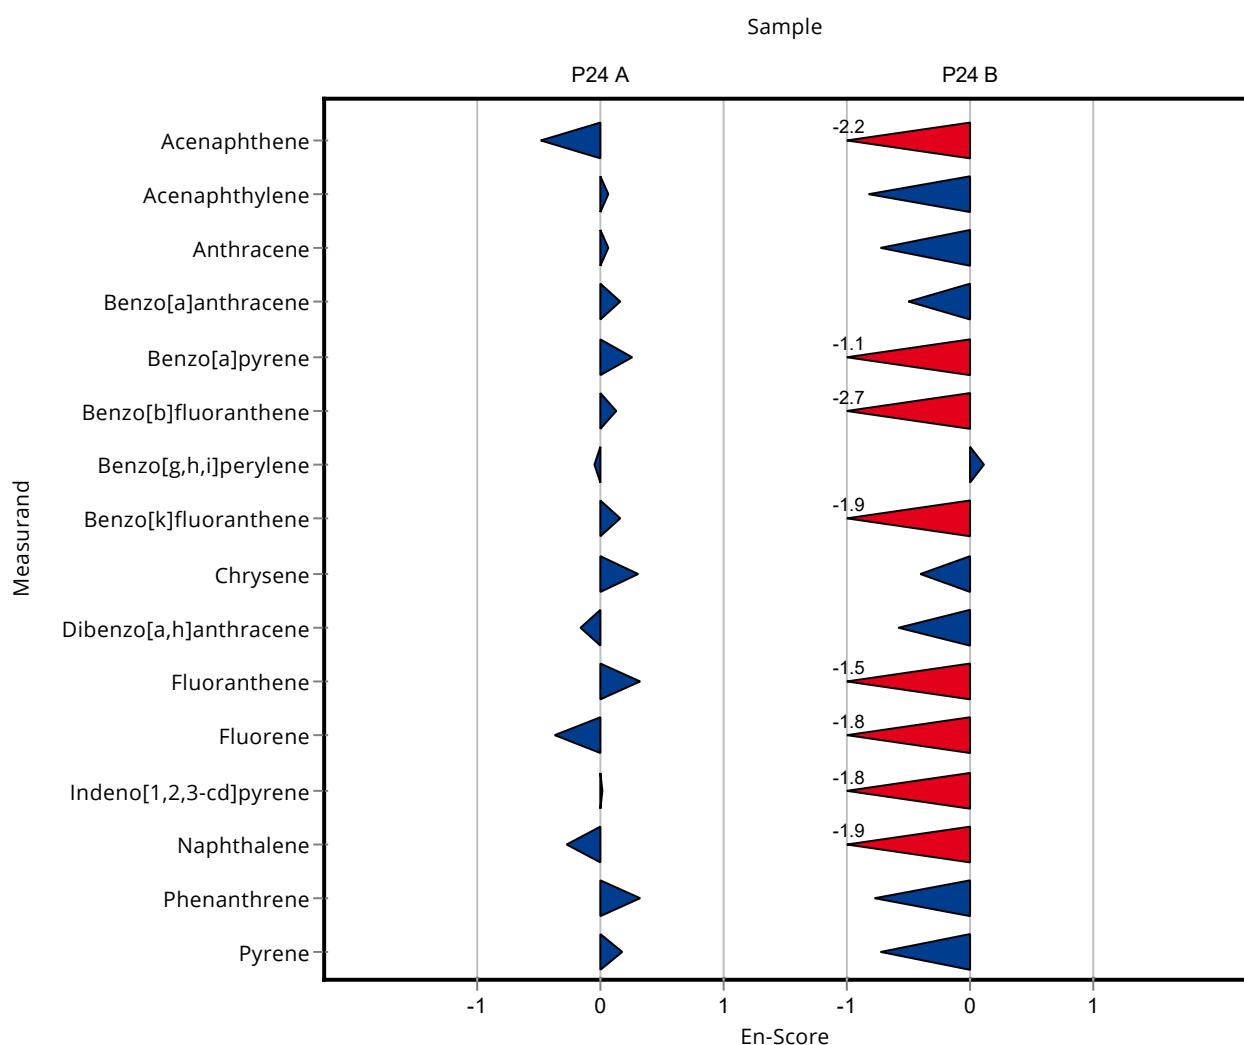


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.6 ± 2.8	5.08	103	0.17
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<25 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	27.6 ± 2.8	6.39	112	0.47
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	23.7 ± 2.4	4.77	104	0.20
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.6 ± 1.9	3.78	118	0.75
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	24.8 ± 2.5	4.05	104	0.25
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.5 ± 2.5	7.43	106	0.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.5 ± 2.3	5.61	104	0.16
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.3 ± 2.7	5.91	102	0.07
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	26.1 ± 2.6	7.7	102	0.06
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27.8 ± 2.8	4.9	102	0.12
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	28.5 ± 2.9	3.83	104	0.30
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.5 ± 2.3	4.23	106	0.32
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33 ± 3.3	7.6	91.2	-0.42
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.5 ± 2.9	9.18	96.3	-0.12
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 2.7	4.06	105	0.29

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	192.8 ± 19.3	34.1	107	0.39
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	172.5 ± 17.3	34.4	120	0.85
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	211.4 ± 21.1	47.2	117	0.63
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	165.3 ± 16.5	30.8	113	0.61
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177.8 ± 17.8	35.4	121	0.86
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	162.8 ± 16.3	23.3	119	1.11
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	191.4 ± 19.1	48.6	126	0.81
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	182.6 ± 18.3	39.9	119	0.74
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	201 ± 20.1	39.7	111	0.52
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	167 ± 16.7	39.2	128	0.93
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	200.6 ± 20.1	32.3	112	0.65
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140.1 ± 14	18.3	107	0.51
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	143.6 ± 14.4	20.1	129	1.61

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score	
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	195.5 ± 19.6	38.3	107	0.34
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	188 ± 18.8	26.9	105	0.31
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	199.5 ± 20	28.7	111	0.70

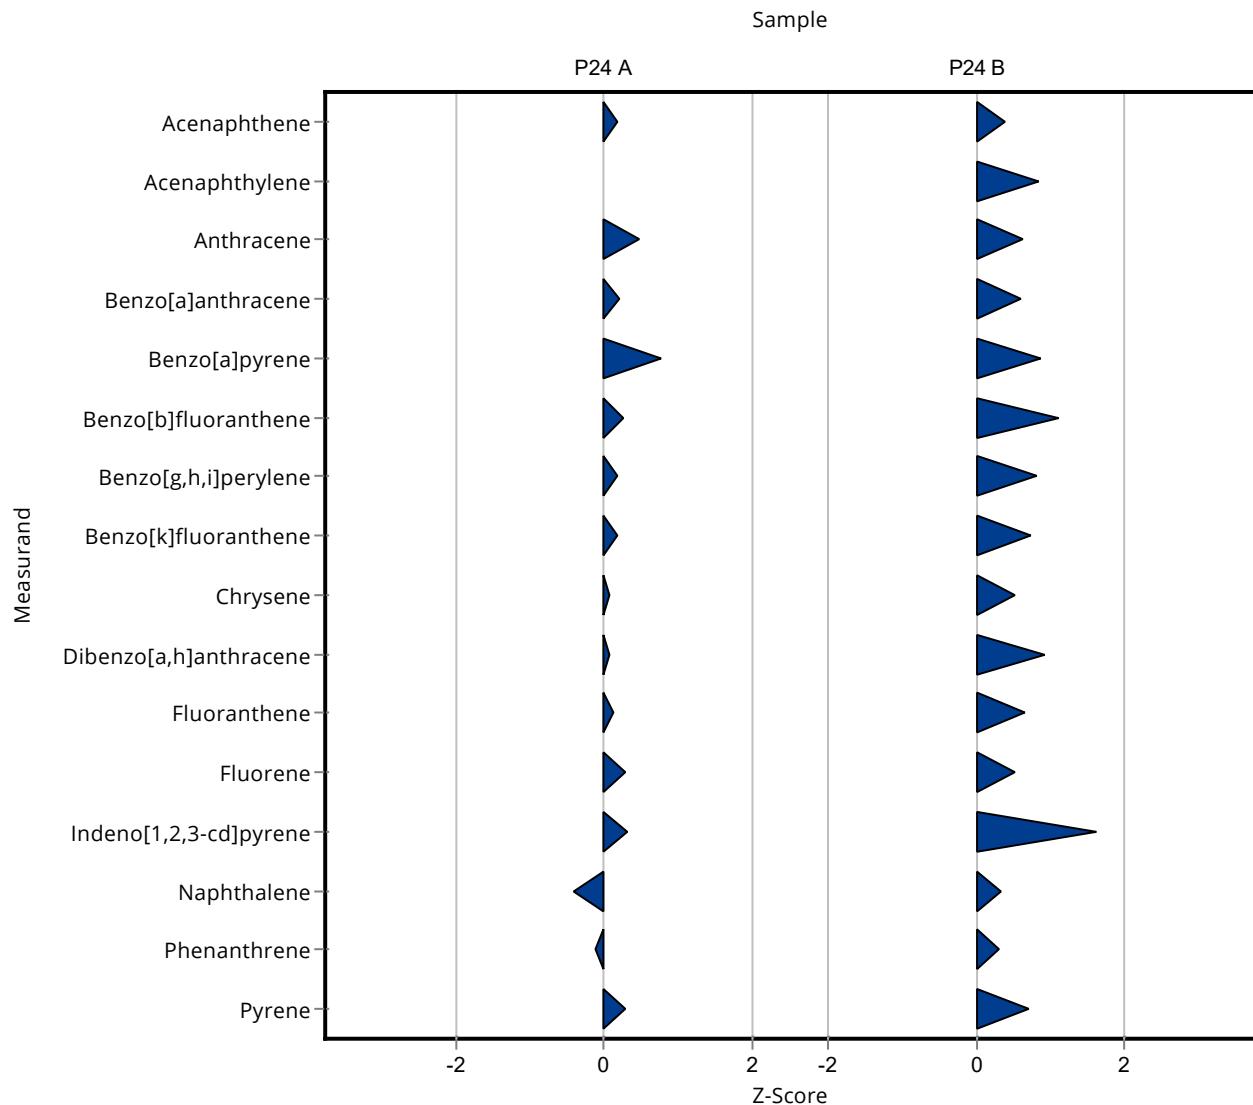


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	27.6 ± 2.8	5.08	103	0.15
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<25 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	27.6 ± 2.8	6.39	112	0.53
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	23.7 ± 2.4	4.77	104	0.19
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	18.6 ± 1.9	3.78	118	0.71
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	24.8 ± 2.5	4.05	104	0.19
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.5 ± 2.5	7.43	106	0.24
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.5 ± 2.3	5.61	104	0.19
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.3 ± 2.7	5.91	102	0.08
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	26.1 ± 2.6	7.7	102	0.08
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	27.8 ± 2.8	4.9	102	0.10
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	28.5 ± 2.9	3.83	104	0.19
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.5 ± 2.3	4.23	106	0.28
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	33 ± 3.3	7.6	91.2	-0.43
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.5 ± 2.9	9.18	96.3	-0.16
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 2.7	4.06	105	0.21

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	192.8 ± 19.3	34.1	107	0.33
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	172.5 ± 17.3	34.4	120	0.81
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	211.4 ± 21.1	47.2	117	0.70
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	165.3 ± 16.5	30.8	113	0.55
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	177.8 ± 17.8	35.4	121	0.83
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	162.8 ± 16.3	23.3	119	0.77

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	191.4 ± 19.1	48.6	126	0.99
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	182.6 ± 18.3	39.9	119	0.78
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	201 ± 20.1	39.7	111	0.51
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	167 ± 16.7	39.2	128	0.94
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	200.6 ± 20.1	32.3	112	0.51
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	140.1 ± 14	18.3	107	0.32
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	143.6 ± 14.4	20.1	129	1.08
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	195.5 ± 19.6	38.3	107	0.32
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	188 ± 18.8	26.9	105	0.21
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	199.5 ± 20	28.7	111	0.49

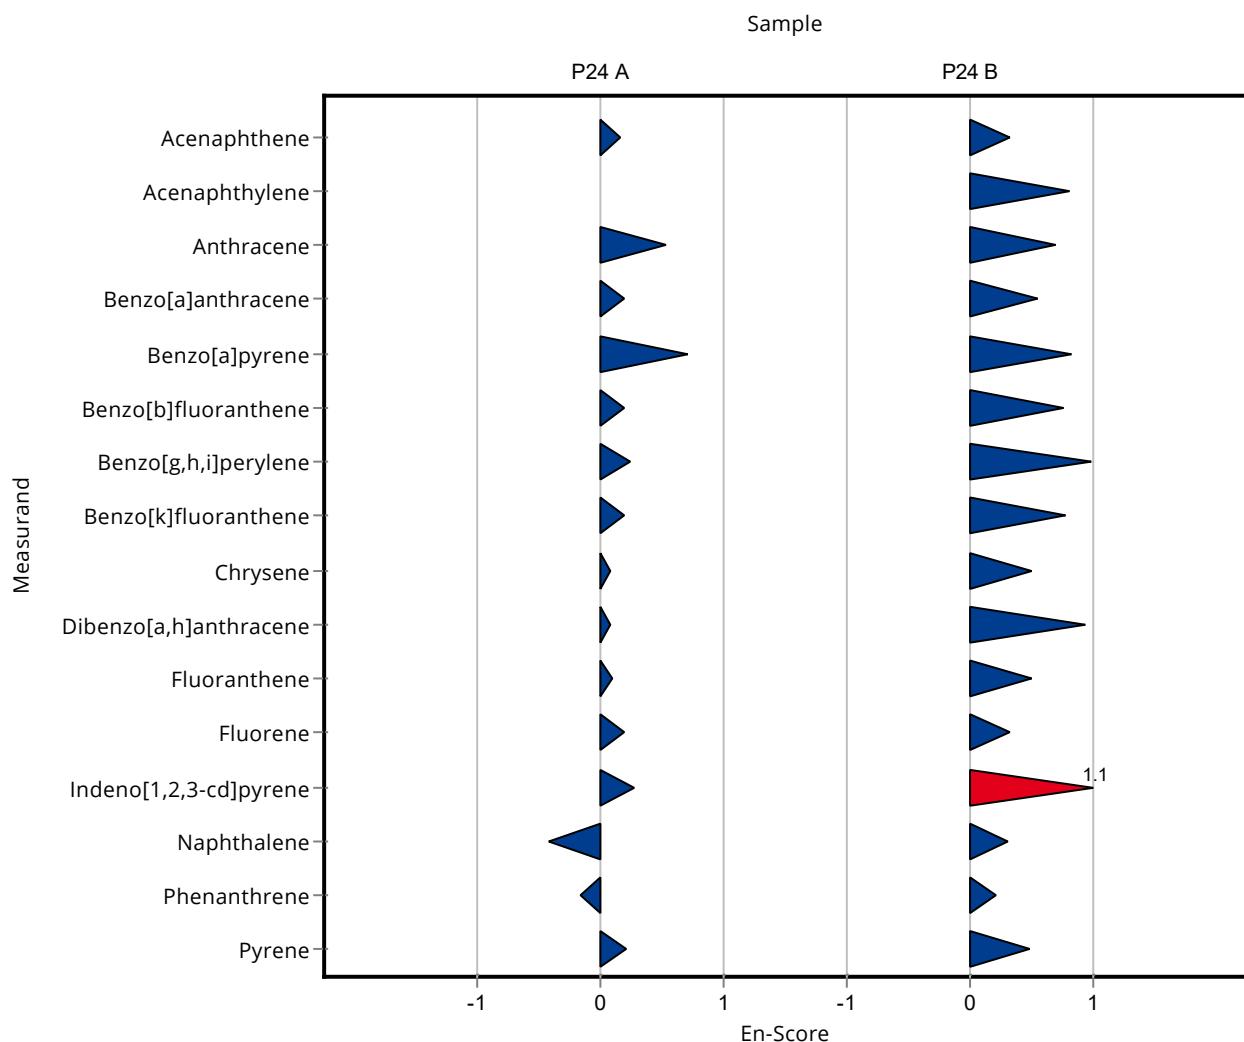


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28.8 ± 6.05	5.08	108	0.41
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	22.8 ± 4.79	6.39	92.7	-0.28
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.8 ± 4.79	4.77	100	0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17 ± 3.57	3.78	108	0.33
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	22.1 ± 4.64	4.05	92.9	-0.42
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.9 ± 5.02	7.43	103	0.09
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.2 ± 4.45	5.61	98.2	-0.07
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	25.8 ± 5.42	5.91	96	-0.18
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.9 ± 5.23	7.7	97	-0.10
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	26.9 ± 5.65	4.9	98.8	-0.07
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.7 ± 5.61	3.83	97.6	-0.17
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	18 ± 3.78	4.23	85.1	-0.75
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35.2 ± 7.39	7.6	97.3	-0.13
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	35.8 ± 7.52	9.18	121	0.67
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.7 ± 4.56	4.06	85.4	-0.91

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	222.5 ± 46.73	34.1	124	1.26
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	178.9 ± 37.57	47.2	98.6	-0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	167 ± 35.07	30.8	114	0.66
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	158.1 ± 33.2	35.4	107	0.30
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	142.8 ± 29.99	23.3	104	0.25
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	117.4 ± 24.65	48.6	77.3	-0.71
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	163.3 ± 34.29	39.9	107	0.25
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	193.3 ± 40.59	39.7	107	0.33
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	87.4 ± 18.35	39.2	66.9	-1.10
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	208.6 ± 43.81	32.3	116	0.90
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	164.3 ± 34.5	18.3	126	1.83
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	101.3 ± 21.27	20.1	90.9	-0.50

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	217.4 ± 45.65	38.3	119 0.91
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	243.5 ± 51.14	26.9	136 2.37
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	165.5 ± 34.76	28.7	92.3 -0.48

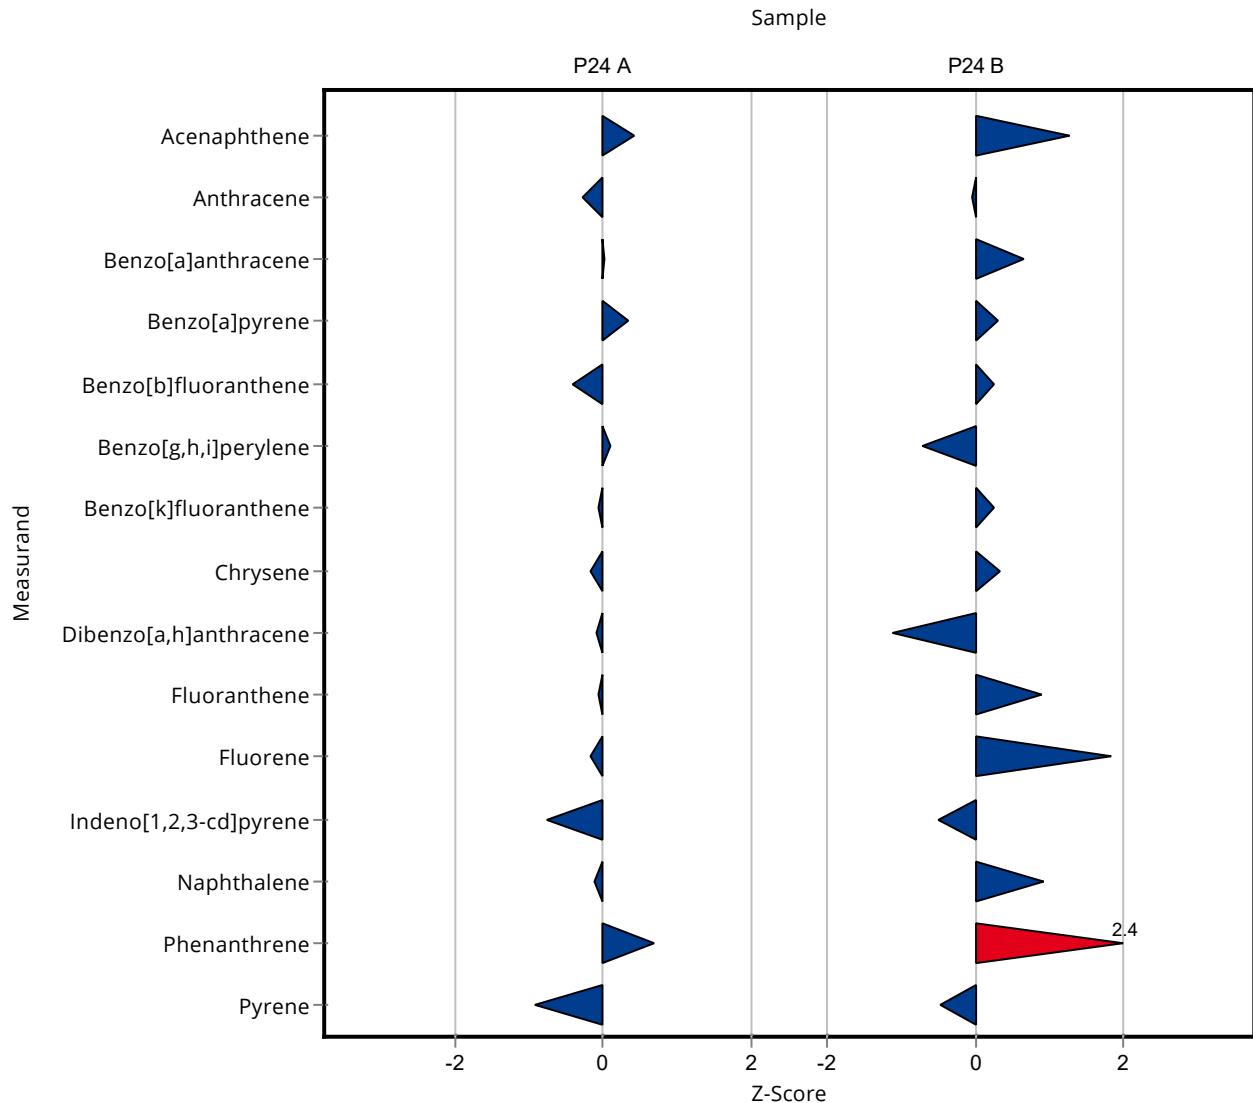


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	28.8 ± 6.05	5.08	108	0.17
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	- ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	22.8 ± 4.79	6.39	92.7	-0.19
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.8 ± 4.79	4.77	100	0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	17 ± 3.57	3.78	108	0.17
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	22.1 ± 4.64	4.05	92.9	-0.18
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23.9 ± 5.02	7.43	103	0.07
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	21.2 ± 4.45	5.61	98.2	-0.04
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	25.8 ± 5.42	5.91	96	-0.10
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.9 ± 5.23	7.7	97	-0.07
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	26.9 ± 5.65	4.9	98.8	-0.03
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	26.7 ± 5.61	3.83	97.6	-0.06
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	18 ± 3.78	4.23	85.1	-0.41
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35.2 ± 7.39	7.6	97.3	-0.06
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	35.8 ± 7.52	9.18	121	0.40
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.7 ± 4.56	4.06	85.4	-0.40

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	222.5 ± 46.73	34.1	124	0.46
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	- ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	178.9 ± 37.57	47.2	98.6	-0.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	167 ± 35.07	30.8	114	0.29
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	158.1 ± 33.2	35.4	107	0.16
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	142.8 ± 29.99	23.3	104	0.10

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	117.4 ± 24.65	48.6	77.3	-0.68
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	163.3 ± 34.29	39.9	107	0.15
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	193.3 ± 40.59	39.7	107	0.16
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	87.4 ± 18.35	39.2	66.9	-1.04
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	208.6 ± 43.81	32.3	116	0.33
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	164.3 ± 34.5	18.3	126	0.48
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	101.3 ± 21.27	20.1	90.9	-0.23
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	217.4 ± 45.65	38.3	119	0.38
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	243.5 ± 51.14	26.9	136	0.62
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	165.5 ± 34.76	28.7	92.3	-0.20

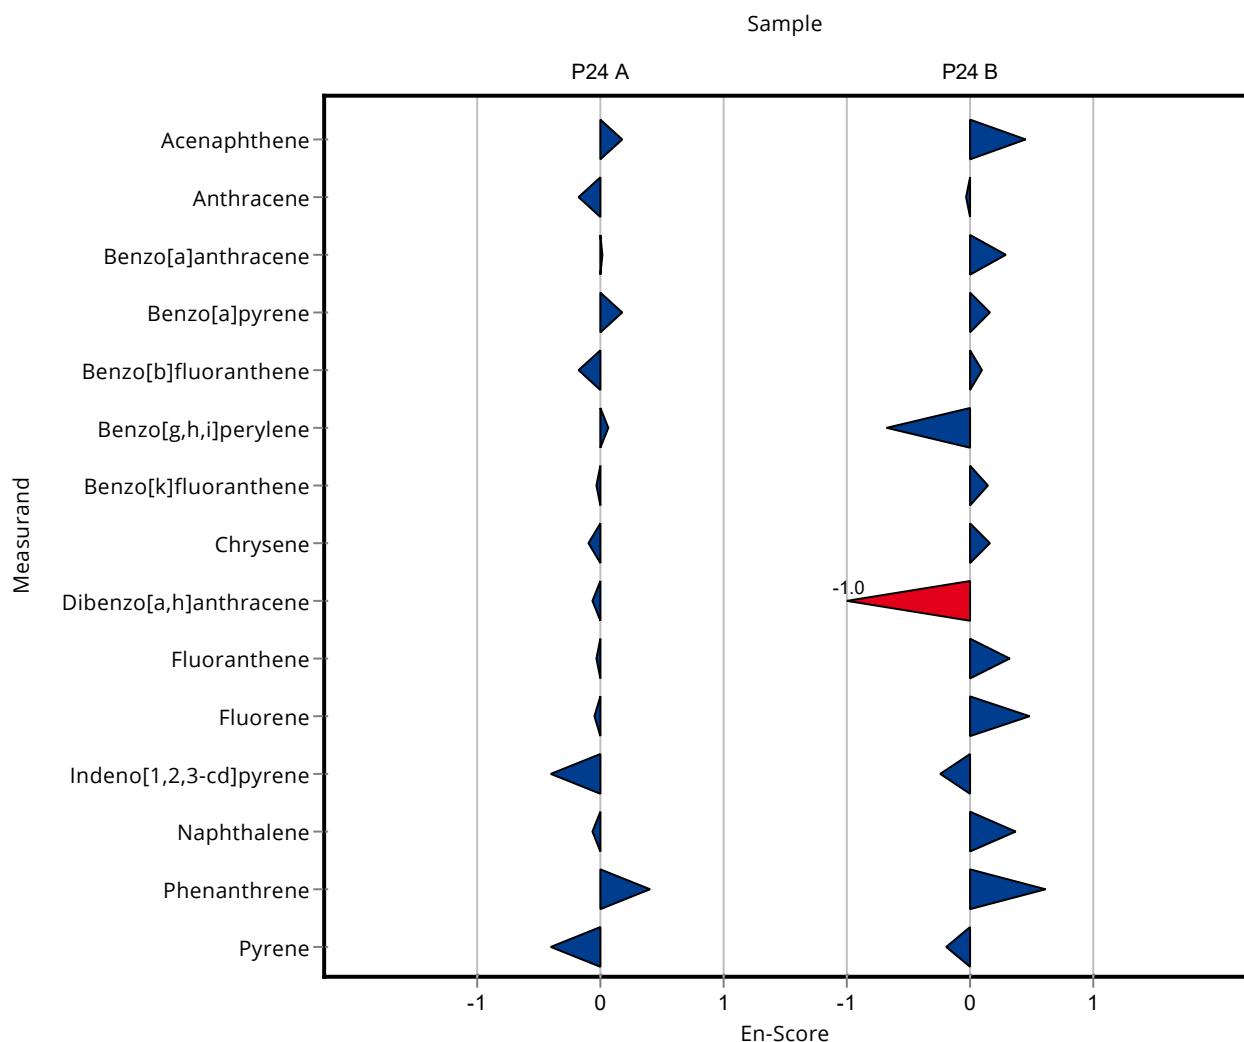


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	31.9 ± 2.7	5.08	119	1.02
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.3 ± 1.29	5.89	107	0.30
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	27.8 ± 2.5	6.39	113	0.50
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	30.9 ± 3.4	4.77	136	1.71
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	8 ± 0.65	3.78	50.8	-2.05
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	16.2 ± 1.09	4.05	68.1	-1.88
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	12.5 ± 1.45	7.43	53.8	-1.44
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	14.7 ± 2.35	5.61	68.1	-1.23
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	33.1 ± 1.8	5.91	123	1.05
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	10.1 ± 0.5	7.7	39.4	-2.02
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	22.5 ± 2.2	4.9	82.6	-0.97
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.9 ± 1.43	3.83	113	0.92
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	9.6 ± 0.45	4.23	45.4	-2.73
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	49.7 ± 4.29	7.6	137	1.78
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	39.5 ± 0.45	9.18	133	1.08
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24.8 ± 0.844	4.06	97.6	-0.15

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	227 ± 22.7	34.1	126	1.39
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	219 ± 1	34.4	153	2.20
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	277 ± 8.5	47.2	153	2.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	209 ± 5	30.8	143	2.03
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	103 ± 5.82	35.4	69.8	-1.26
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	115 ± 8.89	23.3	83.9	-0.94
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	71.5 ± 6.6	48.6	47.1	-1.65
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	110 ± 7	39.9	71.8	-1.09
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	265 ± 9	39.7	147	2.14
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	57.5 ± 21.8	39.2	44	-1.87
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	297 ± 47.5	32.3	165	3.63
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	172 ± 14.9	18.3	131	2.25
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	62.7 ± 2.3	20.1	56.3	-2.43

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	246 ± 4.67	38.3	135
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	284 ± 43.5	26.9	158
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	273 ± 27	28.7	152

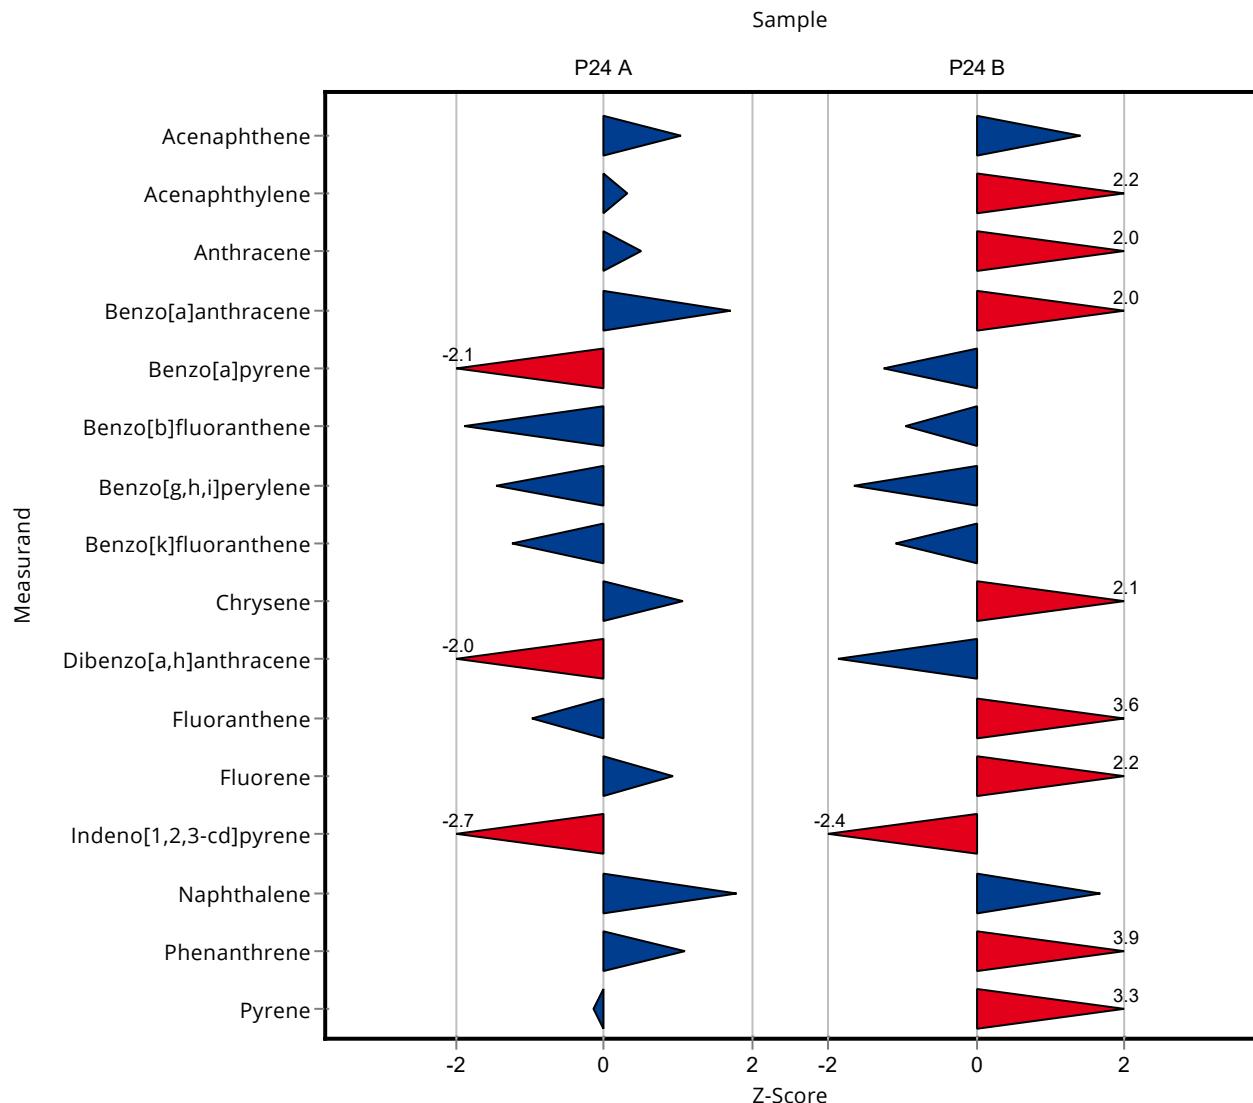


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	31.9 ± 2.7	5.08	119	0.93
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	26.3 ± 1.29	5.89	107	0.46
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	27.8 ± 2.5	6.39	113	0.63
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	30.9 ± 3.4	4.77	136	1.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	8 ± 0.65	3.78	50.8	-4.11
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	16.2 ± 1.09	4.05	68.1	-2.86
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	12.5 ± 1.45	7.43	53.8	-3.17
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	14.7 ± 2.35	5.61	68.1	-1.42
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	33.1 ± 1.8	5.91	123	1.64
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	10.1 ± 0.5	7.7	39.4	-8.38
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	22.5 ± 2.2	4.9	82.6	-1.02
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.9 ± 1.43	3.83	113	1.13
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	9.6 ± 0.45	4.23	45.4	-6.37
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	49.7 ± 4.29	7.6	137	1.46
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	39.5 ± 0.45	9.18	133	2.64
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	24.8 ± 0.844	4.06	97.6	-0.26

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	227 ± 22.7	34.1	126	1.02
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	219 ± 1	34.4	153	7.17
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	277 ± 8.5	47.2	153	5.12
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	209 ± 5	30.8	143	4.95
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	103 ± 5.82	35.4	69.8	-3.07
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	115 ± 8.89	23.3	83.9	-1.12

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	71.5 ± 6.6	48.6	47.1	-4.57
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	110 ± 7	39.9	71.8	-2.65
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	265 ± 9	39.7	147	4.32
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	57.5 ± 21.8	39.2	44	-1.53
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	297 ± 47.5	32.3	165	1.23
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	172 ± 14.9	18.3	131	1.34
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	62.7 ± 2.3	20.1	56.3	-5.57
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	246 ± 4.67	38.3	135	4.04
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	284 ± 43.5	26.9	158	1.19
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	273 ± 27	28.7	152	1.72

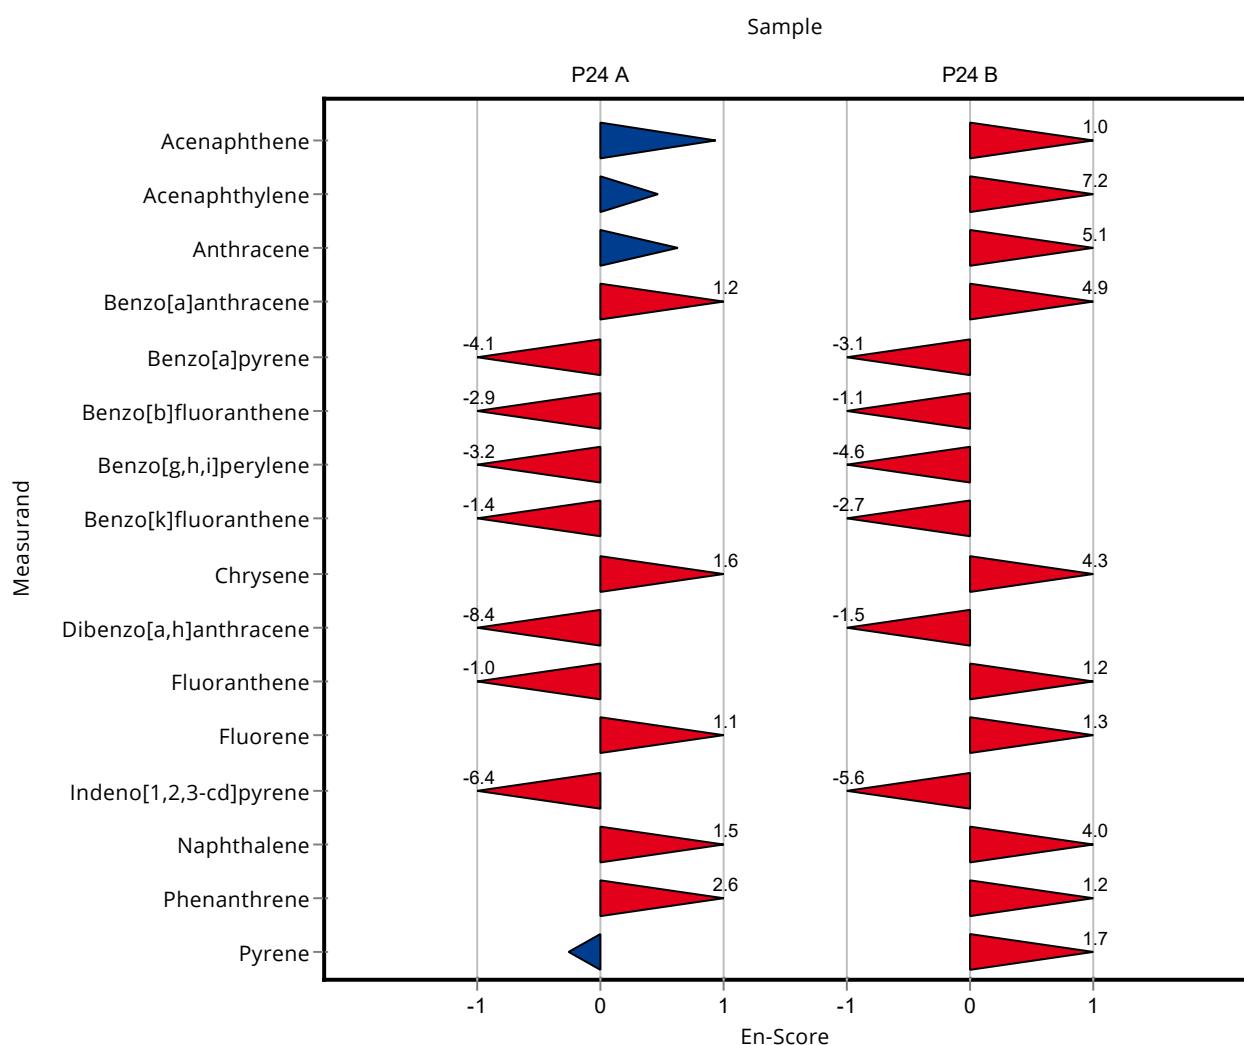


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	21.6 ± 4.8	5.08	80.8	-1.01
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	19.7 ± 4.3	5.89	80.3	-0.82
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.4 ± 4.7	6.39	87	-0.50
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	20 ± 4.4	4.77	88	-0.57
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15 ± 3.3	3.78	95.2	-0.20
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21 ± 4.6	4.05	88.2	-0.69
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	21.9 ± 4.8	7.43	94.3	-0.18
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.3 ± 4.3	5.61	89.4	-0.41
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23.1 ± 5.1	5.91	85.9	-0.64
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.2 ± 5.1	7.7	90.4	-0.32
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	22.3 ± 4.9	4.9	81.9	-1.01
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.3 ± 5.4	3.83	88.8	-0.80
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	16.5 ± 3.6	4.23	78	-1.10
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.9 ± 8.3	7.6	105	0.23
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.3 ± 6.2	9.18	95.6	-0.14
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	22 ± 4.8	4.06	86.6	-0.84

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	138 ± 30	34.1	76.9	-1.22
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	104 ± 23	34.4	72.5	-1.14
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	152 ± 33	47.2	83.8	-0.62
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	127 ± 28	30.8	86.6	-0.64
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	129 ± 28	35.4	87.5	-0.52
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	121 ± 27	23.3	88.3	-0.69
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	146 ± 32	48.6	96.2	-0.12
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	135 ± 30	39.9	88.1	-0.46
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	156 ± 34	39.7	86.5	-0.61
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	129 ± 28	39.2	98.8	-0.04
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	150 ± 33	32.3	83.5	-0.92
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	99.4 ± 22	18.3	76	-1.71
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	98.2 ± 22	20.1	88.2	-0.66

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score	
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	192 ± 42	38.3	105	0.25
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	143 ± 32	26.9	79.6	-1.36
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	149 ± 33	28.7	83.1	-1.06

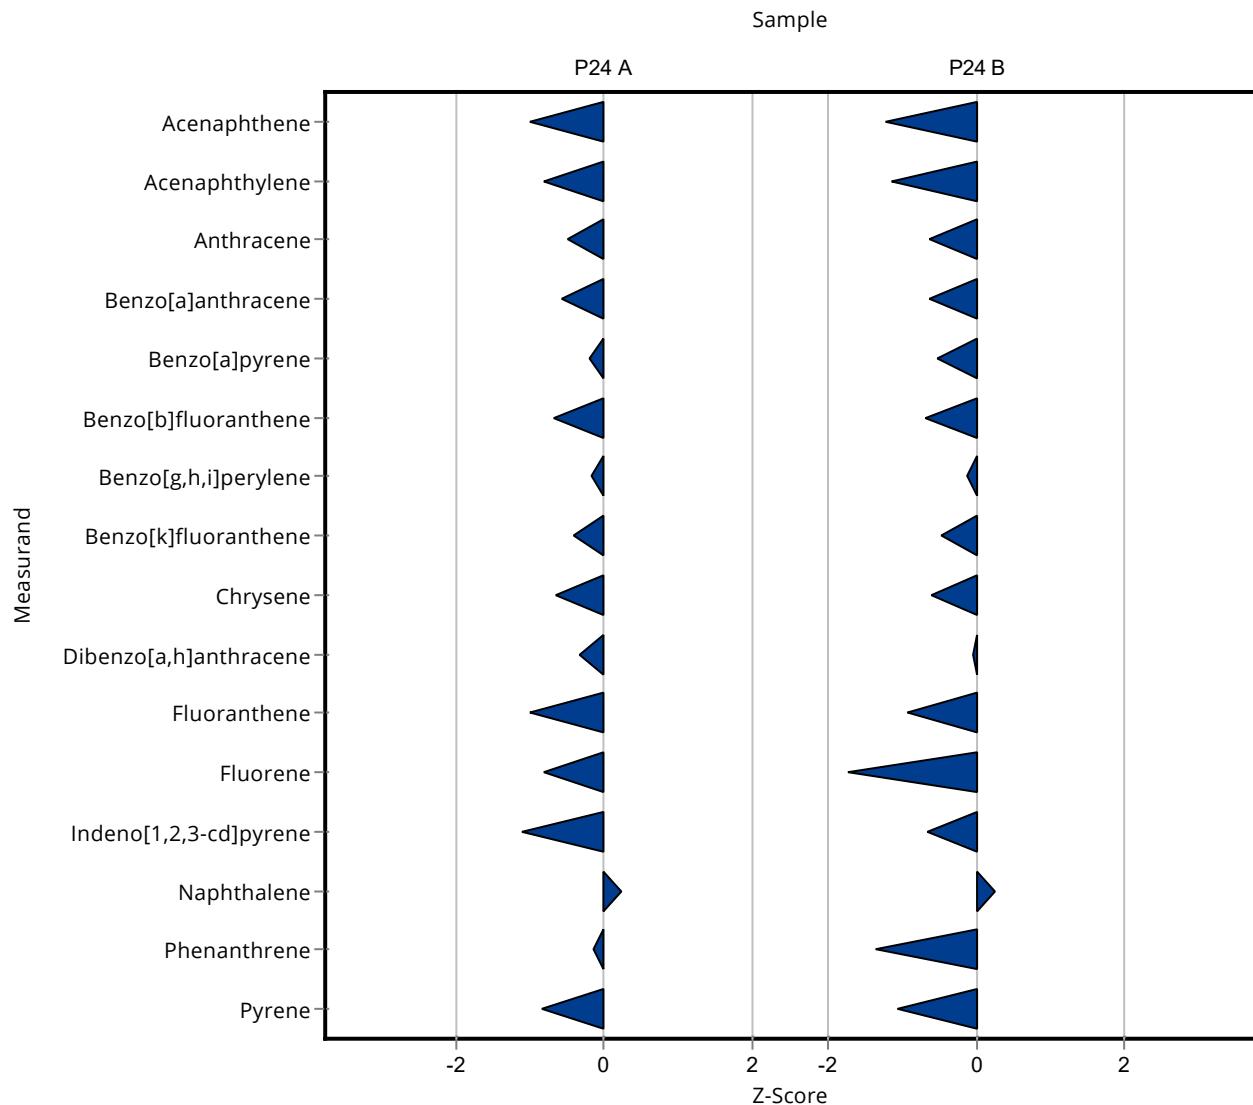


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	21.6 ± 4.8	5.08	80.8	-0.53
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	19.7 ± 4.3	5.89	80.3	-0.53
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.4 ± 4.7	6.39	87	-0.34
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	20 ± 4.4	4.77	88	-0.31
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	15 ± 3.3	3.78	95.2	-0.11
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	21 ± 4.6	4.05	88.2	-0.30
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	21.9 ± 4.8	7.43	94.3	-0.13
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.3 ± 4.3	5.61	89.4	-0.26
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	23.1 ± 5.1	5.91	85.9	-0.37
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	23.2 ± 5.1	7.7	90.4	-0.24
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	22.3 ± 4.9	4.9	81.9	-0.50
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.3 ± 5.4	3.83	88.8	-0.28
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	16.5 ± 3.6	4.23	78	-0.63
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	37.9 ± 8.3	7.6	105	0.10
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.3 ± 6.2	9.18	95.6	-0.10
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	22 ± 4.8	4.06	86.6	-0.35

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	138 ± 30	34.1	76.9	-0.68
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	104 ± 23	34.4	72.5	-0.83
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	152 ± 33	47.2	83.8	-0.44
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	127 ± 28	30.8	86.6	-0.35
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	129 ± 28	35.4	87.5	-0.33
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	121 ± 27	23.3	88.3	-0.29

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	146 ± 32	48.6	96.2	-0.09
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	135 ± 30	39.9	88.1	-0.30
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	156 ± 34	39.7	86.5	-0.36
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	129 ± 28	39.2	98.8	-0.03
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	150 ± 33	32.3	83.5	-0.45
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	99.4 ± 22	18.3	76	-0.70
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	98.2 ± 22	20.1	88.2	-0.30
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	192 ± 42	38.3	105	0.11
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	143 ± 32	26.9	79.6	-0.56
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	149 ± 33	28.7	83.1	-0.46

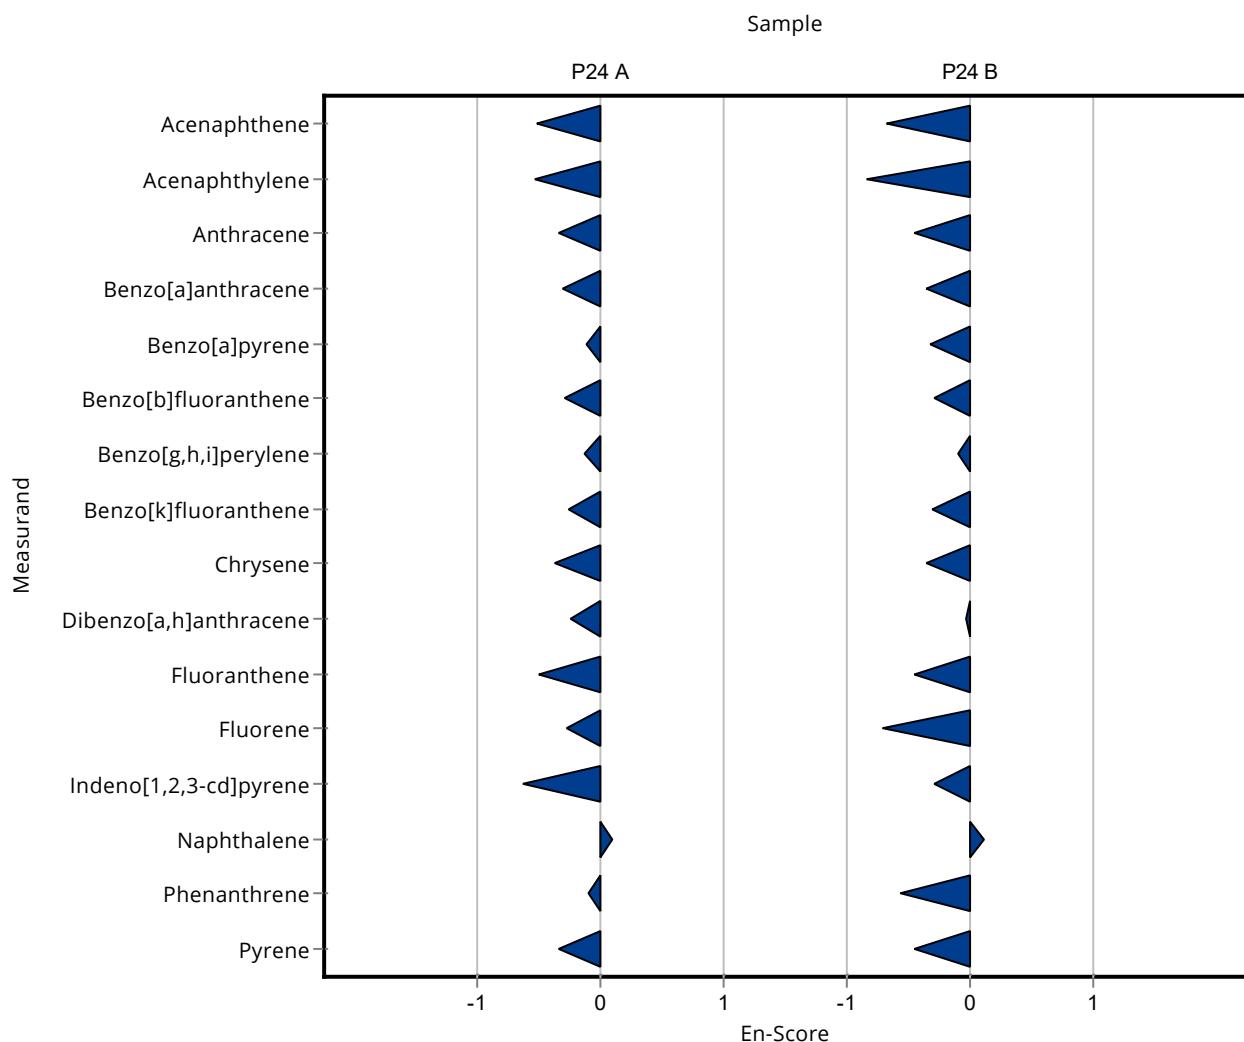


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<200 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<200 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	<200 (LOQ) ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	<200 (LOQ) ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<200 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	<200 (LOQ) ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	<200 (LOQ) ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	<200 (LOQ) ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<200 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenz[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	<200 (LOQ) ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	<200 (LOQ) ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<200 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	<200 (LOQ) ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<200 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	<200 (LOQ) ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	<200 (LOQ) ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	<200 (LOQ) ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	<200 (LOQ) ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	<200 (LOQ) ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	<200 (LOQ) ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	<200 (LOQ) ± -	35.4	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	<200 (LOQ) ± -	23.3	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	<200 (LOQ) ± -	48.6	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	<200 (LOQ) ± -	39.9	-	-
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	<200 (LOQ) ± -	39.7	-	-
Dibenz[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	<200 (LOQ) ± -	39.2	-	-
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	<200 (LOQ) ± -	32.3	-	-
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	<200 (LOQ) ± -	18.3	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	<200 (LOQ) ± -	20.1	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	220 ± 29	38.3	121 0.98
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	<200 (LOQ) ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	200 ± 26	28.7	112 0.72

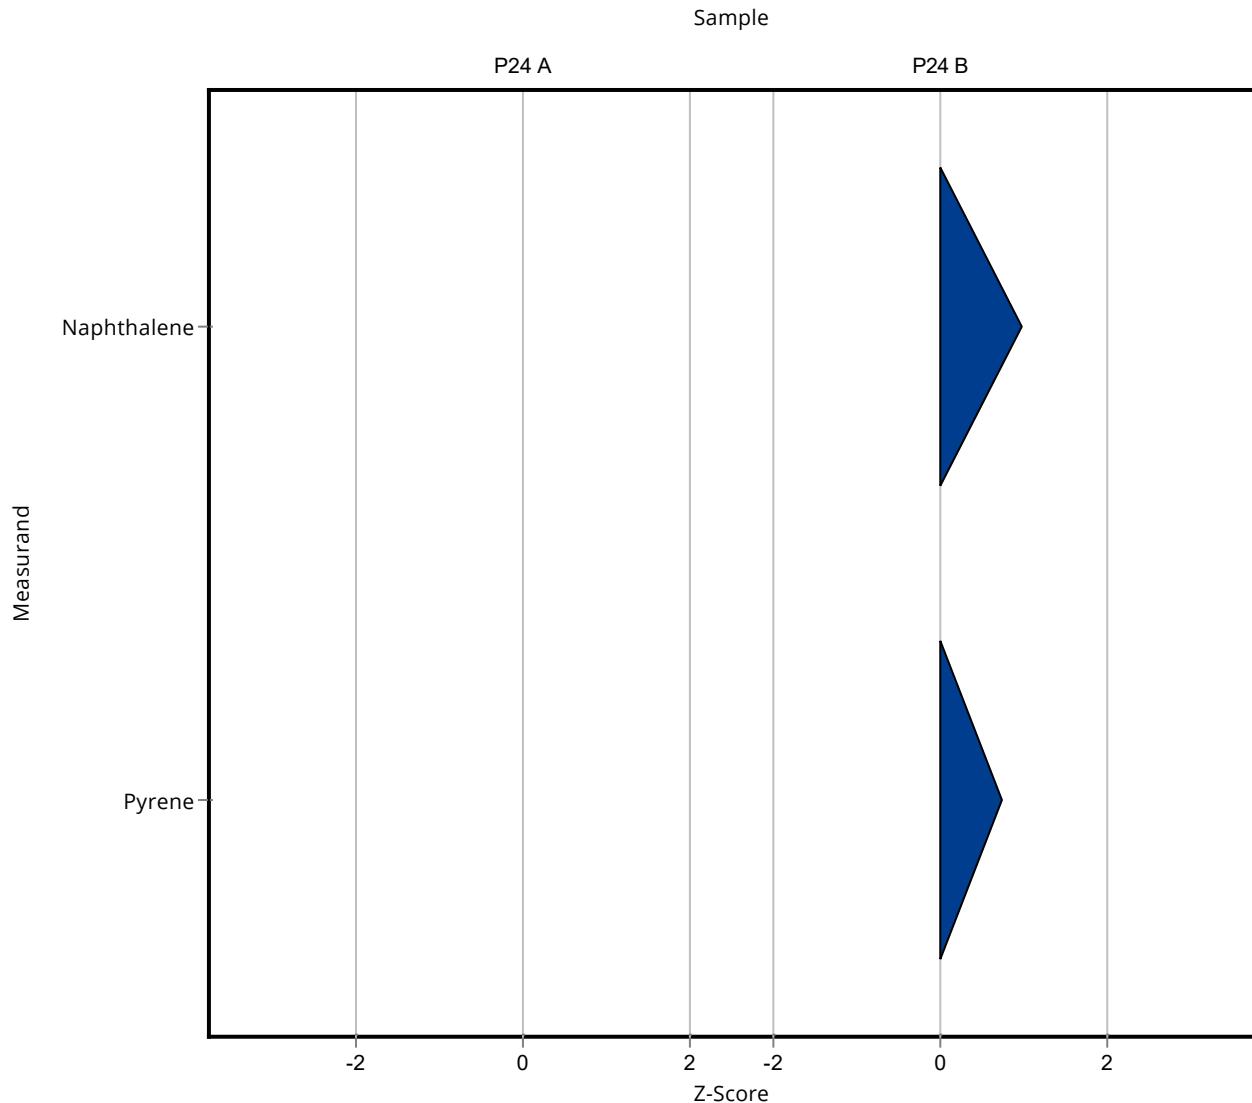


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<200 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<200 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	<200 (LOQ) ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	<200 (LOQ) ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<200 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	<200 (LOQ) ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	<200 (LOQ) ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	<200 (LOQ) ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<200 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	<200 (LOQ) ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	<200 (LOQ) ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<200 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	<200 (LOQ) ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<200 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	<200 (LOQ) ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	<200 (LOQ) ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	<200 (LOQ) ± -	34.1	-	-
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	<200 (LOQ) ± -	34.4	-	-
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	<200 (LOQ) ± -	47.2	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	<200 (LOQ) ± -	30.8	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	<200 (LOQ) ± -	35.4	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	<200 (LOQ) ± -	23.3	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	<200 (LOQ) ± -	48.6	- -
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	<200 (LOQ) ± -	39.9	- -
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	<200 (LOQ) ± -	39.7	- -
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	<200 (LOQ) ± -	39.2	- -
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	<200 (LOQ) ± -	32.3	- -
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	<200 (LOQ) ± -	18.3	- -
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	<200 (LOQ) ± -	20.1	- -
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	220 ± 29	38.3	121 0.63
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	<200 (LOQ) ± -	26.9	- -
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	200 ± 26	28.7	112 0.39

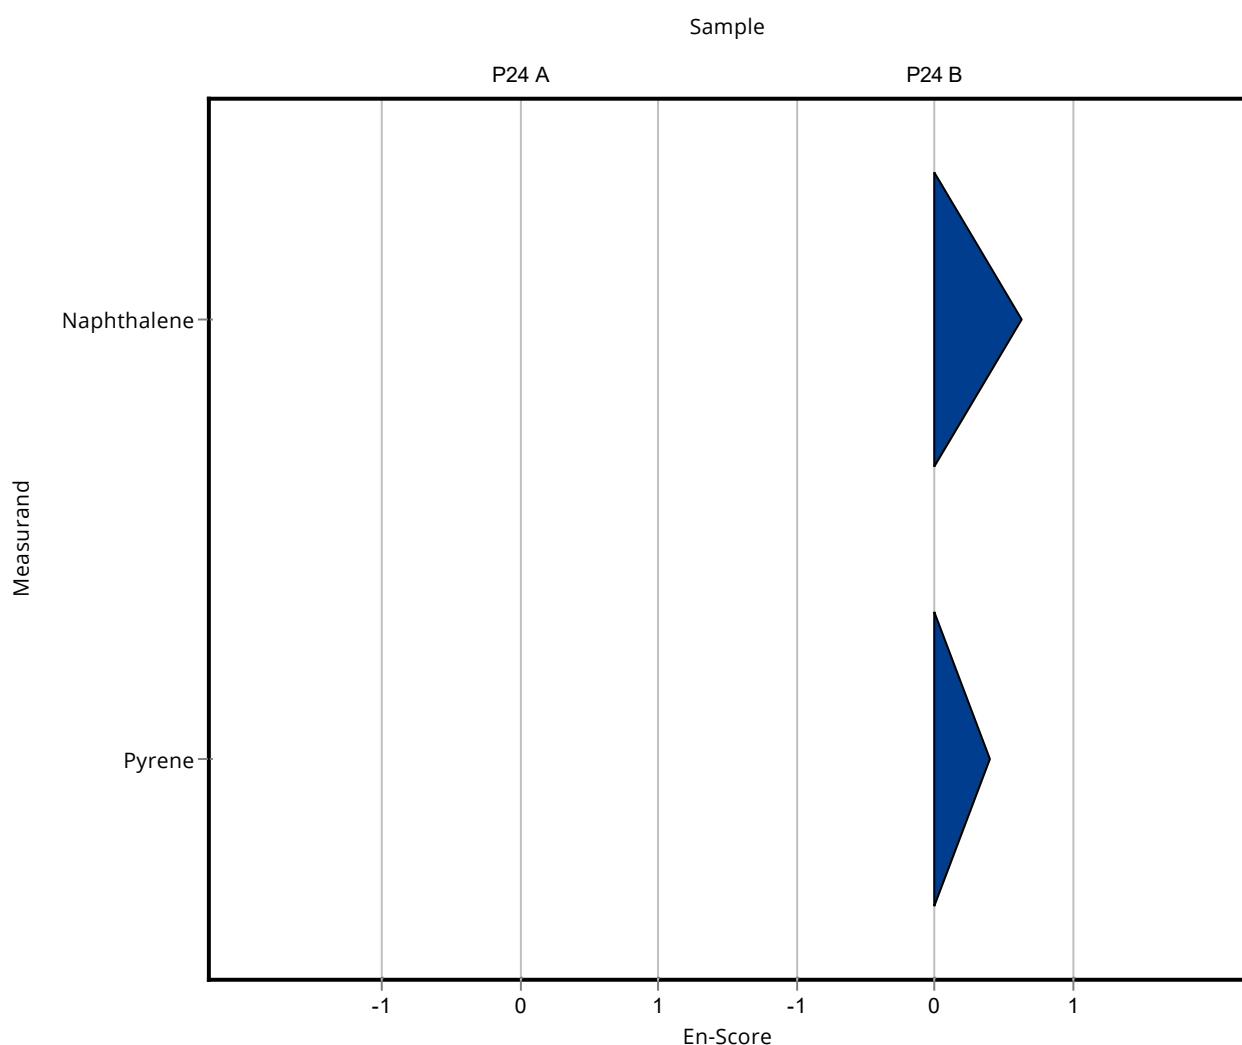


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	23 ± 4.6	5.08	86.1	-0.73
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	31.6 ± 6.3	5.89	129	1.20
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 5	6.39	101	0.05
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	18.9 ± 3.8	4.77	83.1	-0.80
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.5 ± 2.5	3.78	79.4	-0.86
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	17.3 ± 3.5	4.05	72.7	-1.61
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	19 ± 3.8	7.43	81.8	-0.57
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	15.8 ± 3.2	5.61	73.2	-1.03
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	16.6 ± 3.3	5.91	61.8	-1.74
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	19.8 ± 4	7.7	77.2	-0.76
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	20.2 ± 4	4.9	74.2	-1.43
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.6 ± 4.9	3.83	89.9	-0.72
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	18.3 ± 3.7	4.23	86.5	-0.68
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	31 ± 6.2	7.6	85.7	-0.68
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	20 ± 4	9.18	67.5	-1.05
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	17.3 ± 3.5	4.06	68.1	-1.99

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	178 ± 36	34.1	99.1	-0.05
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	163 ± 33	34.4	114	0.57
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	205 ± 41	47.2	113	0.50
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	135 ± 27	30.8	92.1	-0.38
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	131 ± 26	35.4	88.8	-0.47
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	122 ± 24	23.3	89	-0.64
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	153 ± 31	48.6	101	0.02
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	140 ± 28	39.9	91.3	-0.33
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	132 ± 26	39.7	73.2	-1.22
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	116 ± 23	39.2	88.8	-0.37
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	161 ± 32	32.3	89.6	-0.58
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	144 ± 29	18.3	110	0.72
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	118 ± 24	20.1	106	0.33

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	179 ± 36	38.3	98.1 -0.09
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	139 ± 28	26.9	77.4 -1.51
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	146 ± 29	28.7	81.4 -1.16

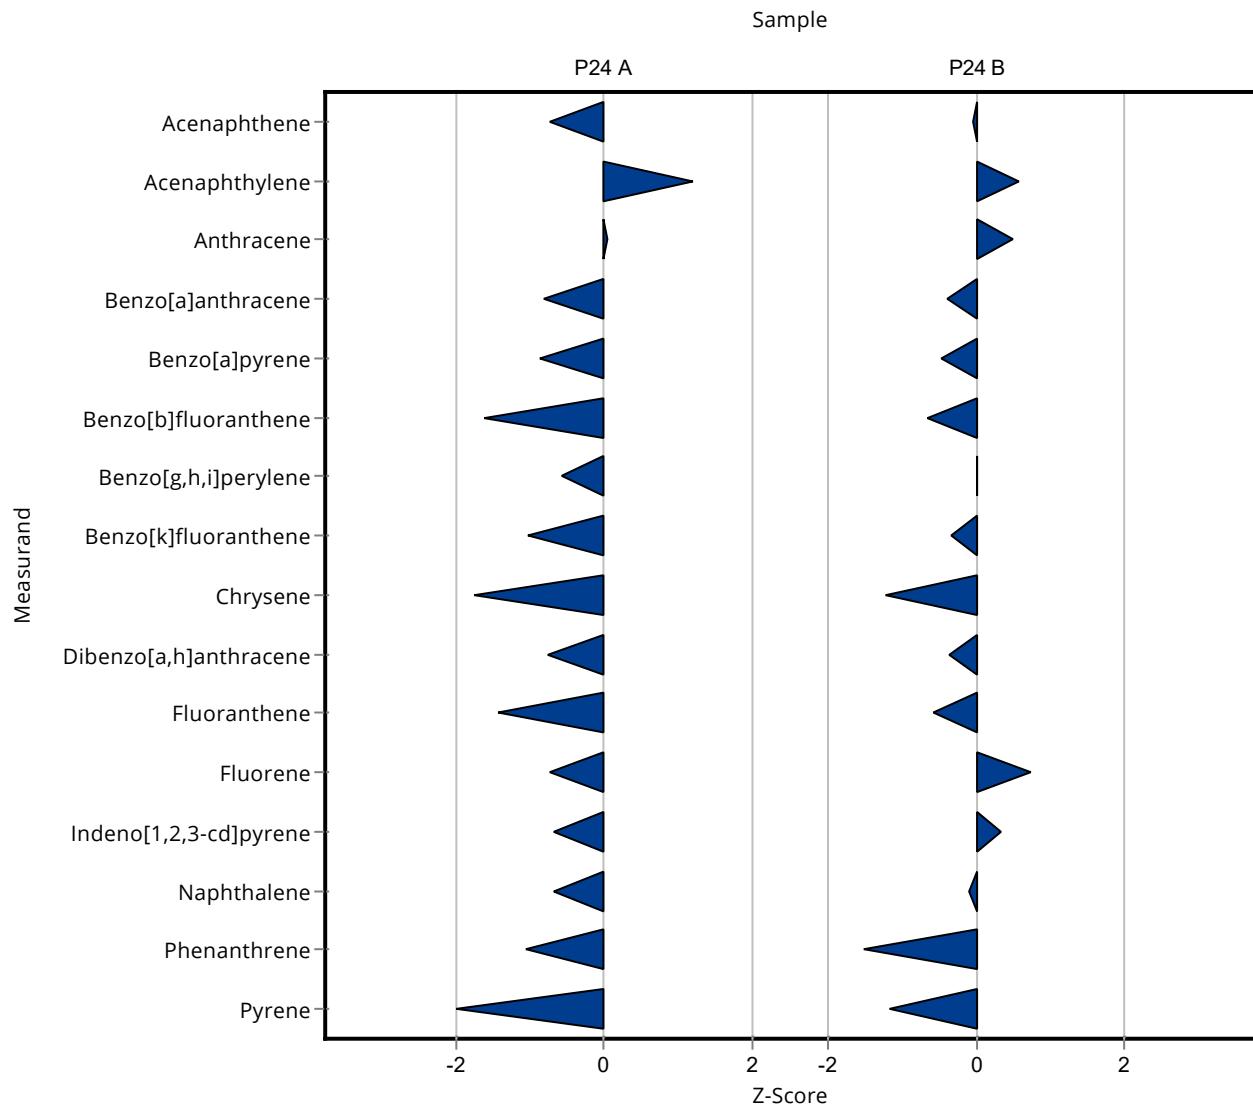


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	23 ± 4.6	5.08	86.1	-0.40
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	31.6 ± 6.3	5.89	129	0.55
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24.9 ± 5	6.39	101	0.03
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	18.9 ± 3.8	4.77	83.1	-0.50
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	12.5 ± 2.5	3.78	79.4	-0.63
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	17.3 ± 3.5	4.05	72.7	-0.91
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	19 ± 3.8	7.43	81.8	-0.54
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	15.8 ± 3.2	5.61	73.2	-0.89
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	16.6 ± 3.3	5.91	61.8	-1.53
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	19.8 ± 4	7.7	77.2	-0.72
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	20.2 ± 4	4.9	74.2	-0.86
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.6 ± 4.9	3.83	89.9	-0.28
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	18.3 ± 3.7	4.23	86.5	-0.38
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	31 ± 6.2	7.6	85.7	-0.40
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	20 ± 4	9.18	67.5	-1.09
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	17.3 ± 3.5	4.06	68.1	-1.13

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	178 ± 36	34.1	99.1	-0.02
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	163 ± 33	34.4	114	0.29
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	205 ± 41	47.2	113	0.29
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	135 ± 27	30.8	92.1	-0.21
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	131 ± 26	35.4	88.8	-0.31
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	122 ± 24	23.3	89	-0.31

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	153 ± 31	48.6	101	0.02
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	140 ± 28	39.9	91.3	-0.23
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	132 ± 26	39.7	73.2	-0.92
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	116 ± 23	39.2	88.8	-0.29
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	161 ± 32	32.3	89.6	-0.29
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	144 ± 29	18.3	110	0.23
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	118 ± 24	20.1	106	0.14
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	179 ± 36	38.3	98.1	-0.05
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	139 ± 28	26.9	77.4	-0.70
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	146 ± 29	28.7	81.4	-0.57

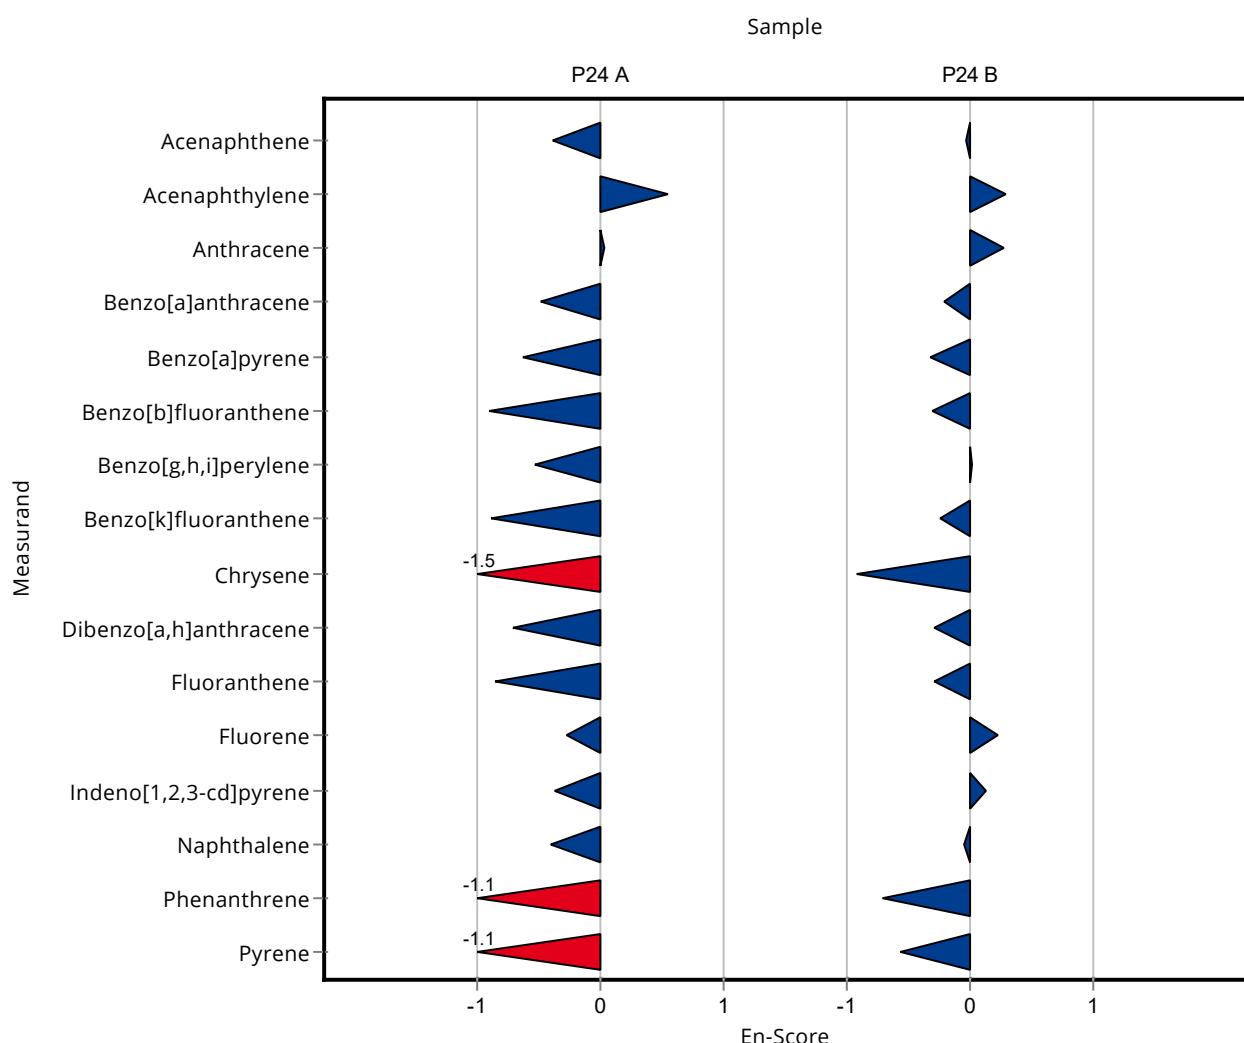


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<10 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<10 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	<10 (LOQ) ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	<10 (LOQ) ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<5 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	<10 (LOQ) ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	<10 (LOQ) ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	<10 (LOQ) ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<10 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	<10 (LOQ) ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	<10 (LOQ) ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<10 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	<10 (LOQ) ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<10 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	<10 (LOQ) ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	<10 (LOQ) ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	20 ± 4	34.1	11.1	-4.68
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	13.5 ± 2.7	34.4	9.42	-3.77
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	21.5 ± 4.3	47.2	11.8	-3.39
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	18 ± 3.6	30.8	12.3	-4.18
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	16.5 ± 3.3	35.4	11.2	-3.70
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	16 ± 3.2	23.3	11.7	-5.20
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	16.5 ± 3.3	48.6	10.9	-2.79
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	18 ± 3.6	39.9	11.7	-3.39
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	20.5 ± 4.1	39.7	11.4	-4.03
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	11.5 ± 2.3	39.2	8.81	-3.04
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	21.5 ± 4.3	32.3	12	-4.89
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	13.5 ± 2.7	18.3	10.3	-6.41
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	13.5 ± 2.7	20.1	12.1	-4.88

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	21 ± 4.2	38.3	11.5 -4.21
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	20 ± 4	26.9	11.1 -5.92
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	21 ± 4.2	28.7	11.7 -5.52

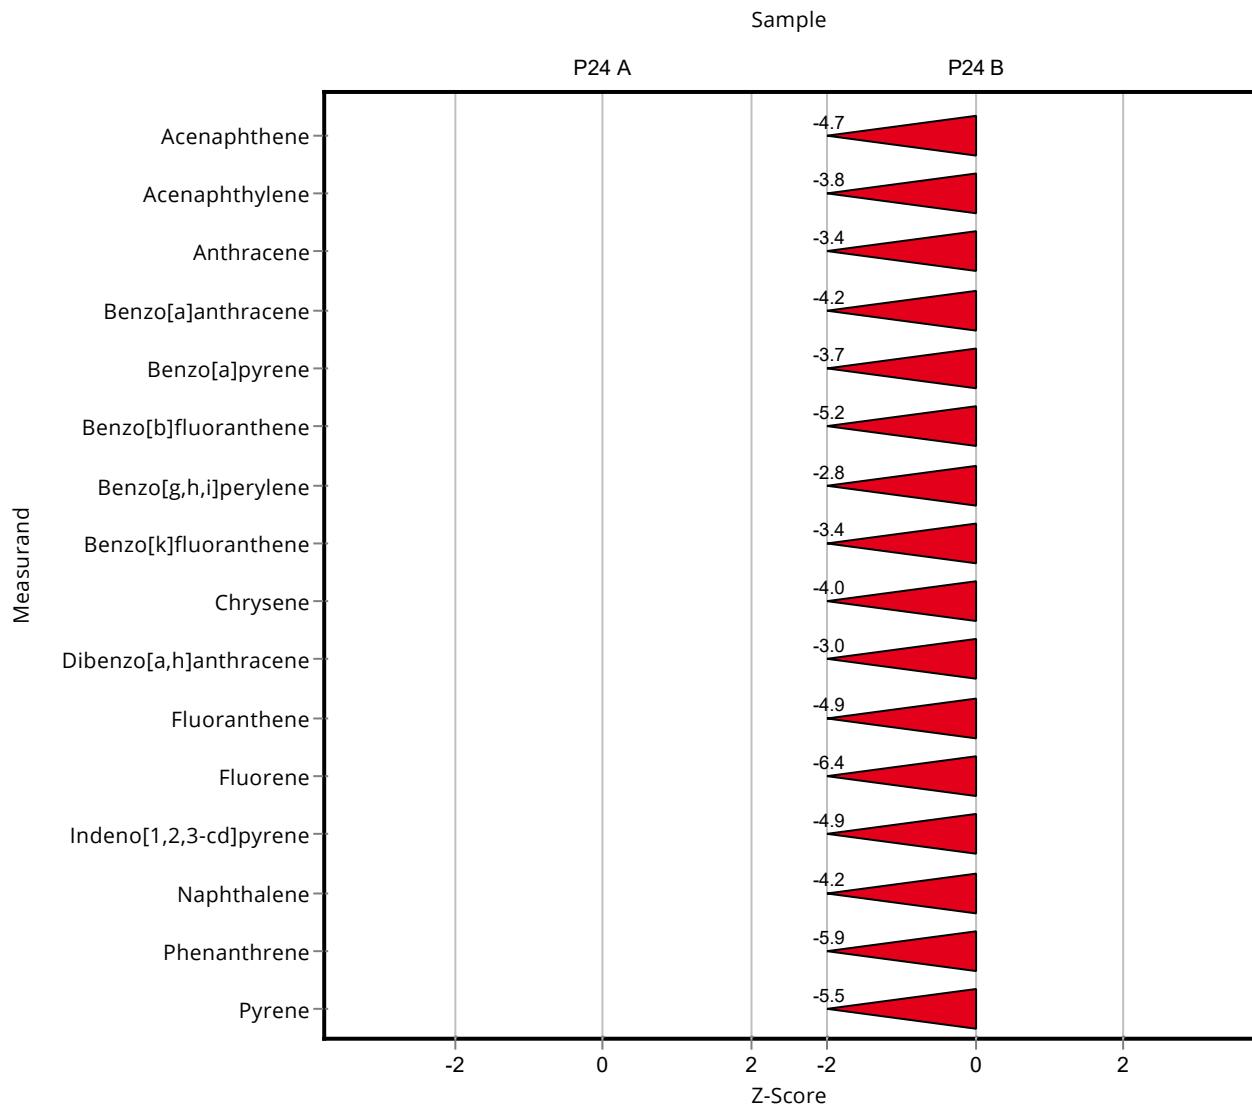


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	<10 (LOQ) ± -	5.08	-	-
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	<10 (LOQ) ± -	5.89	-	-
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	<10 (LOQ) ± -	6.39	-	-
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	<10 (LOQ) ± -	4.77	-	-
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	<5 (LOQ) ± -	3.78	-	-
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	<10 (LOQ) ± -	4.05	-	-
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	<10 (LOQ) ± -	7.43	-	-
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	<10 (LOQ) ± -	5.61	-	-
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	<10 (LOQ) ± -	5.91	-	-
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	<10 (LOQ) ± -	7.7	-	-
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	<10 (LOQ) ± -	4.9	-	-
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	<10 (LOQ) ± -	3.83	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	<10 (LOQ) ± -	4.23	-	-
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	<10 (LOQ) ± -	7.6	-	-
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	<10 (LOQ) ± -	9.18	-	-
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	<10 (LOQ) ± -	4.06	-	-

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	20 ± 4	34.1	11.1	-12.45
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	13.5 ± 2.7	34.4	9.42	-11.12
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	21.5 ± 4.3	47.2	11.8	-13.89
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	18 ± 3.6	30.8	12.3	-12.22
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	16.5 ± 3.3	35.4	11.2	-12.06
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	16 ± 3.2	23.3	11.7	-11.67

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	16.5 ± 3.3	48.6	10.9 -10.12
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	18 ± 3.6	39.9	11.7 -12.22
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	20.5 ± 4.1	39.7	11.4 -14.12
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	11.5 ± 2.3	39.2	8.81 -6.02
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	21.5 ± 4.3	32.3	12 -12.99
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	13.5 ± 2.7	18.3	10.3 -12.58
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	13.5 ± 2.7	20.1	12.1 -10.66
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	21 ± 4.2	38.3	11.5 -10.62
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	20 ± 4	26.9	11.1 -10.06
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	21 ± 4.2	28.7	11.7 -13.58

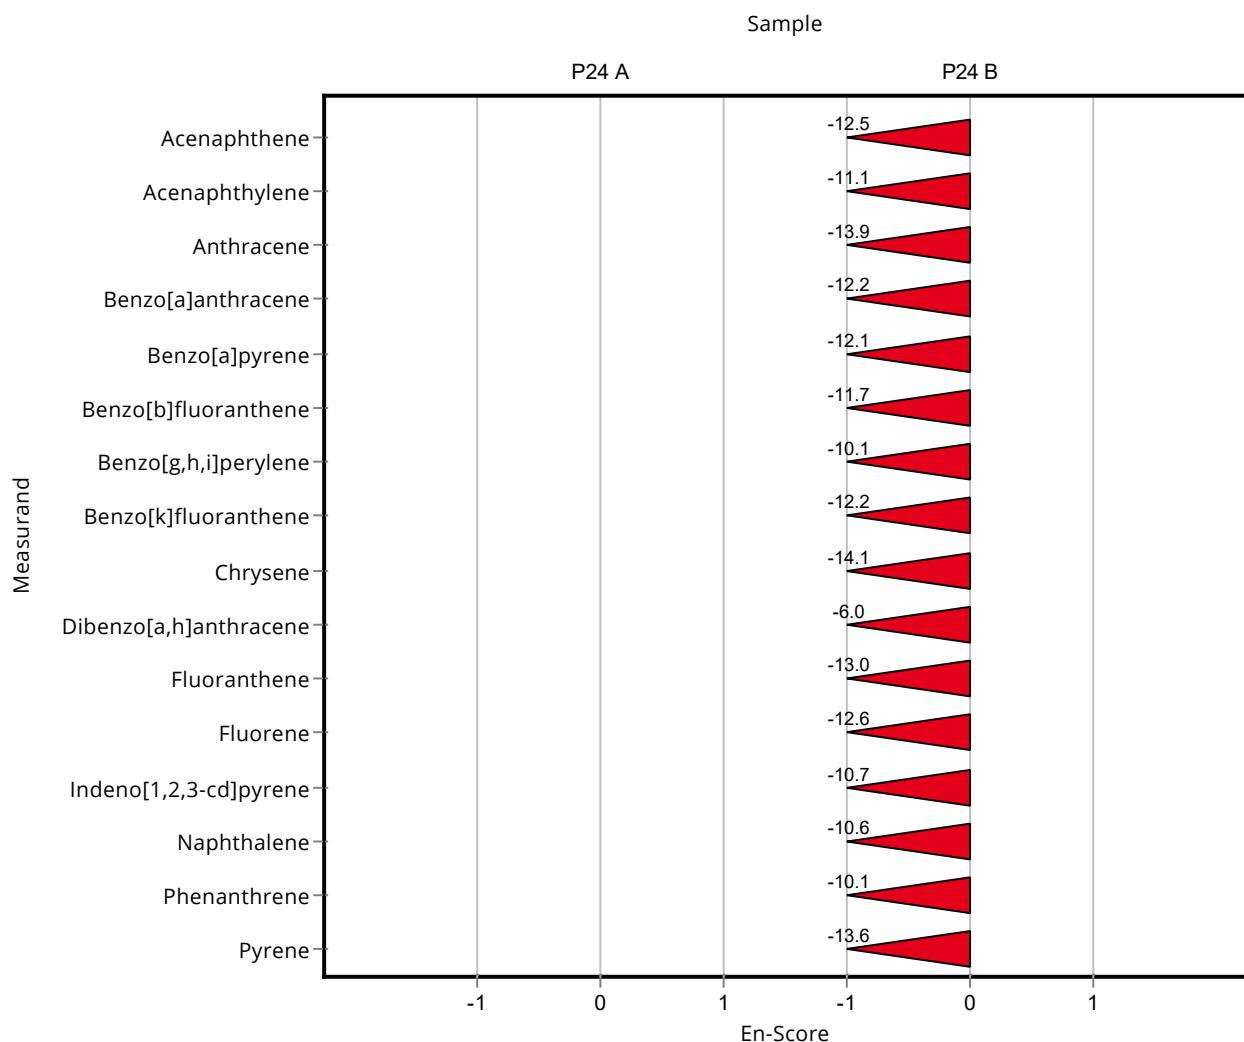


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	29.7 ± 6.1	5.08	111	0.59
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	11.8 ± 2.4	5.89	48.1	-2.16
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.8 ± 4.1	6.39	88.6	-0.44
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.8 ± 2.8	4.77	100	0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	10.6 ± 1.2	3.78	67.3	-1.36
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	27.3 ± 3.9	4.05	115	0.87
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	25.6 ± 4.8	7.43	110	0.32
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.7 ± 3.2	5.61	114	0.56
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.6 ± 3.5	5.91	103	0.12
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.9 ± 6.1	7.7	101	0.03
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.8 ± 4	4.9	106	0.32
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.6 ± 4	3.83	112	0.84
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.5 ± 2.9	4.23	111	0.55
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	42.4 ± 8	7.6	117	0.82
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	30.2 ± 3.7	9.18	102	0.06
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 3.5	4.06	105	0.29

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	203 ± 41	34.1	113	0.69
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	158 ± 32	34.4	110	0.43
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	195 ± 37	47.2	107	0.29
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152 ± 19	30.8	104	0.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153 ± 18	35.4	104	0.16
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	151 ± 22	23.3	110	0.60
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	130 ± 24	48.6	85.6	-0.45
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	171 ± 22	39.9	112	0.44
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	185 ± 23	39.7	103	0.12
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	112 ± 26	39.2	85.8	-0.47
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	196 ± 27	32.3	109	0.51
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	139 ± 18	18.3	106	0.45
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	105 ± 13	20.1	94.3	-0.32

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	201 ± 38	38.3	110 0.48
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	186 ± 23	26.9	104 0.24
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	196 ± 26	28.7	109 0.58

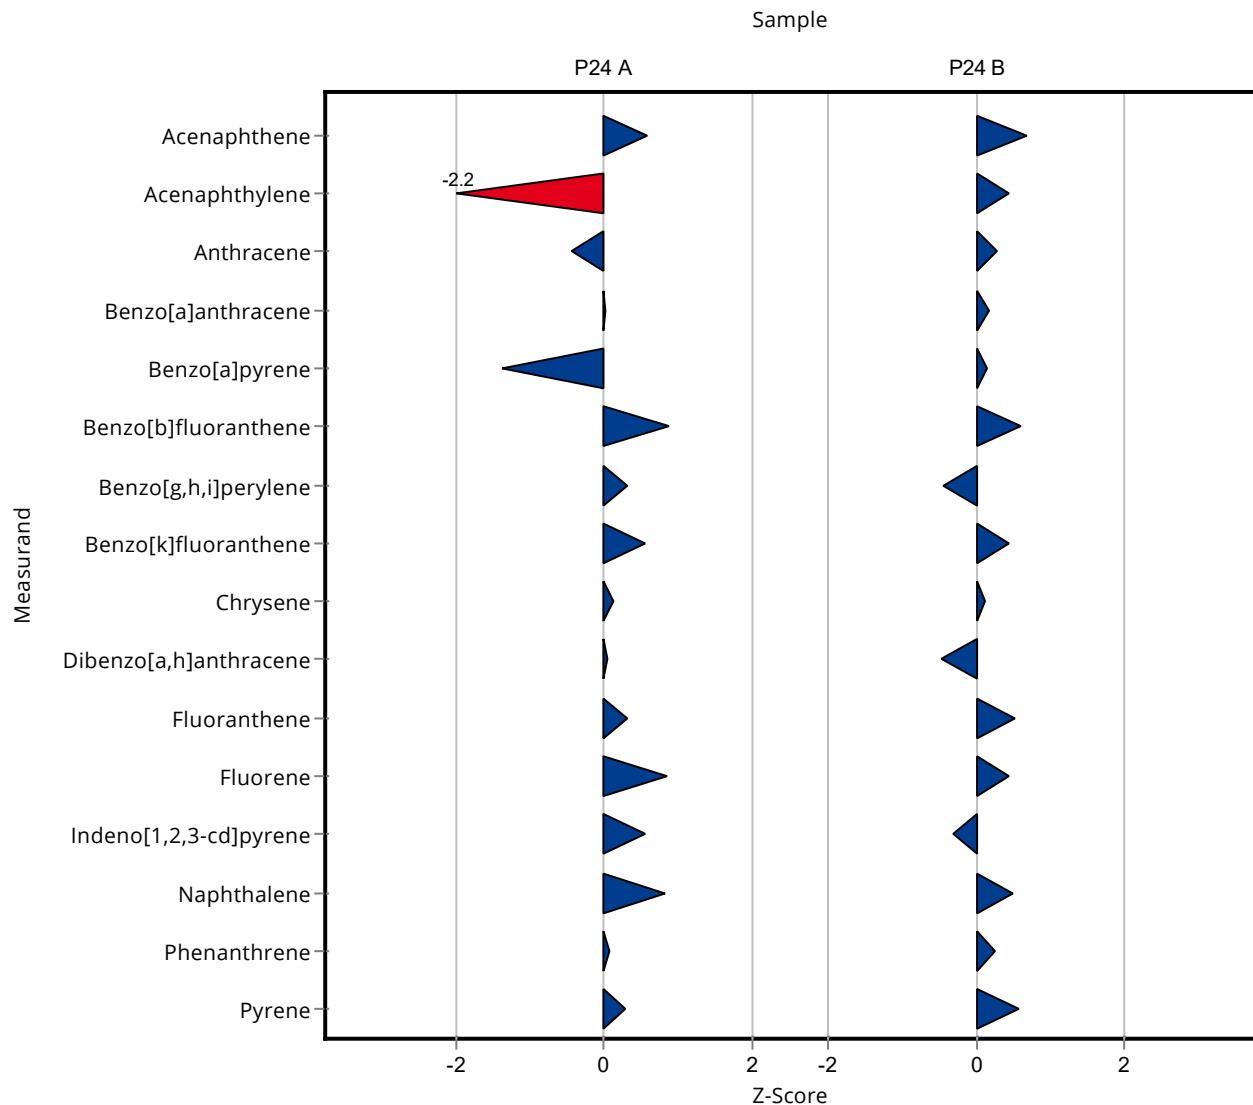


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	29.7 ± 6.1	5.08	111	0.24
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	11.8 ± 2.4	5.89	48.1	-2.28
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	21.8 ± 4.1	6.39	88.6	-0.34
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	22.8 ± 2.8	4.77	100	0.01
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	10.6 ± 1.2	3.78	67.3	-1.86
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	27.3 ± 3.9	4.05	115	0.44
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	25.6 ± 4.8	7.43	110	0.24
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.7 ± 3.2	5.61	114	0.48
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.6 ± 3.5	5.91	103	0.10
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.9 ± 6.1	7.7	101	0.02
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.8 ± 4	4.9	106	0.19
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	30.6 ± 4	3.83	112	0.40
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.5 ± 2.9	4.23	111	0.39
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	42.4 ± 8	7.6	117	0.38
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	30.2 ± 3.7	9.18	102	0.07
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.6 ± 3.5	4.06	105	0.17

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	203 ± 41	34.1	113	0.28
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	158 ± 32	34.4	110	0.23
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	195 ± 37	47.2	107	0.18
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	152 ± 19	30.8	104	0.14
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	153 ± 18	35.4	104	0.15
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	151 ± 22	23.3	110	0.31

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	130 ± 24	48.6	85.6	-0.44
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	171 ± 22	39.9	112	0.40
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	185 ± 23	39.7	103	0.10
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	112 ± 26	39.2	85.8	-0.34
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	196 ± 27	32.3	109	0.30
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	139 ± 18	18.3	106	0.22
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	105 ± 13	20.1	94.3	-0.24
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	201 ± 38	38.3	110	0.24
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	186 ± 23	26.9	104	0.13
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	196 ± 26	28.7	109	0.32

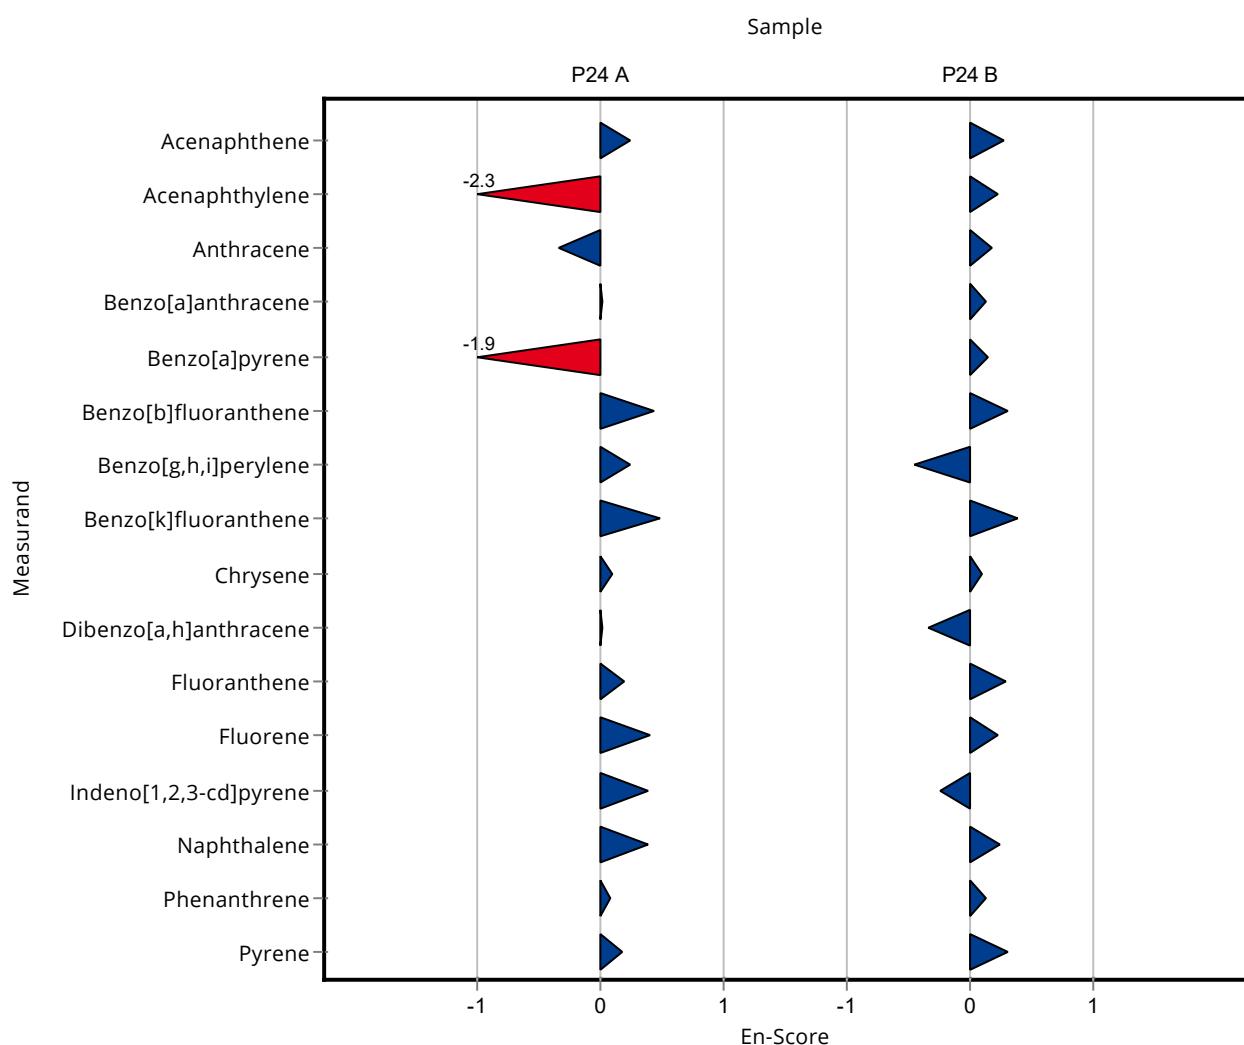


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	29.23 ± 2.79	5.08	109	0.50
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.03 ± 1.96	5.89	114	0.59
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.09 ± 1.97	6.39	102	0.08
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.07 ± 4.575	4.77	92.7	-0.35
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16.72 ± 2.525	3.78	106	0.26
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	24.27 ± 4.395	4.05	102	0.12
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.39 ± 3.245	7.43	118	0.56
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.17 ± 2.04	5.61	112	0.46
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.99 ± 2.41	5.91	104	0.19
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30 ± 3.585	7.7	117	0.56
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.4 ± 2.53	4.9	104	0.24
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.46 ± 2.505	3.83	108	0.55
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.53 ± 5.06	4.23	111	0.56
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35.18 ± 3.925	7.6	97.2	-0.13
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.55 ± 2.925	9.18	96.4	-0.12
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.98 ± 2.4	4.06	106	0.39

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	191.19 ± 18.26	34.1	106	0.34
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	150.42 ± 10.53	34.4	105	0.21
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	184.45 ± 14.48	47.2	102	0.06
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	150.14 ± 32.58	30.8	102	0.11
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	167.35 ± 25.27	35.4	113	0.56
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	153.49 ± 27.78	23.3	112	0.71
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	167.25 ± 19.82	48.6	110	0.32
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	176.66 ± 14.93	39.9	115	0.59
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	188.26 ± 16.19	39.7	104	0.20
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	174.04 ± 20.8	39.2	133	1.11
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194.29 ± 17.29	32.3	108	0.45
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	132.31 ± 11.245	18.3	101	0.08
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	121.77 ± 26.18	20.1	109	0.52

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	183.83 ± 20.495	38.3	101 0.04
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	174.36 ± 17.87	26.9	97.1 -0.19
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	192.11 ± 17.095	28.7	107 0.45

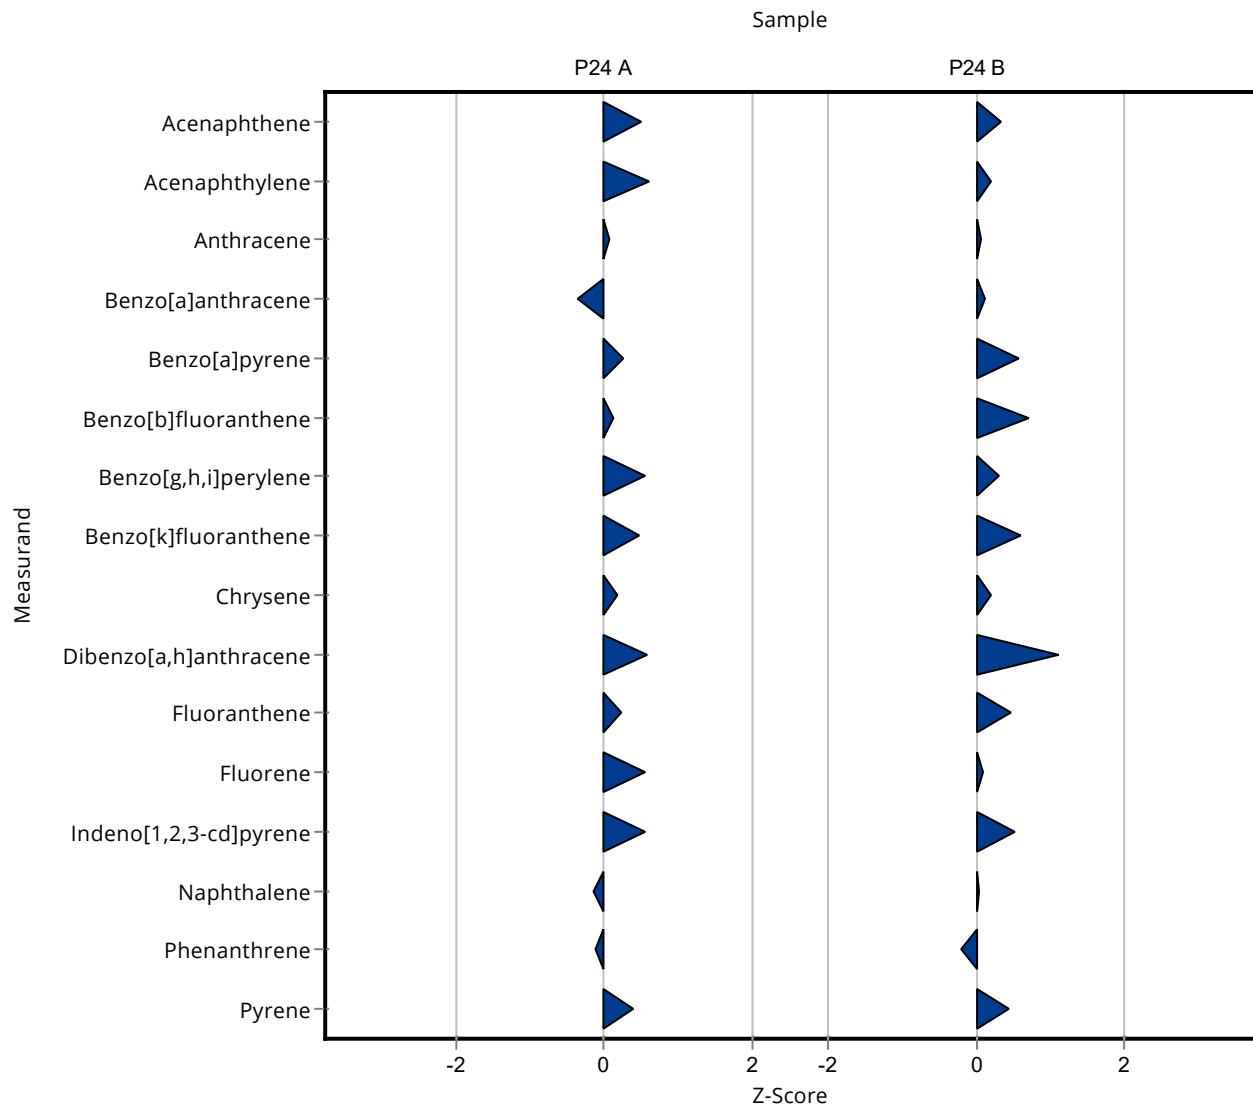


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	29.23 ± 2.79	5.08	109	0.44
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	28.03 ± 1.96	5.89	114	0.72
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	25.09 ± 1.97	6.39	102	0.12
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.07 ± 4.575	4.77	92.7	-0.18
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	16.72 ± 2.525	3.78	106	0.19
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	24.27 ± 4.395	4.05	102	0.05
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	27.39 ± 3.245	7.43	118	0.62
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	24.17 ± 2.04	5.61	112	0.61
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27.99 ± 2.41	5.91	104	0.22
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	30 ± 3.585	7.7	117	0.59
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	28.4 ± 2.53	4.9	104	0.22
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	29.46 ± 2.505	3.83	108	0.41
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	23.53 ± 5.06	4.23	111	0.23
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	35.18 ± 3.925	7.6	97.2	-0.12
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	28.55 ± 2.925	9.18	96.4	-0.15
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	26.98 ± 2.4	4.06	106	0.31

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	191.19 ± 18.26	34.1	106	0.31
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	150.42 ± 10.53	34.4	105	0.30
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	184.45 ± 14.48	47.2	102	0.10
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	150.14 ± 32.58	30.8	102	0.05
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	167.35 ± 25.27	35.4	113	0.39
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	153.49 ± 27.78	23.3	112	0.29

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	167.25 ± 19.82	48.6	110	0.37
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	176.66 ± 14.93	39.9	115	0.75
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	188.26 ± 16.19	39.7	104	0.24
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	174.04 ± 20.8	39.2	133	0.95
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	194.29 ± 17.29	32.3	108	0.41
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	132.31 ± 11.245	18.3	101	0.06
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	121.77 ± 26.18	20.1	109	0.20
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	183.83 ± 20.495	38.3	101	0.03
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	174.36 ± 17.87	26.9	97.1	-0.14
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	192.11 ± 17.095	28.7	107	0.36

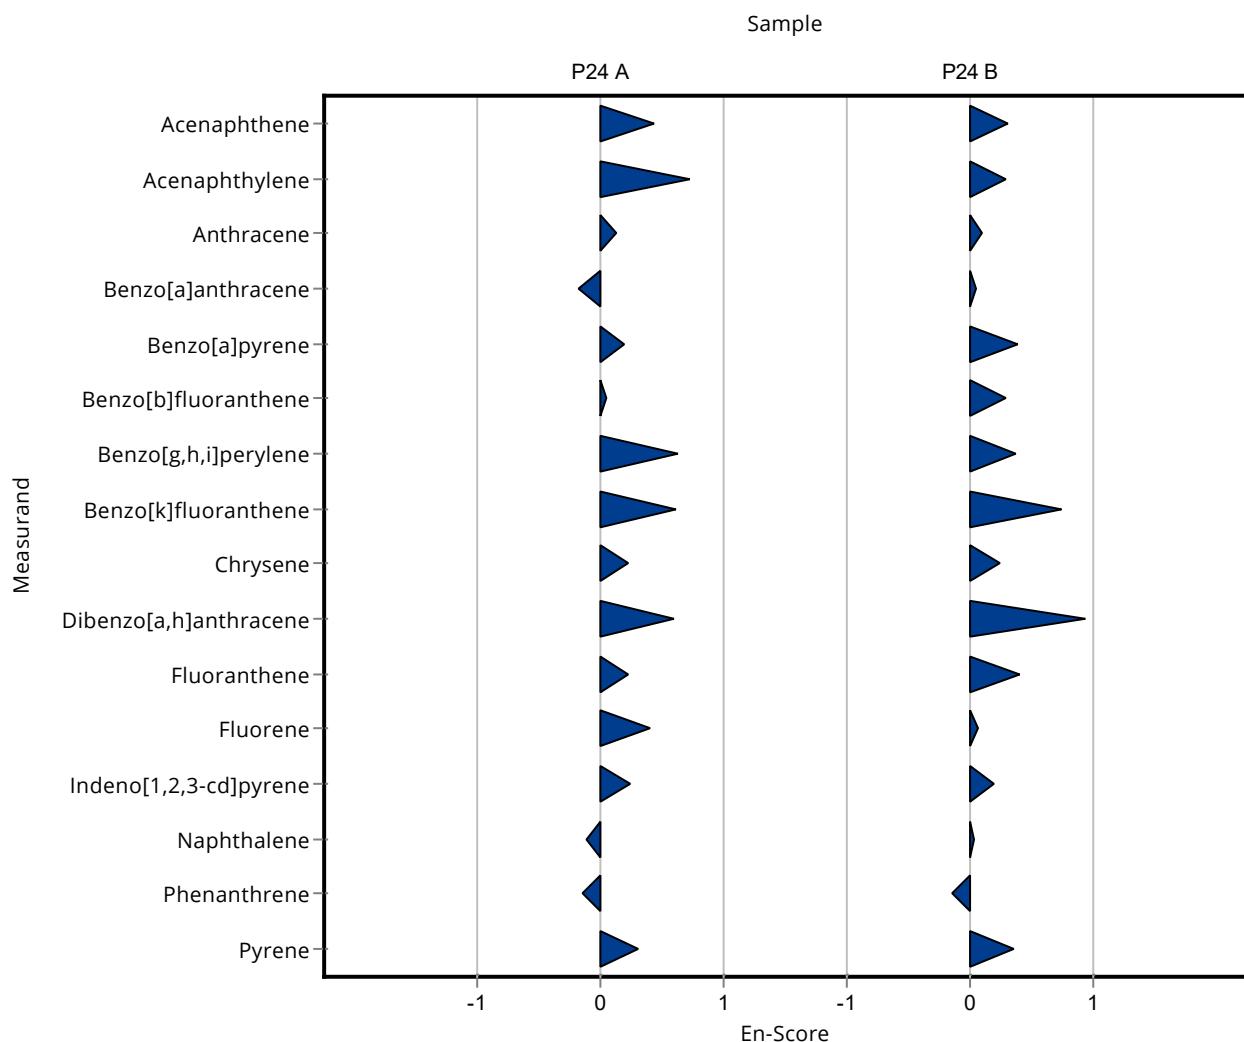


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	62.1 ± 14	5.08	232	6.97
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	57.5 ± 7.6	5.89	234	5.60
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24 ± 1.6	6.39	97.6	-0.09
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.1 ± 3.2	4.77	92.8	-0.34
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	11.7 ± 1.3	3.78	74.3	-1.07
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	28.6 ± 5.4	4.05	120	1.19
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.9 ± 2.3	7.43	107	0.23
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.7 ± 2.3	5.61	105	0.20
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27 ± 2.5	5.91	100	0.02
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.7 ± 4	7.7	100	0.01
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	66.1 ± 4.6	4.9	243	7.93
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	54 ± 7.4	3.83	197	6.95
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.4 ± 2.7	4.23	106	0.29
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	28.7 ± 8.1	7.6	79.3	-0.99
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	122.6 ± 13.2	9.18	414	10.13
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.8 ± 1.8	4.06	85.8	-0.89

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	149.3 ± 33.7	34.1	83.1	-0.89
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	128.6 ± 17	34.4	89.7	-0.43
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	164.7 ± 11	47.2	90.8	-0.36
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	131.7 ± 20.2	30.8	89.8	-0.48
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	146.5 ± 16.6	35.4	99.3	-0.03
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	131.3 ± 24.9	23.3	95.8	-0.24
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	137.3 ± 13	48.6	90.4	-0.30
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	142.4 ± 14.5	39.9	92.9	-0.27
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	160.3 ± 14.7	39.7	88.9	-0.50
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	115.8 ± 17.8	39.2	88.7	-0.38
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	157.2 ± 11	32.3	87.5	-0.69
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	115.4 ± 15.8	18.3	88.2	-0.84
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	99.9 ± 11.9	20.1	89.7	-0.57

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	47.5 ± 13.4	38.3	26 -3.52
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	295.9 ± 31.8	26.9	165 4.32
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	178.5 ± 14.5	28.7	99.5 -0.03

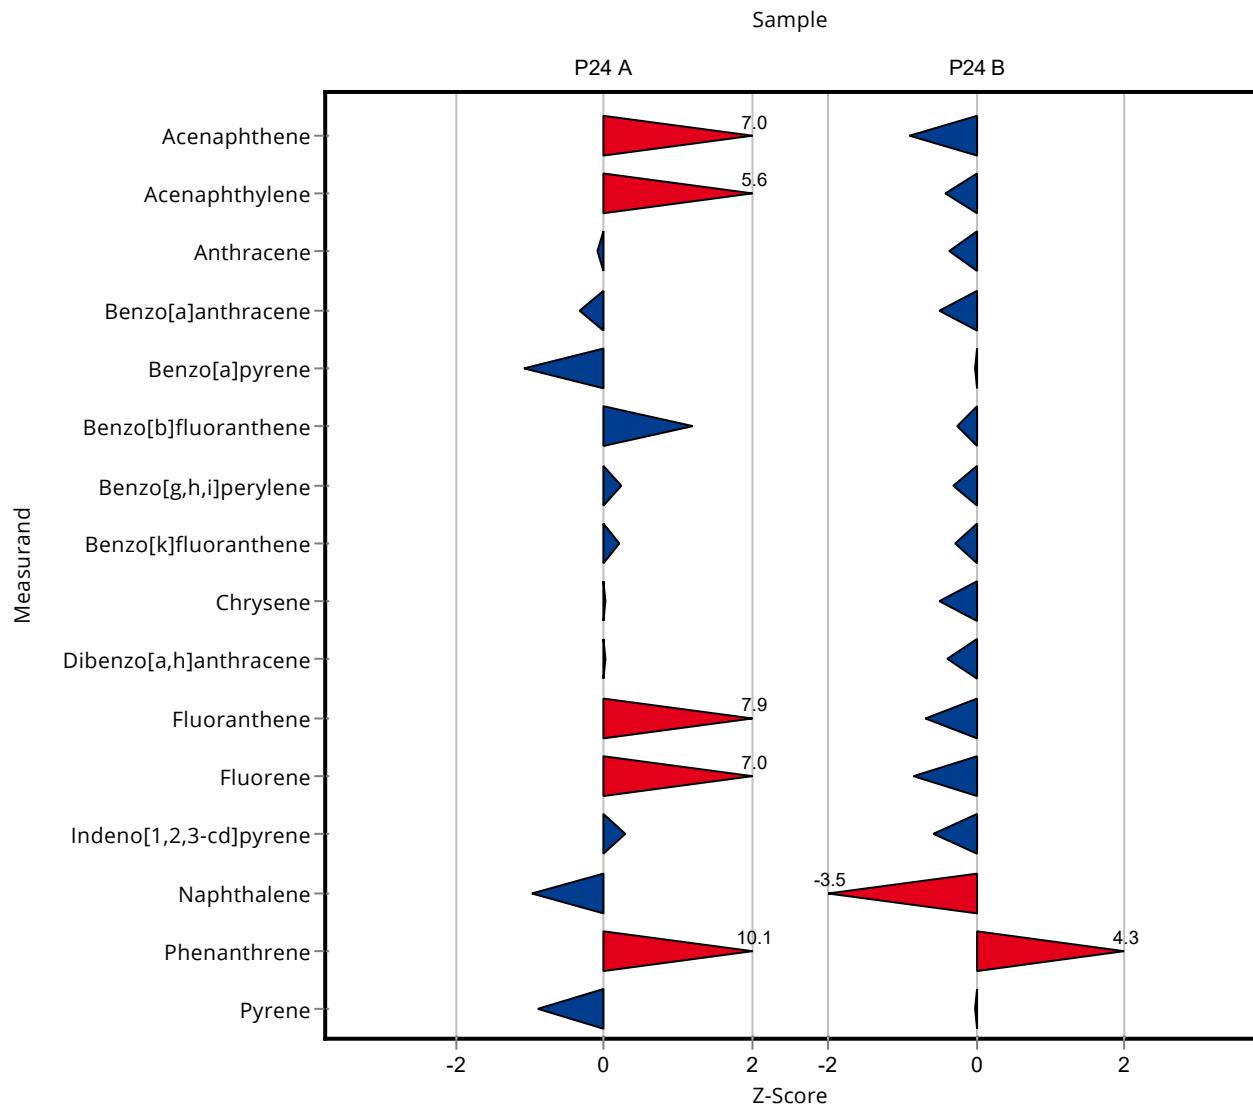


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	62.1 ± 14	5.08	232	1.26
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	57.5 ± 7.6	5.89	234	2.13
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	24 ± 1.6	6.39	97.6	-0.18
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	21.1 ± 3.2	4.77	92.8	-0.25
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	11.7 ± 1.3	3.78	74.3	-1.38
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	28.6 ± 5.4	4.05	120	0.44
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	24.9 ± 2.3	7.43	107	0.34
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	22.7 ± 2.3	5.61	105	0.24
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	27 ± 2.5	5.91	100	0.02
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	25.7 ± 4	7.7	100	0.00
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	66.1 ± 4.6	4.9	243	4.17
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	54 ± 7.4	3.83	197	1.79
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	22.4 ± 2.7	4.23	106	0.22
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	28.7 ± 8.1	7.6	79.3	-0.45
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	122.6 ± 13.2	9.18	414	3.49
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	21.8 ± 1.8	4.06	85.8	-0.92

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	149.3 ± 33.7	34.1	83.1	-0.44
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	128.6 ± 17	34.4	89.7	-0.42
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	164.7 ± 11	47.2	90.8	-0.72
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	131.7 ± 20.2	30.8	89.8	-0.36
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	146.5 ± 16.6	35.4	99.3	-0.03
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	131.3 ± 24.9	23.3	95.8	-0.11

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	137.3 ± 13	48.6	90.4	-0.51
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	142.4 ± 14.5	39.9	92.9	-0.36
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	160.3 ± 14.7	39.7	88.9	-0.66
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	115.8 ± 17.8	39.2	88.7	-0.37
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	157.2 ± 11	32.3	87.5	-0.95
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	115.4 ± 15.8	18.3	88.2	-0.47
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	99.9 ± 11.9	20.1	89.7	-0.46
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	47.5 ± 13.4	38.3	26	-4.55
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	295.9 ± 31.8	26.9	165	1.79
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	178.5 ± 14.5	28.7	99.5	-0.03

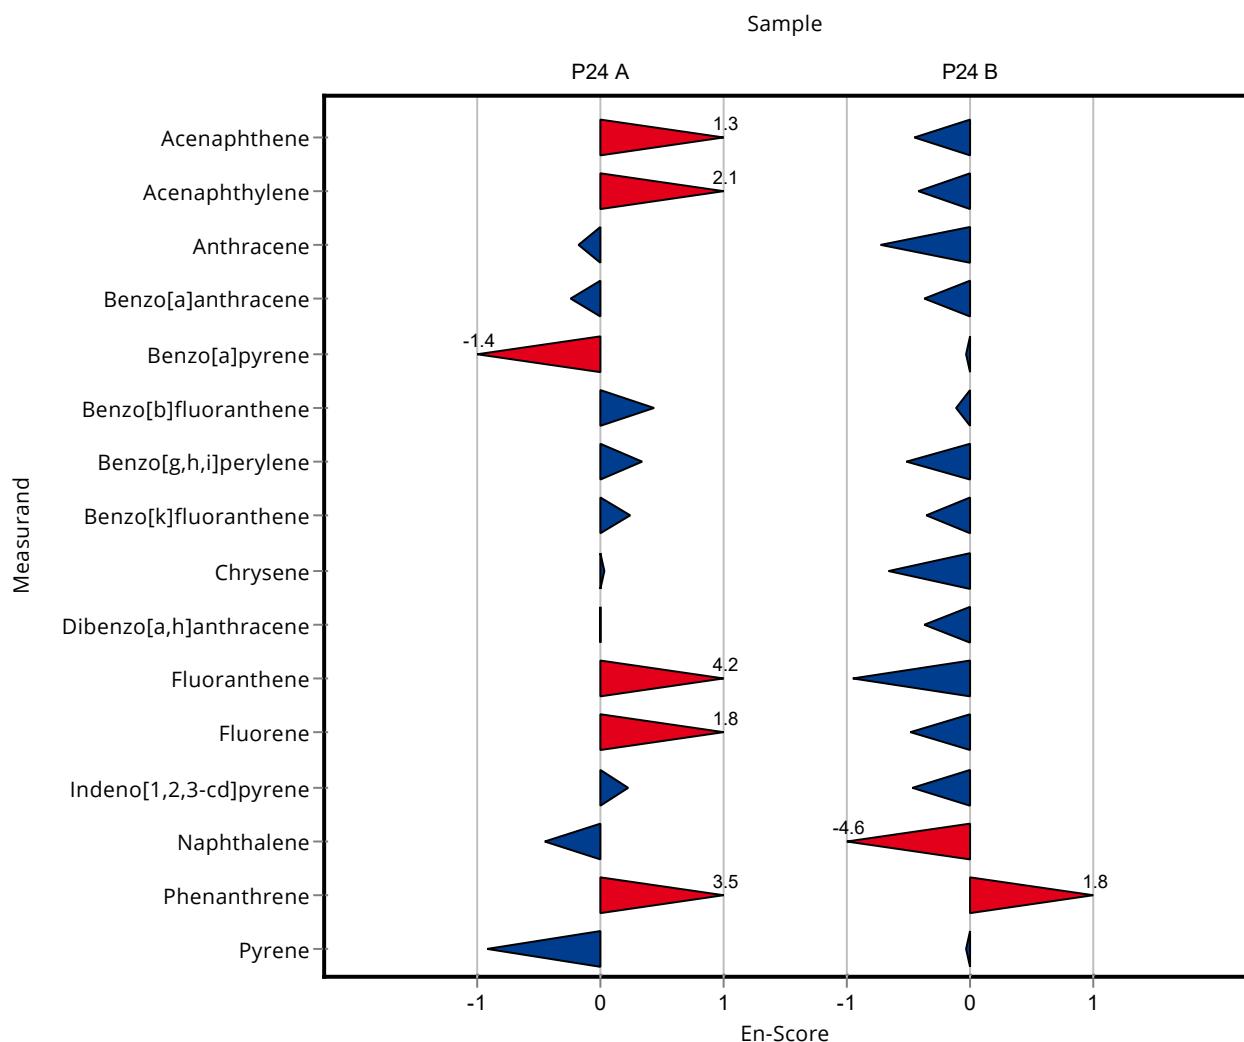


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	20.8 ± 2.68	5.08	77.9	-1.17
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	22.8 ± 2.99	5.89	92.9	-0.30
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	20.9 ± 1.54	6.39	85	-0.58
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	18 ± 1.89	4.77	79.2	-0.99
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	14 ± 1.27	3.78	88.9	-0.46
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19.8 ± 1.38	4.05	83.2	-0.99
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23 ± 0.96	7.43	99.1	-0.03
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.7 ± 1.34	5.61	91.3	-0.33
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	22.5 ± 1.29	5.91	83.7	-0.74
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.2 ± 2.21	7.7	94.3	-0.19
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	20.5 ± 1.54	4.9	75.3	-1.37
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.3 ± 1.53	3.83	88.8	-0.80
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	19.1 ± 1.47	4.23	90.3	-0.49
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	25 ± 1.28	7.6	69.1	-1.47
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	22.1 ± 1.49	9.18	74.6	-0.82
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	19.9 ± 1.46	4.06	78.3	-1.35

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	119.5 ± 15.4	34.1	66.6	-1.76
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	103.9 ± 13.64	34.4	72.5	-1.15
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	146 ± 10.76	47.2	80.5	-0.75
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	110.4 ± 11.6	30.8	75.3	-1.18
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	112.7 ± 10.21	35.4	76.4	-0.98
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	106.2 ± 7.38	23.3	77.5	-1.32
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	189.7 ± 7.95	48.6	125	0.78
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	140.3 ± 9.57	39.9	91.5	-0.33
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	163 ± 9.36	39.7	90.4	-0.44
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	175.7 ± 16.08	39.2	135	1.15
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	141 ± 10.62	32.3	78.5	-1.19
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	115.3 ± 7.25	18.3	88.1	-0.85
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	107.4 ± 8.28	20.1	96.4	-0.20

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	61.8 ± 3.17	38.3	33.9 -3.15
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	128.6 ± 8.68	26.9	71.6 -1.89
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	140.9 ± 10.34	28.7	78.6 -1.34

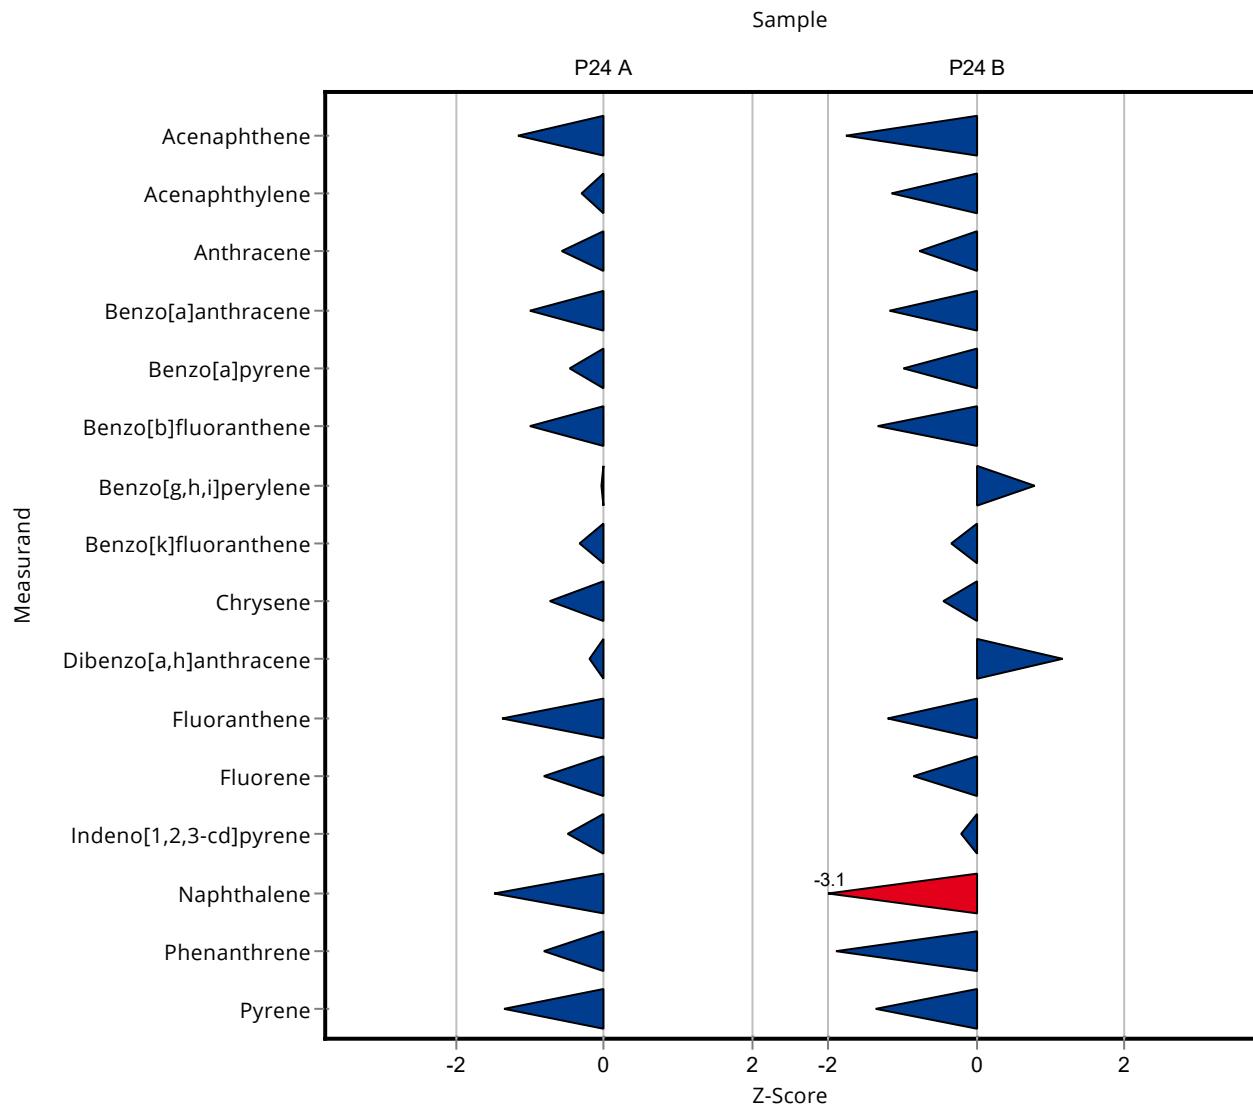


Sample: P24A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	26.7 ± 1.44	20.8 ± 2.68	5.08	77.9	-1.07
Acenaphthylene	ng/l	24.5 ± 2.84	22.8 ± 2.99	5.89	92.9	-0.26
Anthracene	ng/l	24.6 ± 1.09	20.9 ± 1.54	6.39	85	-1.13
Benzo[a]anthracene	ng/l	22.7 ± 1.46	18 ± 1.89	4.77	79.2	-1.17
Benzo[a]pyrene	ng/l	15.7 ± 1.37	14 ± 1.27	3.78	88.9	-0.61
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	23.8 ± 1.52	19.8 ± 1.38	4.05	83.2	-1.27
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	23.2 ± 1.75	23 ± 0.96	7.43	99.1	-0.08
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	21.6 ± 1.11	19.7 ± 1.34	5.61	91.3	-0.65
Chrysene	ng/l	26.9 ± 1.19	22.5 ± 1.29	5.91	83.7	-1.54
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	25.7 ± 1.57	24.2 ± 2.21	7.7	94.3	-0.31
Fluoranthene	ng/l	27.2 ± 1.49	20.5 ± 1.54	4.9	75.3	-1.97
Fluorene	ng/l	27.4 ± 1.24	24.3 ± 1.53	3.83	88.8	-0.93
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	21.2 ± 1.58	19.1 ± 1.47	4.23	90.3	-0.62
Naphthalene	ng/l	36.2 ± 3.55	25 ± 1.28	7.6	69.1	-2.56
Phenanthrene	ng/l	29.6 ± 3.63	22.1 ± 1.49	9.18	74.6	-1.60
Pyrene	ng/l	25.4 ± 1.57	19.9 ± 1.46	4.06	78.3	-1.66

Sample: P24B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acenaphthene	ng/l	180 ± 10	119.5 ± 15.4	34.1	66.6	-1.85
Acenaphthylene	ng/l	143 ± 10.4	103.9 ± 13.64	34.4	72.5	-1.35
Anthracene	ng/l	181 ± 7.66	146 ± 10.76	47.2	80.5	-1.55
Benzo[a]anthracene	ng/l	147 ± 7.68	110.4 ± 11.6	30.8	75.3	-1.48
Benzo[a]pyrene	ng/l	147 ± 8.62	112.7 ± 10.21	35.4	76.4	-1.57
Benzo[b]fluoranthene	ng/l	137 ± 8.16	106.2 ± 7.38	23.3	77.5	-1.83

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Benzo[g,h,i]perylene	ng/l	152 ± 11.6	189.7 ± 7.95	48.6	125	1.92
Benzo[k]fluoranthene	ng/l	153 ± 8.4	140.3 ± 9.57	39.9	91.5	-0.62
Chrysene	ng/l	180 ± 7.8	163 ± 9.36	39.7	90.4	-0.85
Dibenzo[a,h]anthracene	ng/l	131 ± 19.2	175.7 ± 16.08	39.2	135	1.20
Fluoranthene	ng/l	180 ± 8.62	141 ± 10.62	32.3	78.5	-1.69
Fluorene	ng/l	131 ± 7.6	115.3 ± 7.25	18.3	88.1	-0.95
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ng/l	111 ± 7.43	107.4 ± 8.28	20.1	96.4	-0.22
Naphthalene	ng/l	182 ± 12.7	61.8 ± 3.17	38.3	33.9	-8.51
Phenanthrene	ng/l	180 ± 13.7	128.6 ± 8.68	26.9	71.6	-2.31
Pyrene	ng/l	179 ± 8.09	140.9 ± 10.34	28.7	78.6	-1.73

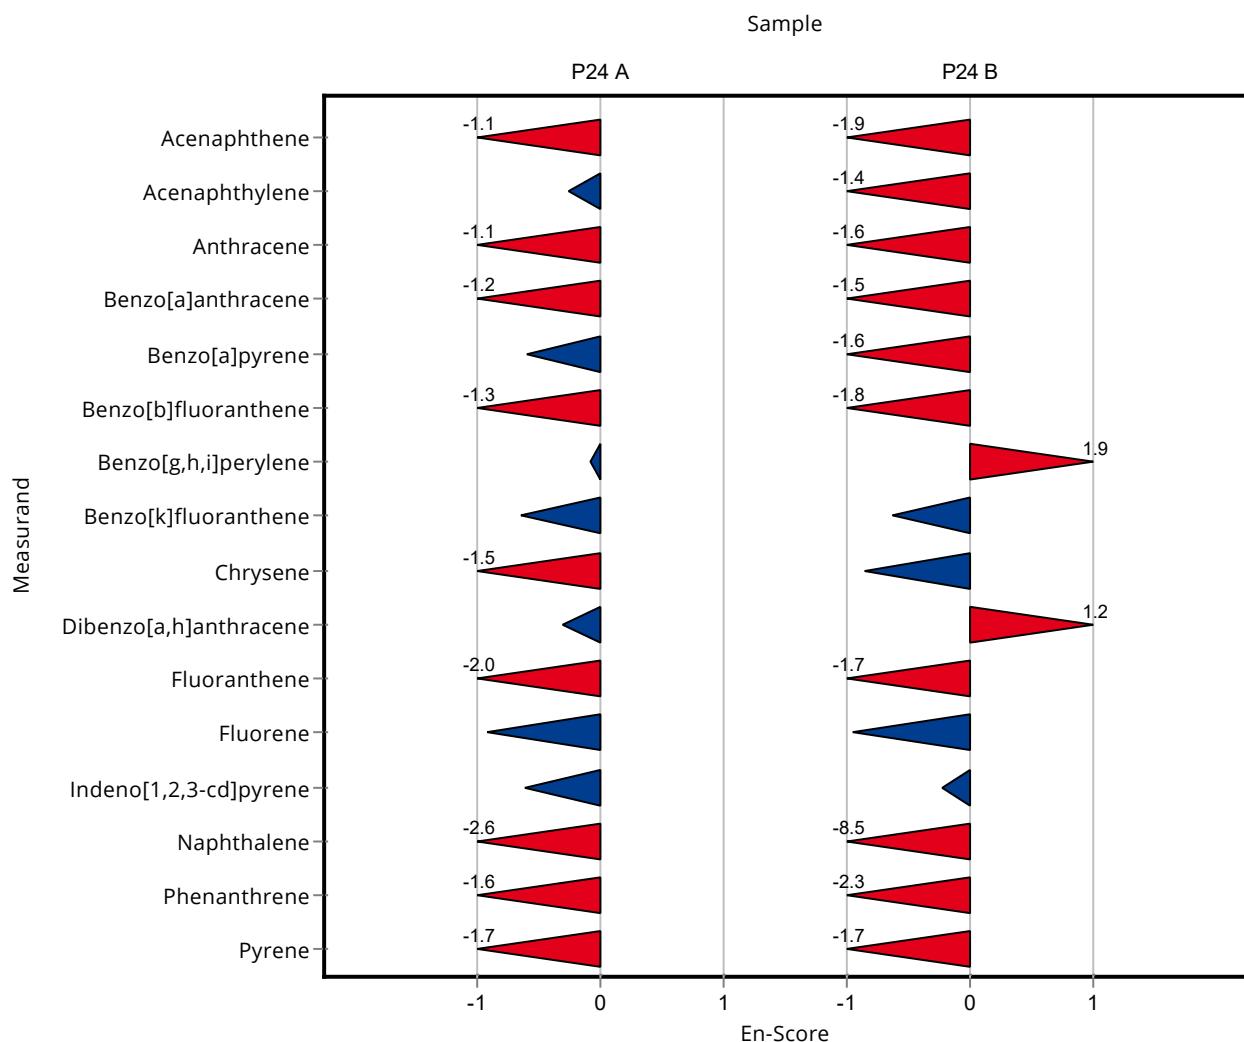

E9. Methodenübersicht / Overview of methods

LabCode	Sample	Acenaphthene	Acenaphthylene	Anthracene	Benz[a]anthracene
LC0001	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24A	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24A			GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24A				
LC0011	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24A	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24A				
LC0015	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24A				
LC0021	P24A				
LC0022	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Acenaphthene	Acenaphthylene	Anthracene	Benzo[a]anthracene
LC0024	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24A	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24A	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Benzo[a]pyrene	Benzo[b]fluoranthene	Benzo[g,h,i]perylene	Benzo[k]fluoranthene
LC0001	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24A	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24A	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24A	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;
LC0011	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24A	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24A	GC-MS (Screening); Screening BAFU			
LC0015	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24A	GC-MS; Meth. Rev.5 2016-07			
LC0021	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0022	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Benzo[a]pyrene	Benzo[b]fluoranthene	Benzo[g,h,i]perylene	Benzo[k]fluoranthene
LC0024	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24A	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24A	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Chrysene	Dibenzo[a,h]anthracene	Fluoranthene	Fluorene
LC0001	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24A	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24A	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	
LC0010	P24A				
LC0011	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24A	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24A				
LC0015	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24A				
LC0021	P24A				
LC0022	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Chrysene	Dibenzo[a,h]anthracene	Fluoranthene	Fluorene
LC0024	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24A	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24A	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	Naphthalene	Phenanthrene	Pyrene
LC0001	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24A	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01		GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24A	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01			GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24A	HPLC-FLD;			
LC0011	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24A	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24A				
LC0015	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24A	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24A	GC-MS; Meth. Rev.5 2016-07			
LC0021	P24A	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0022	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	Naphthalene	Phenanthrene	Pyrene
LC0024	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24A	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24A	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24A	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24A	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24A	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Acenaphthene	Acenaphthylene	Anthracene	Benzo[a]anthracene
LC0001	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24B	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24B			GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24B				
LC0011	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24B	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24B				
LC0015	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24B				
LC0021	P24B				
LC0022	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Acenaphthene	Acenaphthylene	Anthracene	Benzo[a]anthracene
LC0024	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24B	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24B	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Benzo[a]pyrene	Benzo[b]fluoranthene	Benzo[g,h,i]perylene	Benzo[k]fluoranthene
LC0001	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24B	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24B	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24B	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;	HPLC-FLD;
LC0011	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24B	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24B	GC-MS (Screening); Screening BAFU			
LC0015	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24B	GC-MS; Meth. Rev.5 2016-07			
LC0021	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0022	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Benzo[a]pyrene	Benzo[b]fluoranthene	Benzo[g,h,i]perylene	Benzo[k]fluoranthene
LC0024	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24B	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24B	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Chrysene	Dibenzo[a,h]anthracene	Fluoranthene	Fluorene
LC0001	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24B	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24B	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	
LC0010	P24B				
LC0011	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24B	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24B				
LC0015	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24B				
LC0021	P24B				
LC0022	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Chrysene	Dibenzo[a,h]anthracene	Fluoranthene	Fluorene
LC0024	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24B	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24B	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	Naphthalene	Phenanthrene	Pyrene
LC0001	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0002	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0003	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0004	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0005	P24B	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01		GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01	GC-MS/MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0006	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0007	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0008	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0009	P24B	GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01			GC-MS (SPME); ISS.CAB.039.REV01
LC0010	P24B	HPLC-FLD;			
LC0011	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0012	P24B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0013	P24B	GC-MS; after liquid-liquid extraction			
LC0014	P24B				
LC0015	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0016	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0017	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0018	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0019	P24B	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540	GC-MS; ISO 28540
LC0020	P24B	GC-MS; Meth. Rev.5 2016-07			
LC0021	P24B	GC-MS; ISO 28540 (F40)			
LC0022	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0023	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			

LabCode	Sample	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	Naphthalene	Phenanthrene	Pyrene
LC0024	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0025	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0026	P24B	GC-MS; DIN 38407-39 (F39)			
LC0027	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993 (F18)			
LC0028	P24B	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181	GC-MS; EN 16181
LC0029	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0030	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0031	P24B	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;	GC-MS;
LC0032	P24B	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39	GC-MS; DIN 38407-39
LC0033	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			
LC0034	P24B	HPLC-FLD; EN ISO 17993			